

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 24/06/1993	<b>Profession</b> CHAUFFEUR VL
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 712	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,1 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 52 %

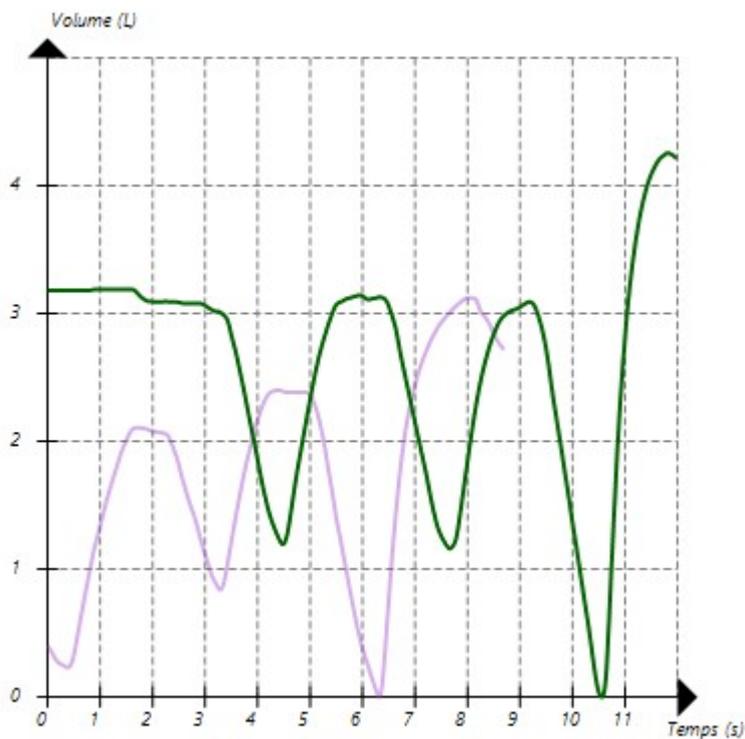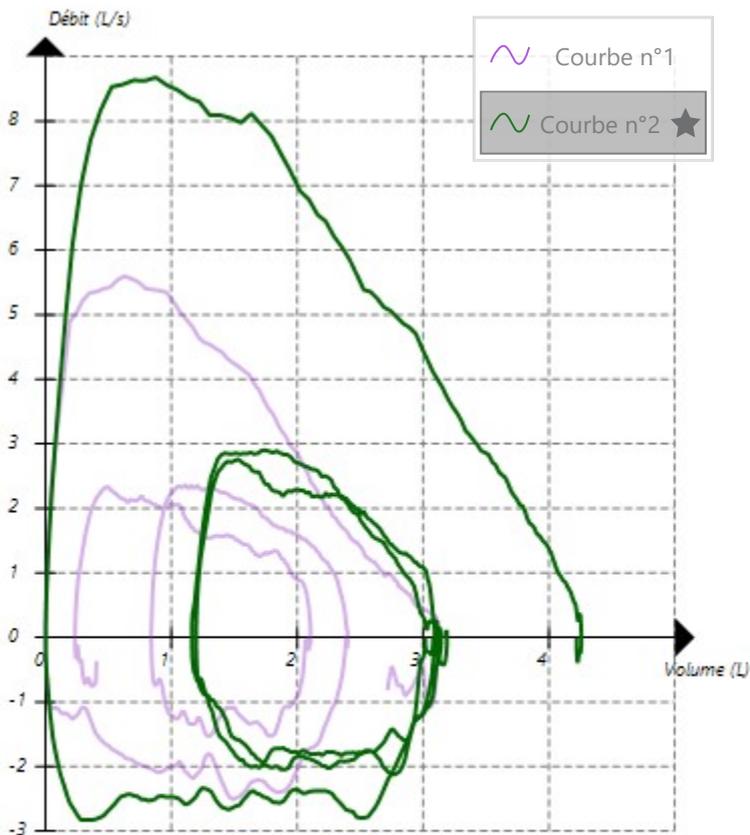

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,12 L	4,26 L	4,04 L	105,45 %
VEMS	2,84 L	4,19 L	3,39 L	123,60 %
DEP	5,64 L/s	8,75 L/s	8,77 L/s	99,77 %
VEMS/CVF	91,03 %	98,36 %	83,57 %	117,70 %
Durée d'expiration	1,72 s	1,26 s	-	
DEMM	3,58 L/s	6,30 L/s	3,82 L/s	164,92 %
DEMM/CVF	1,15 s-1	1,48 s-1	0,95 s-1	155,79 %
DE75	5,41 L/s	8,42 L/s	-	
DE50	4,15 L/s	6,64 L/s	-	
DE25	1,75 L/s	3,70 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: