

<b>Nom</b> HANN	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALSENY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1990	<b>Profession</b> OPERATEUR
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 00	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 191 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 2
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 30,4 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Humidité : 61 %

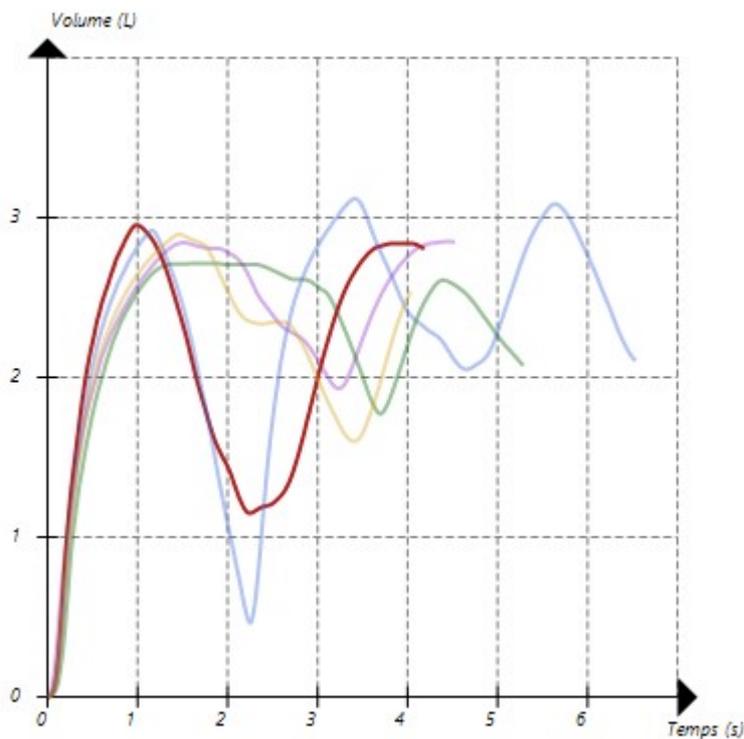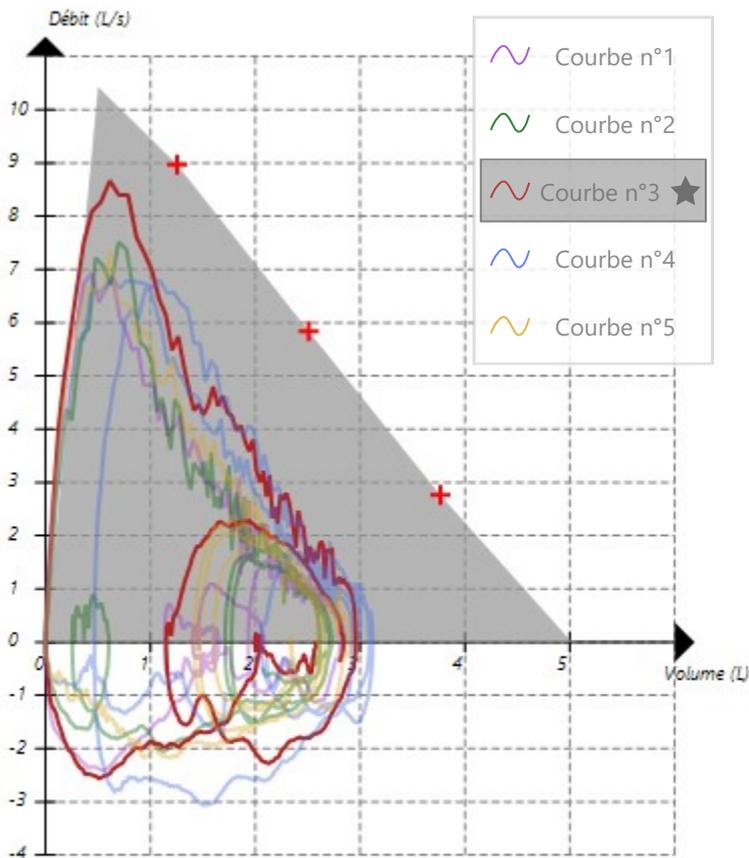

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Courbe n°4	Courbe n°5	Prédits	% Prédits
CVF	2,84 L	2,71 L	2,96 L	2,92 L	2,90 L	5,02 L	58,96 %
VEMS	2,62 L	2,62 L	2,96 L	2,89 L	2,72 L	4,12 L	71,84 %
DEP	7,59 L/s	8,26 L/s	9,17 L/s	7,36 L/s	7,96 L/s	10,43 L/s	87,92 %
VEMS/CVF	92,25 %	96,68 %	100,00 %	98,97 %	93,79 %	81,12 %	123,27 %
Durée d'expiration	1,50 s	1,78 s	0,99 s	1,16 s	1,46 s	-	
DEMM	3,22 L/s	3,43 L/s	4,66 L/s	4,21 L/s	3,64 L/s	4,95 L/s	94,14 %
DEMM/CVF	1,13 s-1	1,27 s-1	1,57 s-1	1,44 s-1	1,26 s-1	0,86 s-1	182,56 %
DE75	6,45 L/s	7,66 L/s	8,99 L/s	7,06 L/s	6,59 L/s	8,97 L/s	100,22 %
DE50	3,68 L/s	2,47 L/s	4,75 L/s	4,73 L/s	3,26 L/s	5,84 L/s	81,34 %
DE25	1,74 L/s	2,06 L/s	2,28 L/s	2,78 L/s	1,61 L/s	2,76 L/s	82,61 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: