

**Nom** KONE  
**Prénom** VECKE  
**Né le** 01/01/1985  
**Age** 39 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 457  
**Taille** 173 cm  
**Poids** 84 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** TECHNICIEN ENVIRONNEMENT  
**Entreprise** BCEIP  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 25,2 °C

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Humidité : 52 %

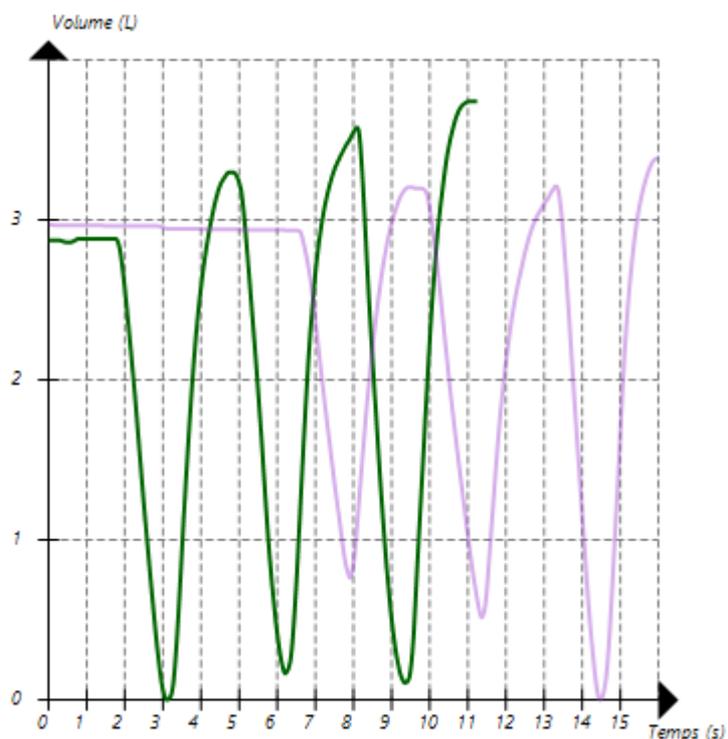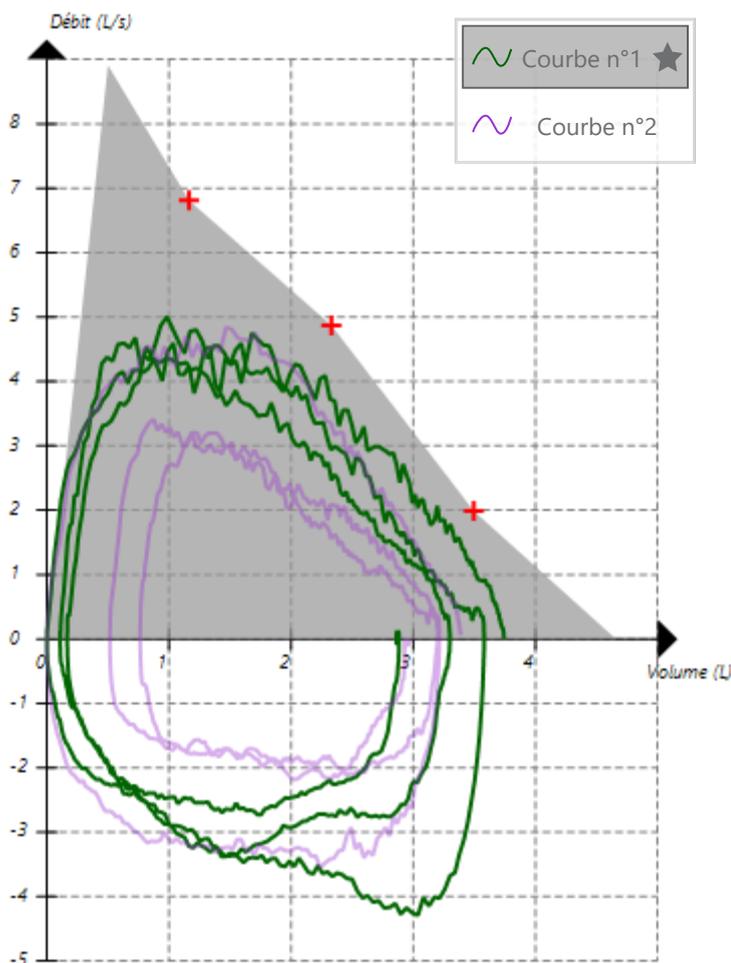

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,41 L	3,39 L	4,66 L	73,18 %
VEMS	3,06 L	3,23 L	3,86 L	79,27 %
DÉP	5,15 L/s	5,04 L/s	8,91 L/s	57,80 %
VEMS/CVF	89,74 %	95,28 %	82,60 %	108,64 %
Durée d'expiration	1,88 s	1,52 s	-	
DEMM	3,71 L/s	4,17 L/s	4,08 L/s	90,93 %
DEMM/CVF	1,09 s <sup>-1</sup>	1,23 s <sup>-1</sup>	0,88 s <sup>-1</sup>	123,86 %
DE75	4,79 L/s	4,41 L/s	6,81 L/s	70,34 %
DE50	4,06 L/s	4,84 L/s	4,87 L/s	83,37 %
DE25	2,21 L/s	2,96 L/s	1,99 L/s	111,06 %