

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> VOFING	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2002	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 22 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> CHAUFFEUR POIDS LOURD
<b>ID</b> 605	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 75 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 30,6 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 57 %

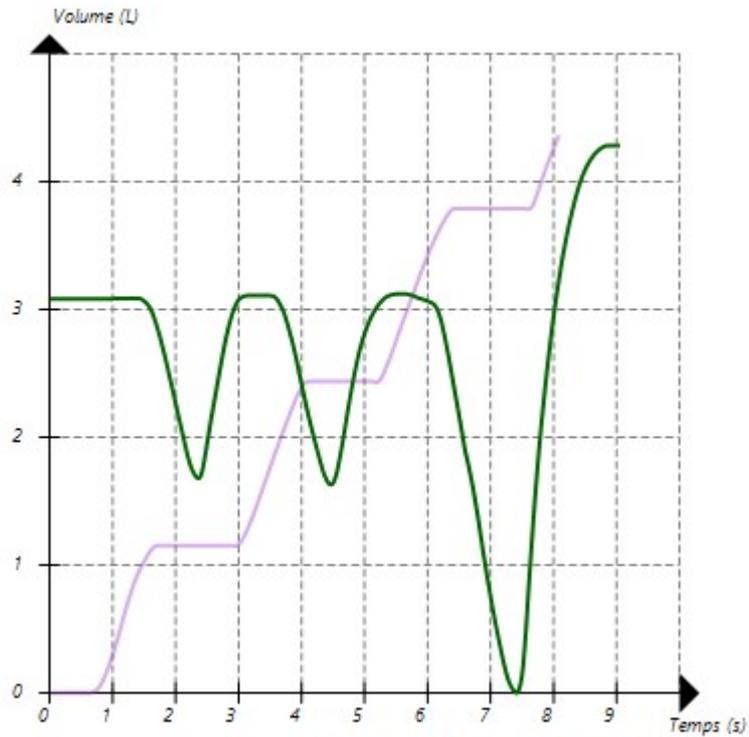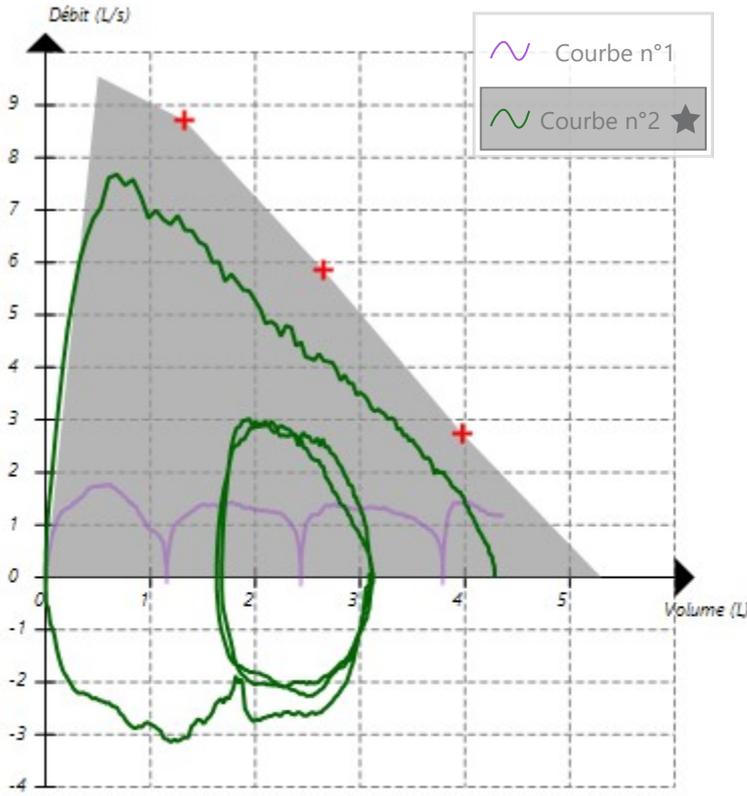

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,44 L	4,28 L	5,30 L	80,75 %
VEMS	1,16 L	4,09 L	4,57 L	89,50 %
DEP	1,79 L/s	7,83 L/s	9,55 L/s	81,99 %
VEMS/ CVF	47,54 %	95,56 %	84,39 %	113,24 %
Durée d'expiration	3,49 s	1,45 s	-	
DEMM	0,52 L/s	4,87 L/s	5,10 L/s	95,49 %
DEMM/ CVF	0,21 s-1	1,14 s-1	0,96 s-1	118,75 %
DE75	1,78 L/s	6,95 L/s	8,71 L/s	79,79 %
DE50	0,93 L/s	4,83 L/s	5,86 L/s	82,42 %
DE25	1,39 L/s	3,13 L/s	2,74 L/s	114,23 %