

<b>Nom</b> OLEANO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ROKIATOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 06/03/1990	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 498	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 156 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 30,8 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 62 %

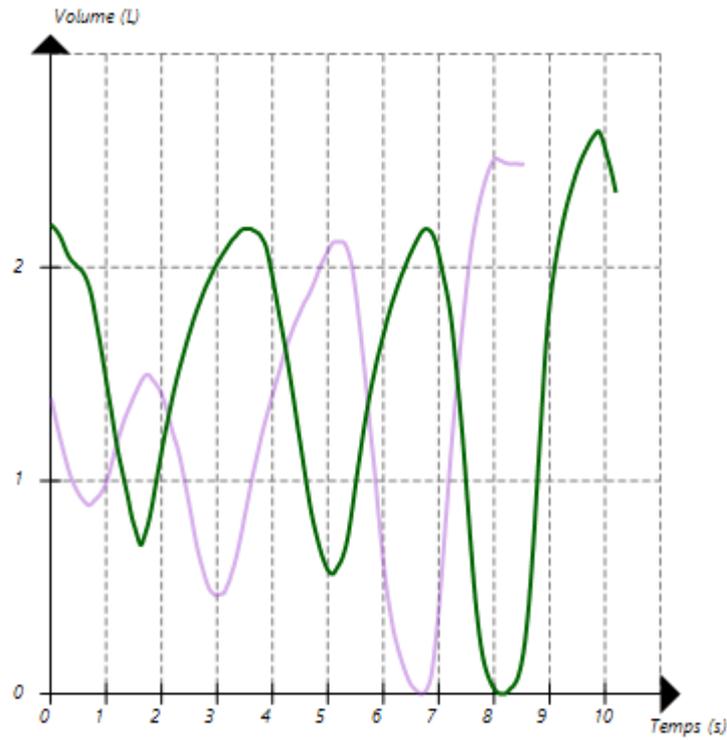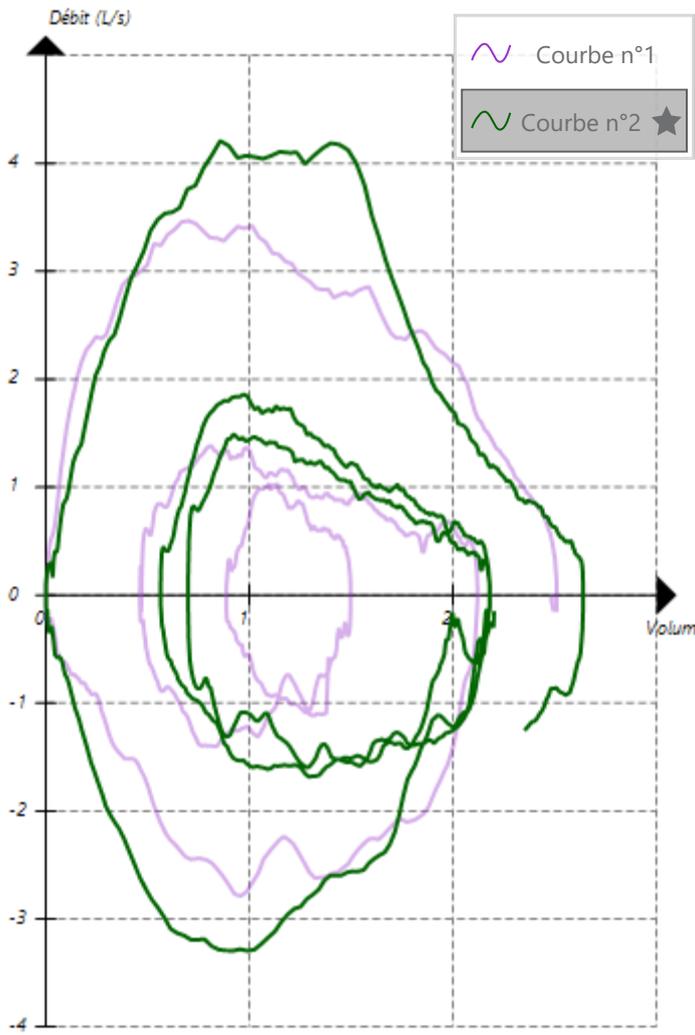

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,51 L	2,64 L	2,88 L	91,67 %
VEMS	2,45 L	2,48 L	2,43 L	102,06 %
DÉP	3,50 L/s	4,25 L/s	6,36 L/s	66,82 %
VEMS/ CVF	97,61 %	93,94 %	84,72 %	110,88 %
Durée d'expiration	1,36 s	1,76 s	-	
DEMM	3,01 L/s	3,45 L/s	2,88 L/s	119,79 %
DEMM/ CVF	1,20 s-1	1,31 s-1	1,00 s-1	131,00 %
DE75	3,36 L/s	3,59 L/s	-	
DE50	2,96 L/s	4,06 L/s	-	
DE25	2,40 L/s	1,74 L/s	-	