



<b>Nom</b> BAH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/05/1991	<b>Profession</b> TOPOGRAPHE
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 125	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 52 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 46 %

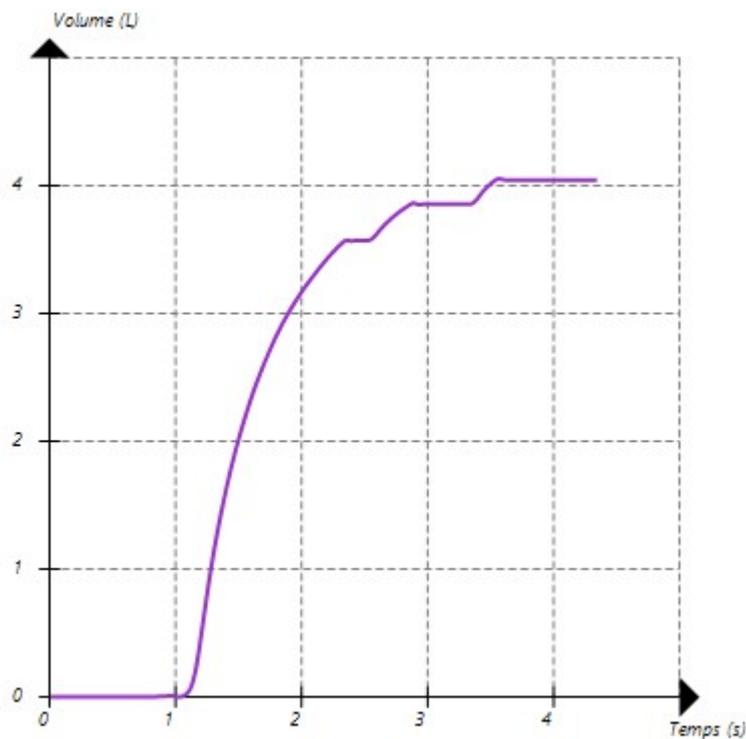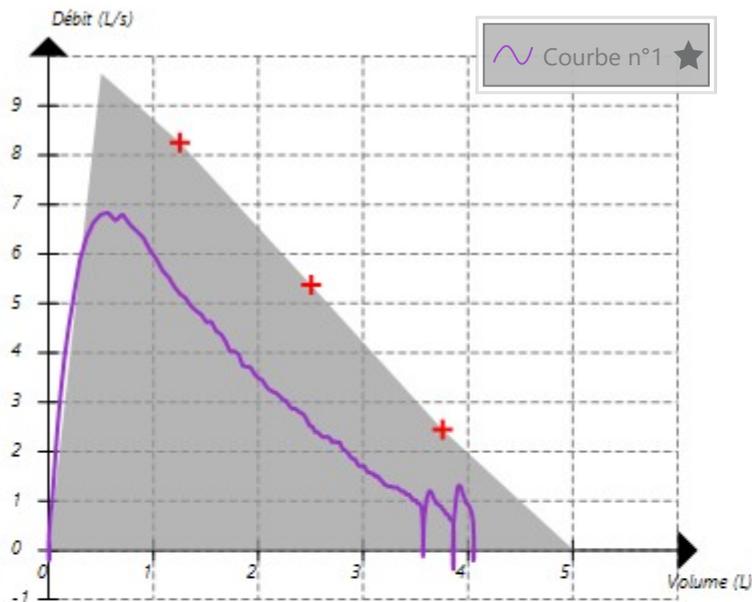

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,06 L	5,01 L	81,04 %
VEMS	3,35 L	4,19 L	79,95 %
DEP	7,02 L/s	9,66 L/s	72,67 %
VEMS/ CVF	82,51 %	81,48 %	101,26 %
Durée d'expiration	2,54 s	-	
DEMM	3,19 L/s	4,76 L/s	67,02 %
DEMM/ CVF	0,79 s-1	0,95 s-1	83,16 %
DE75	5,92 L/s	8,26 L/s	71,67 %
DE50	3,50 L/s	5,37 L/s	65,18 %
DE25	1,60 L/s	2,44 L/s	65,57 %