



<b>Nom</b> DIABATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINET	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 11/11/1993	<b>Profession</b> OPERATEUR
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 327	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 33 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 68 %

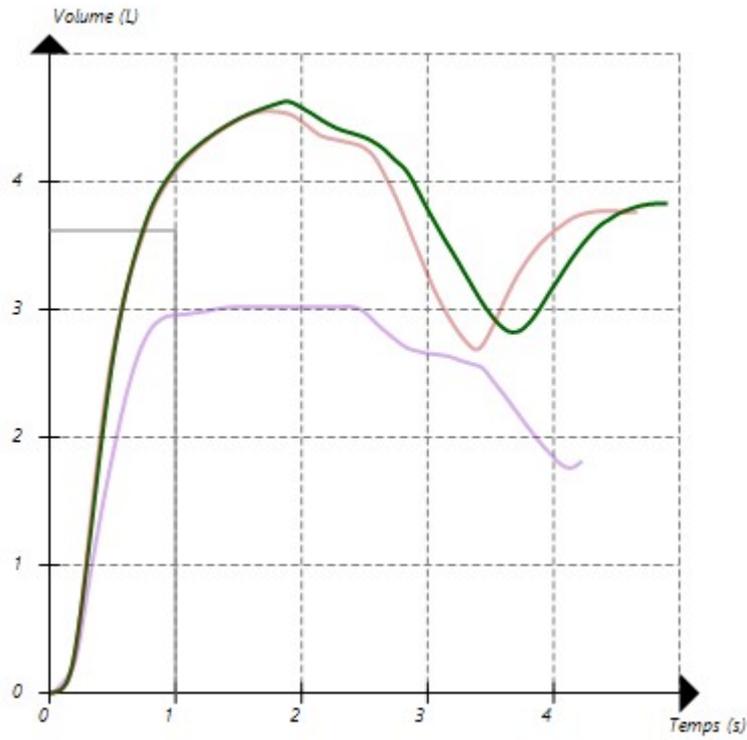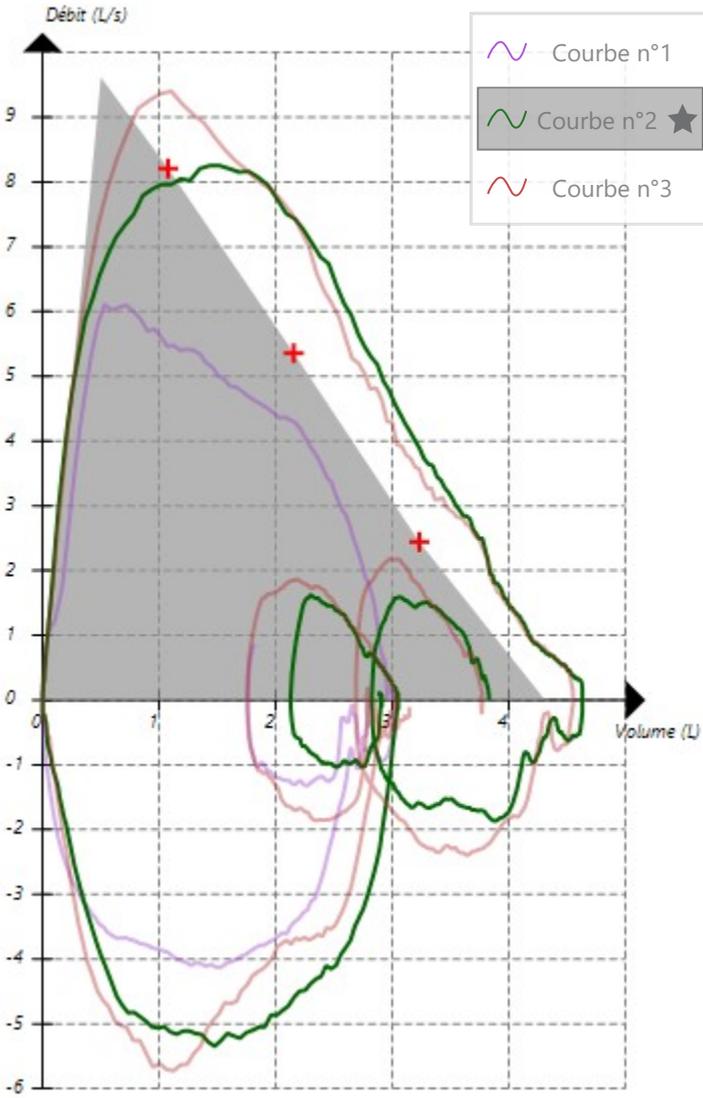

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,02 L	4,63 L	4,55 L	4,31 L	107,42 %
VEMS	2,98 L	4,28 L	4,27 L	3,62 L	118,23 %
DEP	6,22 L/s	8,29 L/s	9,56 L/s	9,62 L/s	86,17 %
VEMS/CVF	98,68 %	92,44 %	93,85 %	81,84 %	112,95 %
Durée d'expiration	2,36 s	1,89 s	1,77 s	-	
DEMM	5,06 L/s	6,11 L/s	5,96 L/s	4,81 L/s	127,03 %
DEMM/CVF	1,68 s-1	1,32 s-1	1,31 s-1	0,97 s-1	136,08 %
DE75	5,95 L/s	8,04 L/s	9,29 L/s	8,21 L/s	97,93 %
DE50	5,00 L/s	7,09 L/s	7,07 L/s	5,36 L/s	132,28 %
DE25	3,98 L/s	3,22 L/s	3,23 L/s	2,44 L/s	131,97 %