



|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Nom</b> CAMARA                      | <b>Adresse</b>                |
| <b>Prénom</b> MAMADY ABOU              | <b>Exposition</b>             |
| <b>Né le</b> 02/08/2002                | <b>Profession</b> SPORTERS    |
| <b>Age</b> 21 Ans                      | <b>Entreprise</b> BECEIP      |
| <b>Genre</b> Masculin                  | <b>Service</b>                |
| <b>ID</b> 47                           | <b>Fumeur</b> Non fumeur      |
| <b>Taille</b> 171 cm                   | <b>Prescripteur:</b>          |
| <b>Poids</b> 74 kg                     | <b>Smoking Pack Years</b> : 0 |
| <b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal  |                               |
| <b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA |                               |



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 47 %

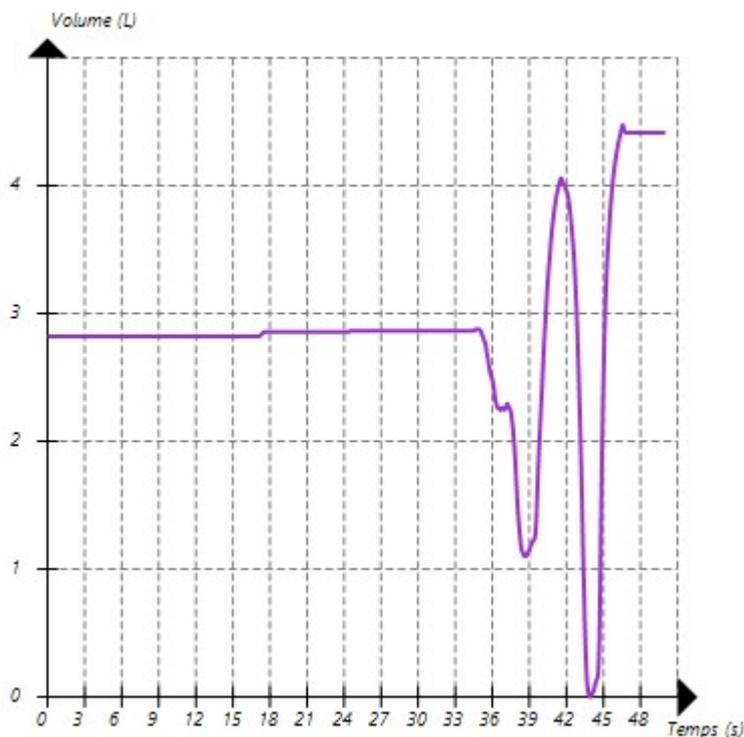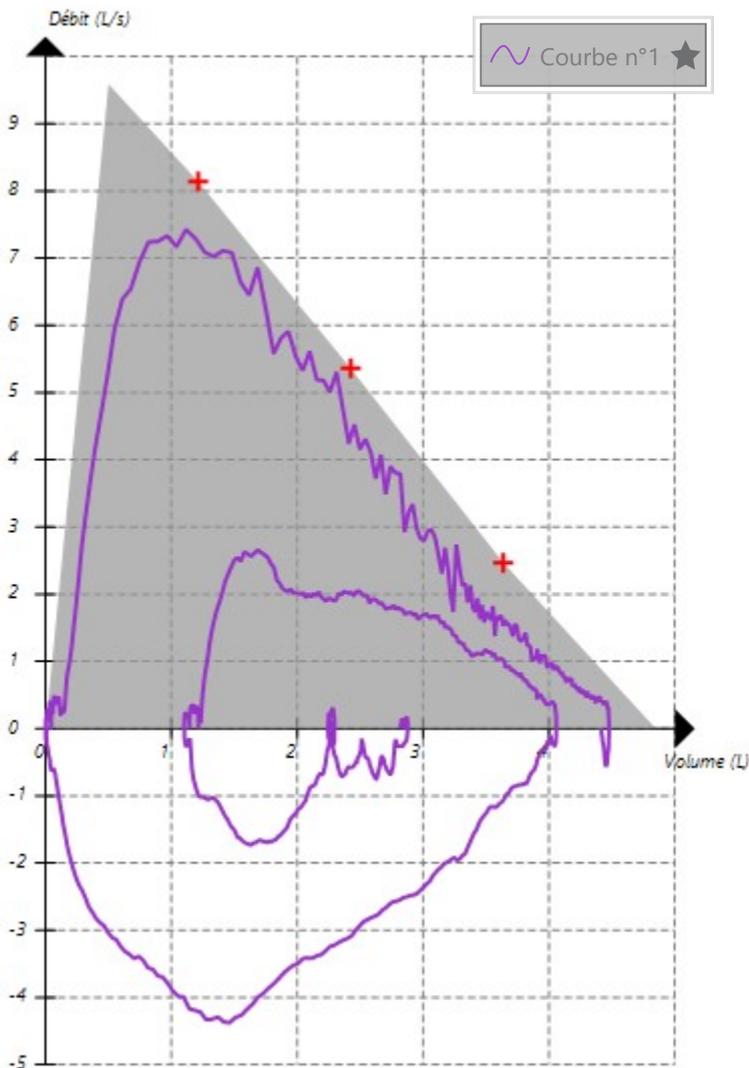

| Nom                | Courbe n°1 (Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF                | 4,43 L               | 4,85 L   | 91,34 %   |
| VEMS               | 3,85 L               | 4,14 L   | 93,00 %   |
| DEP                | 7,62 L/s             | 9,59 L/s | 79,46 %   |
| VEMS/ CVF          | 86,91 %              | 82,74 %  | 105,04 %  |
| Durée d'expiration | 2,40 s               | -        |           |
| DEMM               | 4,33 L/s             | 4,95 L/s | 87,47 %   |
| DEMM/ CVF          | 0,98 s-1             | 1,02 s-1 | 96,08 %   |
| DE75               | 7,14 L/s             | 8,14 L/s | 87,71 %   |
| DE50               | 4,86 L/s             | 5,36 L/s | 90,67 %   |
| DE25               | 2,48 L/s             | 2,47 L/s | 100,40 %  |