



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MADOUSSOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 21/02/1999	<b>Profession</b> ASSISTANTE ADMINISTRATIF
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 642	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 77 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 58 %

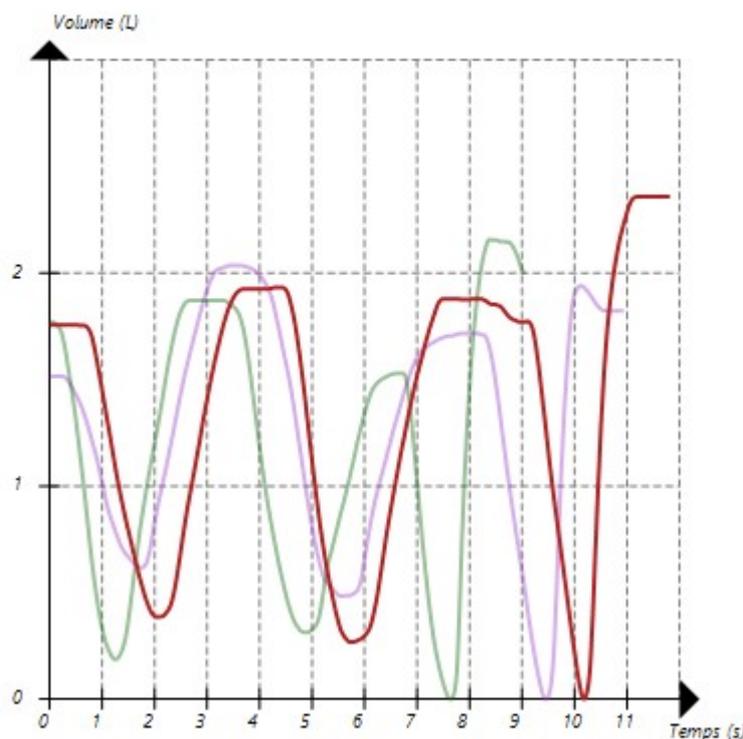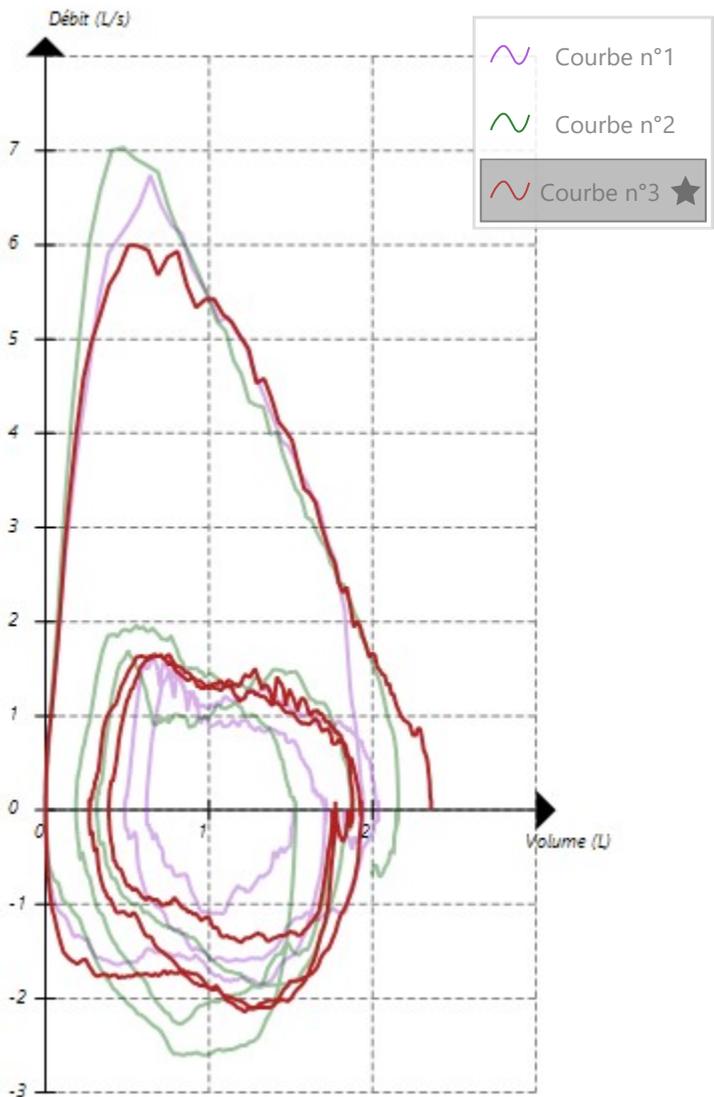

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,94 L	2,16 L	2,36 L	3,15 L	74,92 %
VEMS	1,94 L	2,16 L	2,36 L	2,74 L	86,13 %
DEP	6,96 L/s	7,14 L/s	6,08 L/s	6,75 L/s	90,07 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	86,56 %	115,53 %
Durée d'expiration	0,66 s	0,74 s	1,03 s	-	
DEMM	5,51 L/s	4,95 L/s	4,59 L/s	3,33 L/s	137,84 %
DEMM/ CVF	2,84 s-1	2,29 s-1	1,94 s-1	1,06 s-1	183,02 %
DE75	5,94 L/s	6,92 L/s	5,92 L/s	-	
DE50	5,51 L/s	5,14 L/s	5,08 L/s	-	
DE25	3,94 L/s	3,10 L/s	2,69 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: