

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINET	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1993	<b>Profession</b> CHAUFFEUR PL
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 577	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Dejsomritrutai 2000	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,1 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 61 %

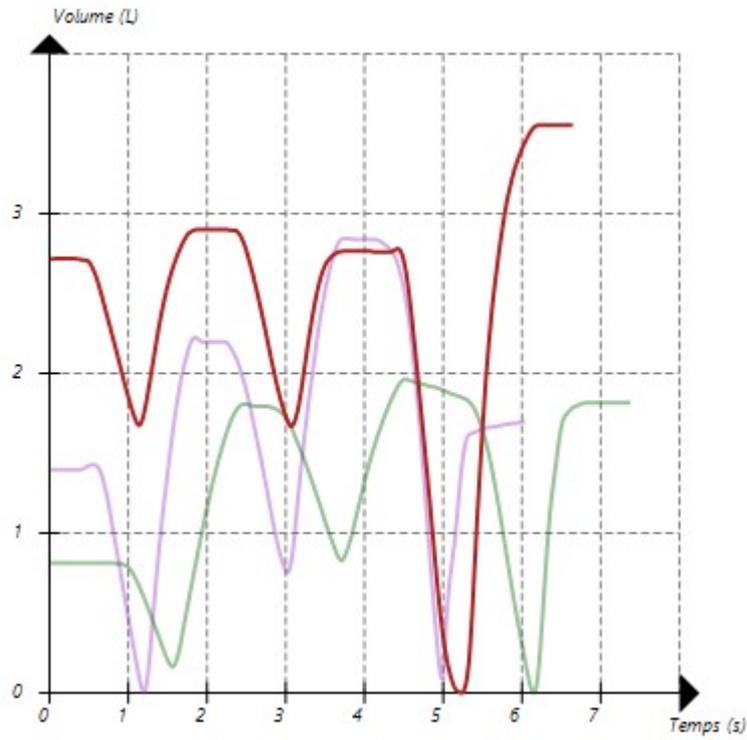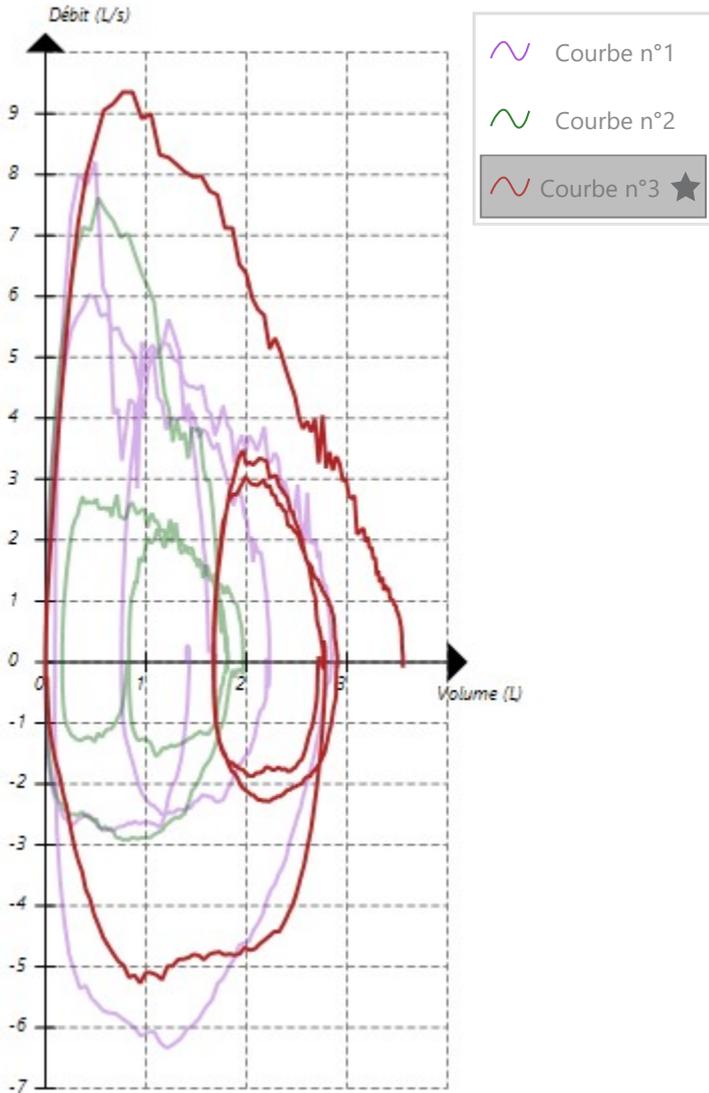

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,61 L	1,82 L	3,56 L	4,12 L	86,41 %
VEMS	1,61 L	1,82 L	3,56 L	3,42 L	104,09 %
DEP	8,56 L/s	7,87 L/s	9,55 L/s	-	
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	86,58 %	115,50 %
Durée d'expiration	1,06 s	0,67 s	0,99 s	-	
DEMM	4,92 L/s	5,90 L/s	6,49 L/s	-	
DEMM/CVF	3,06 s-1	3,24 s-1	1,82 s-1	-	
DE75	8,11 L/s	7,20 L/s	9,15 L/s	-	
DE50	3,06 L/s	6,66 L/s	7,07 L/s	-	
DE25	5,55 L/s	3,54 L/s	3,85 L/s	-	