

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1988	<b>Profession</b> CHAUFFEUR POID LOURD
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 129	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,8 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 47 %

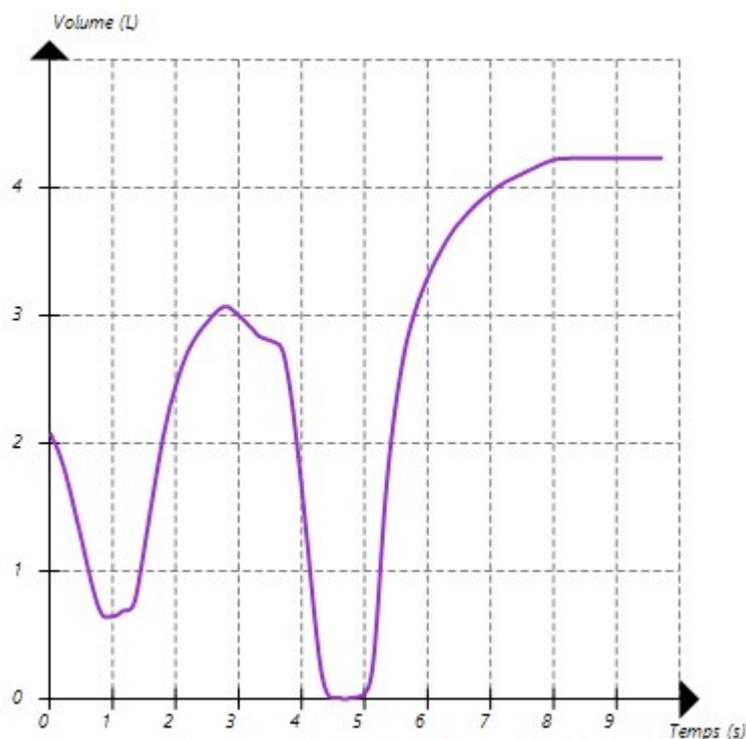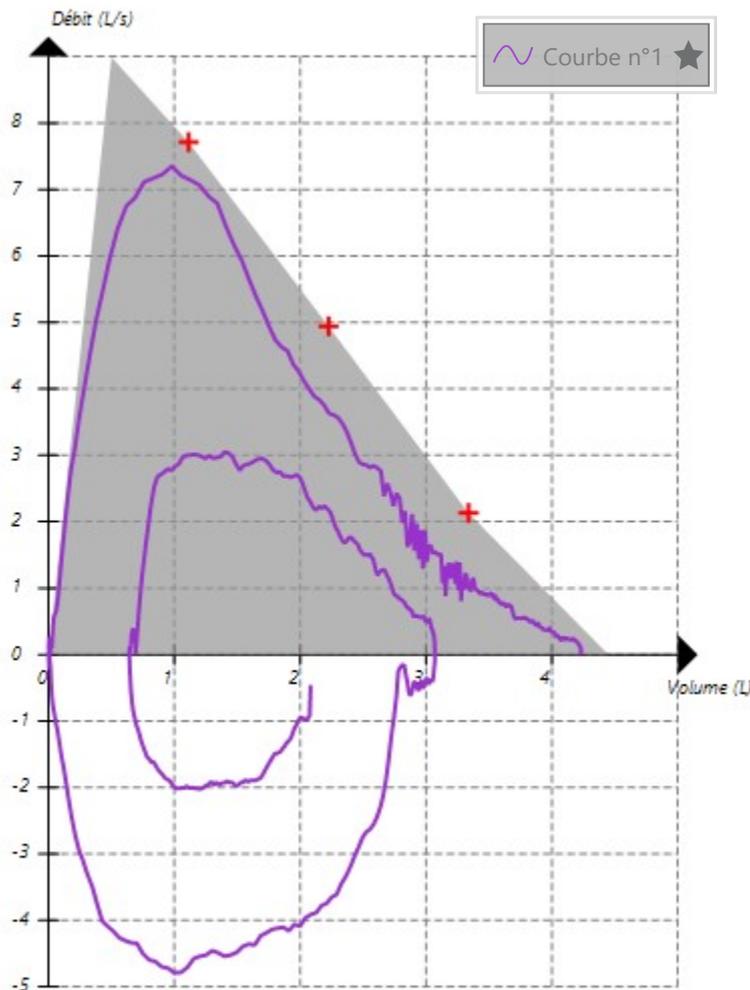

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,22 L	4,45 L	94,83 %
VEMS	3,41 L	3,73 L	91,42 %
DEP	7,41 L/s	8,99 L/s	82,42 %
VEMS/ CVF	80,81 %	80,77 %	100,05 %
Durée d'expiration	3,48 s	-	
DEMM	3,26 L/s	4,44 L/s	73,42 %
DEMM/ CVF	0,77 s-1	1,00 s-1	77,00 %
DE75	7,24 L/s	7,71 L/s	93,90 %
DE50	3,86 L/s	4,94 L/s	78,14 %
DE25	1,36 L/s	2,13 L/s	63,85 %