

**Nom** CAMARA  
**Prénom** N'FALY 2  
**Né le** 09/01/1997  
**Age** 27 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 410  
**Taille** 171 cm  
**Poids** 83 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** OPERATEUR CHARGEUSE  
**Entreprise** BCEIP  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,8 °C

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Humidité : 48 %

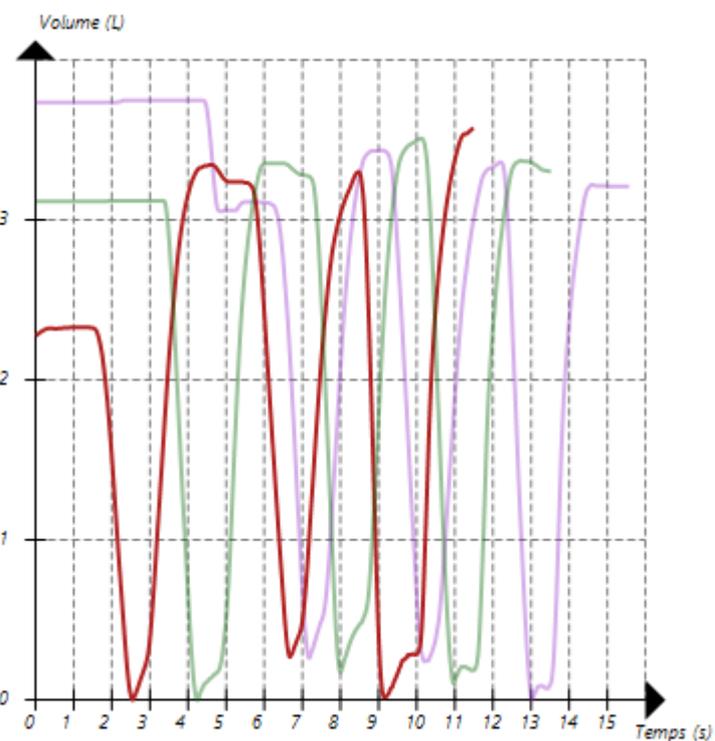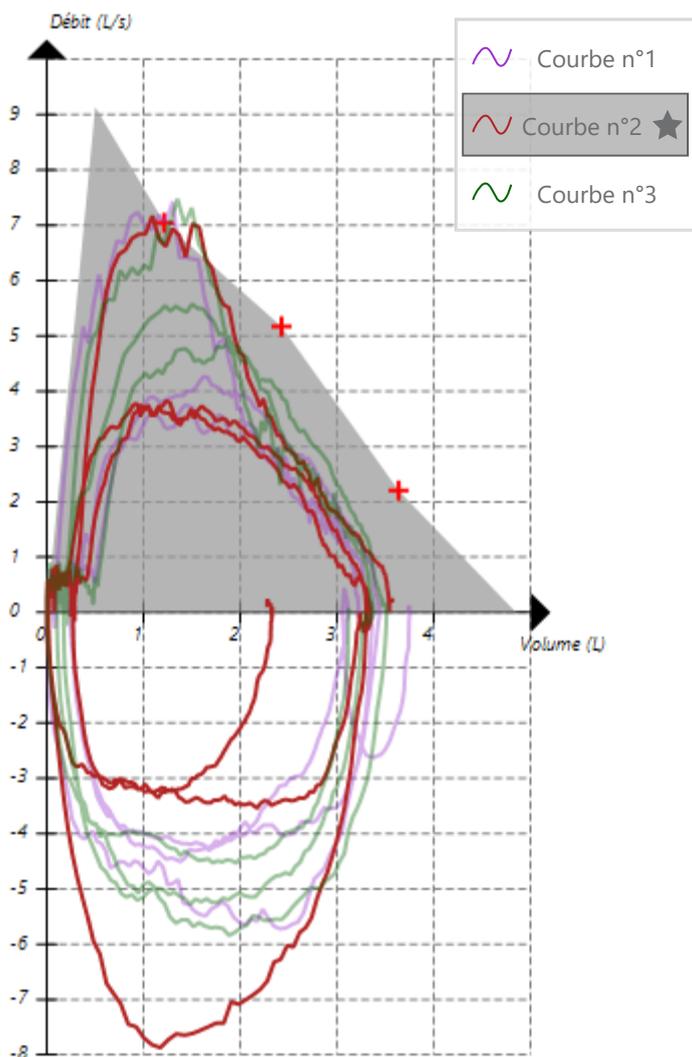

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,15 L	3,30 L	3,19 L	4,85 L	68,04 %
VEMS	3,15 L	3,20 L	3,18 L	4,07 L	78,62 %
DÉP	7,67 L/s	7,37 L/s	7,59 L/s	9,14 L/s	80,63 %
VEMS/CVF	100,00 %	96,97 %	99,69 %	83,86 %	115,63 %
Durée d'expiration	1,16 s	1,53 s	1,25 s	-	
DEMM	4,79 L/s	4,47 L/s	4,69 L/s	4,40 L/s	101,59 %
DEMM/CVF	1,52 s <sup>-1</sup>	1,35 s <sup>-1</sup>	1,47 s <sup>-1</sup>	0,91 s <sup>-1</sup>	148,35 %
DE75	7,11 L/s	7,02 L/s	5,94 L/s	7,05 L/s	99,57 %
DE50	5,27 L/s	4,97 L/s	5,59 L/s	5,17 L/s	96,13 %
DE25	2,54 L/s	2,23 L/s	2,89 L/s	2,20 L/s	101,36 %