

**Nom** CAMARA  
**Prénom** MANDJOU  
**Né le** 15/05/1984  
**Age** 39 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 254  
**Taille** 180 cm  
**Poids** 96 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** ADT  
**Entreprise** BCEIP  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 26,8 °C

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Humidité : 40 %

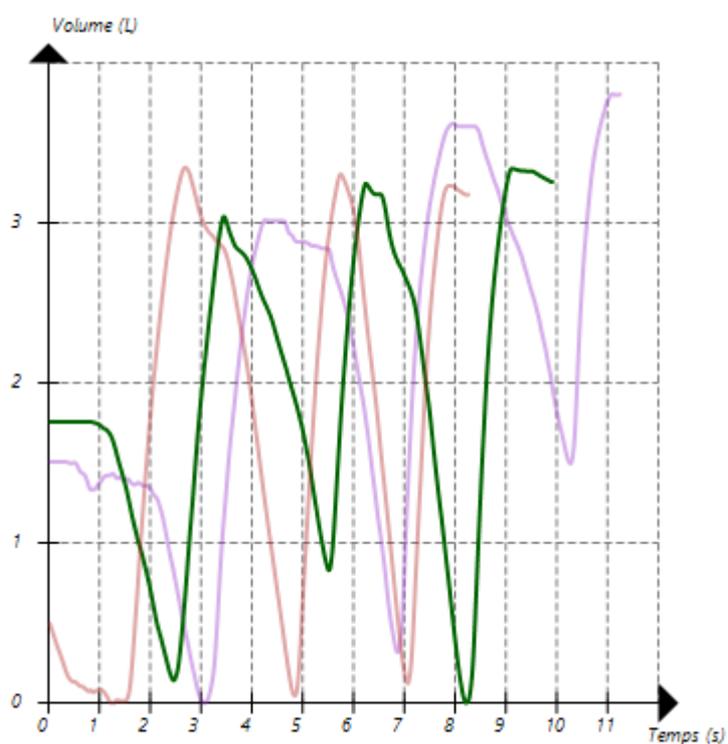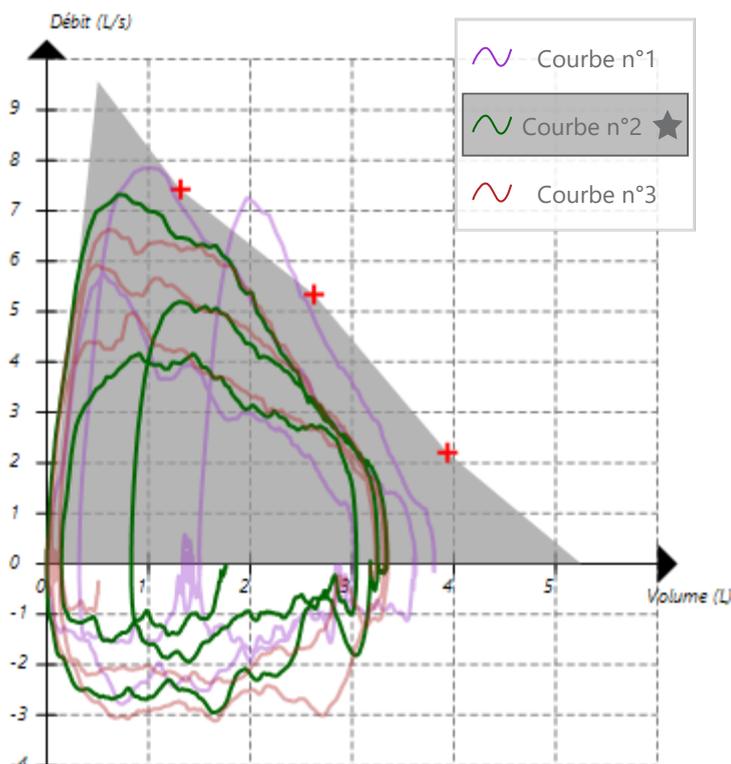

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,31 L	3,34 L	3,11 L	5,25 L	63,62 %
VEMS	3,30 L	3,34 L	3,11 L	4,32 L	77,31 %
DÉP	7,88 L/s	7,37 L/s	6,67 L/s	9,57 L/s	77,01 %
VEMS/CVF	99,70 %	100,00 %	100,00 %	82,60 %	121,07 %
Durée d'expiration	1,10 s	0,90 s	0,81 s	-	
DEMM	4,95 L/s	5,70 L/s	5,68 L/s	4,49 L/s	126,95 %
DEMM/CVF	1,50 s <sup>-1</sup>	1,71 s <sup>-1</sup>	1,83 s <sup>-1</sup>	0,86 s <sup>-1</sup>	198,84 %
DE75	7,72 L/s	6,97 L/s	6,11 L/s	7,42 L/s	93,94 %
DE50	5,36 L/s	6,31 L/s	5,96 L/s	5,34 L/s	118,16 %
DE25	2,82 L/s	3,58 L/s	3,94 L/s	2,20 L/s	162,73 %