

<b>Nom</b> SULLA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMOUDOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 18/06/1988	<b>Profession</b> PNEUMATIQUE
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 441	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 103 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Ttrouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 29,8 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Humidité : 55 %

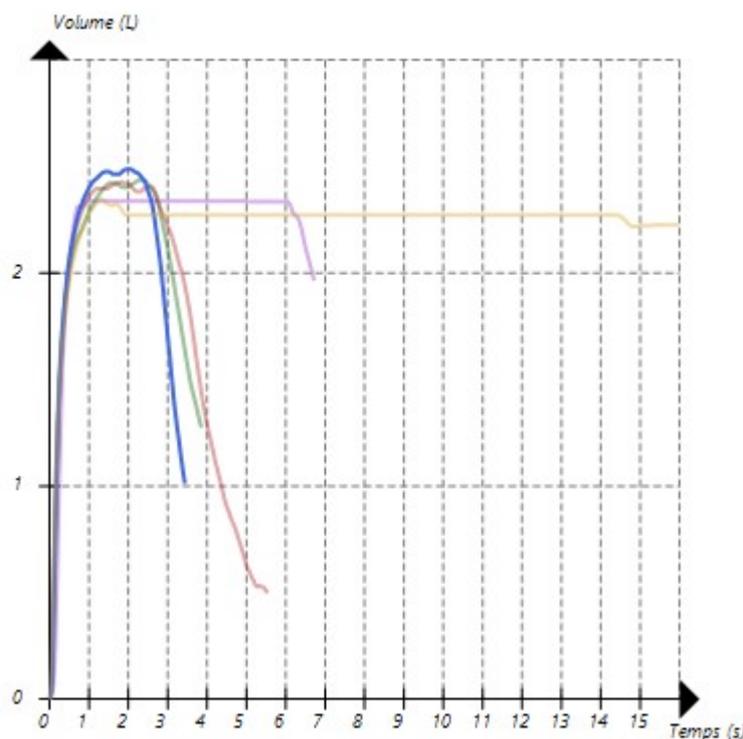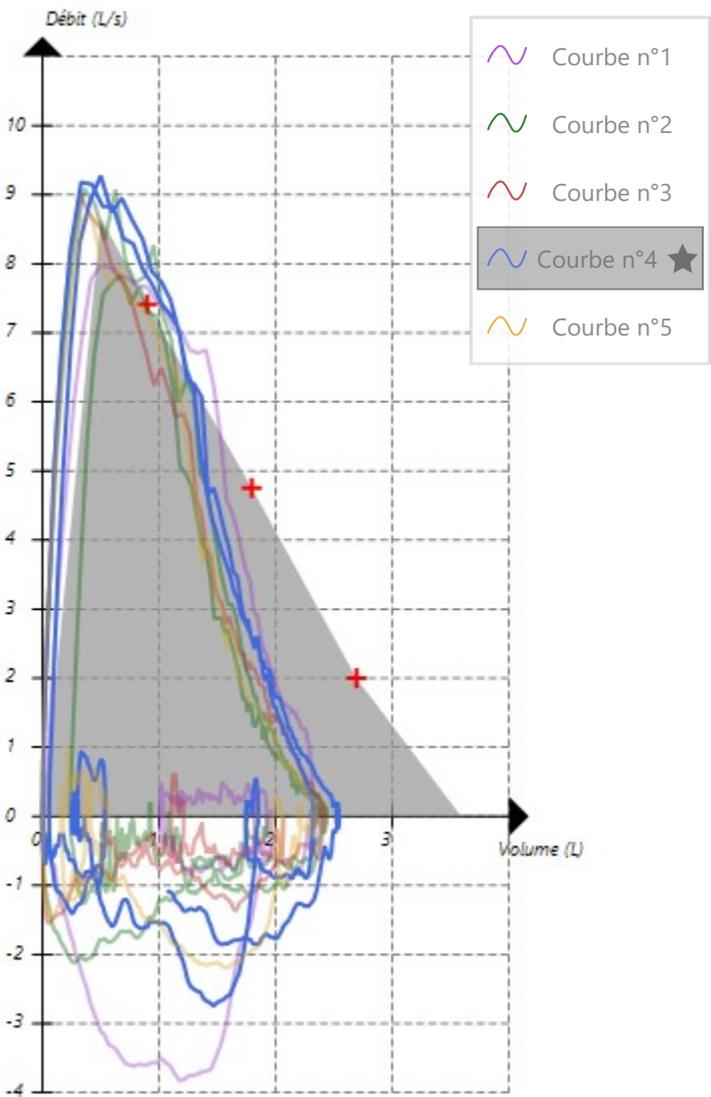

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Courbe n°5	Prédits	% Prédits
CVF	2,34 L	2,42 L	2,43 L	2,48 L	2,35 L	3,59 L	69,08 %
VEMS	2,34 L	2,30 L	2,36 L	2,42 L	2,29 L	3,04 L	79,61 %
DEP	8,09 L/s	9,33 L/s	9,35 L/s	10,03 L/s	9,20 L/s	8,67 L/s	115,69 %
VEMS/ CVF	100,00 %	95,04 %	97,12 %	97,58 %	97,45 %	80,94 %	120,56 %
Durée d'expiration	3,83 s	1,53 s	1,80 s	1,49 s	1,30 s	-	
DEMM	6,36 L/s	4,77 L/s	4,38 L/s	4,93 L/s	4,45 L/s	4,36 L/s	113,07 %
DEMM/ CVF	2,72 s-1	1,97 s-1	1,80 s-1	1,99 s-1	1,89 s-1	1,06 s-1	187,74 %
DE75	7,89 L/s	9,17 L/s	8,25 L/s	9,03 L/s	7,32 L/s	7,41 L/s	121,86 %
DE50	6,94 L/s	6,44 L/s	5,71 L/s	6,10 L/s	5,91 L/s	4,75 L/s	128,42 %
DE25	3,33 L/s	1,71 L/s	2,06 L/s	1,98 L/s	1,52 L/s	2,00 L/s	99,00 %