

<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOUCAR SIDIKI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 07/01/1992	<b>Profession</b> SOUDEUR
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 522	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 32,8 °C  
 Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Humidité : 54 %

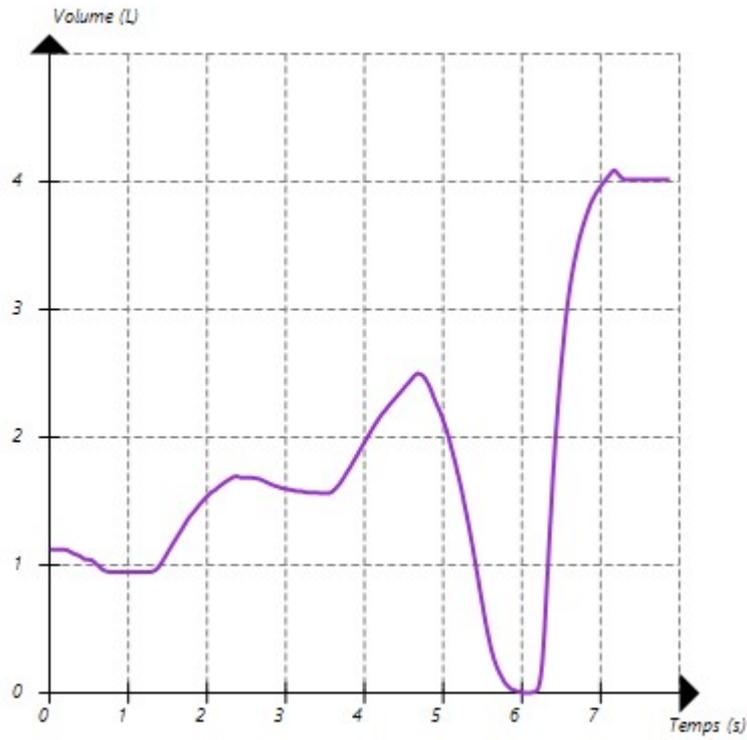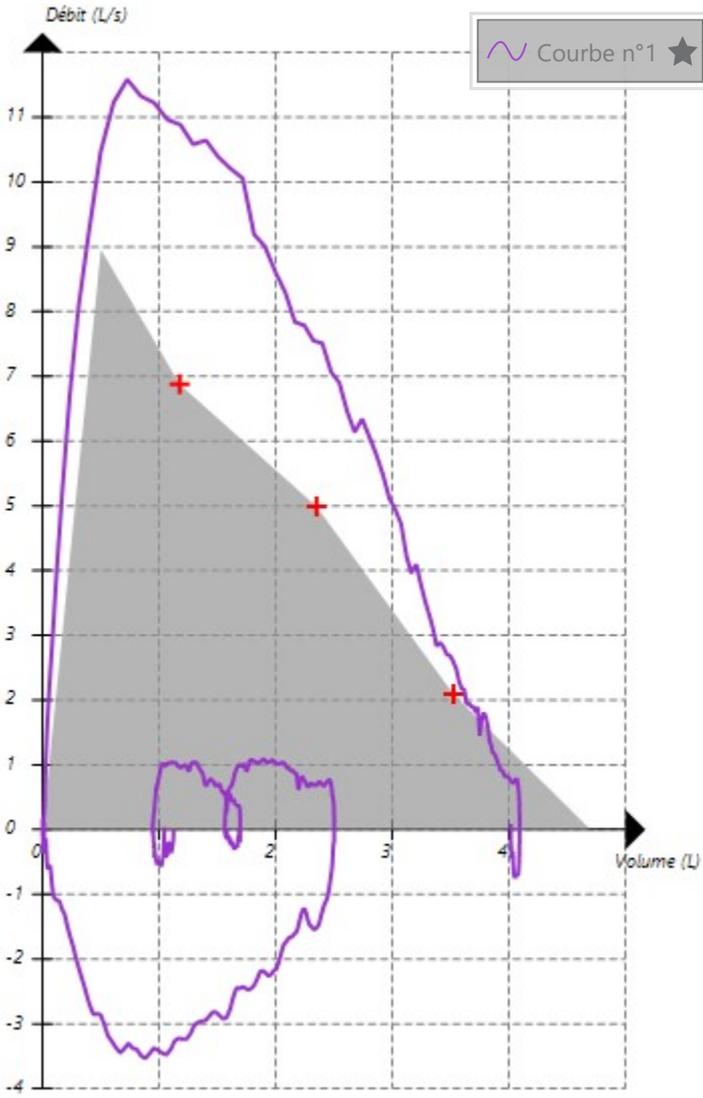

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,09 L	4,70 L	87,02 %
VEMS	4,09 L	3,93 L	104,07 %
DEP	11,70 L/s	8,96 L/s	130,58 %
VEMS/ CVF	100,00 %	83,34 %	119,99 %
Durée d'expiration	1,10 s	-	
DEMM	8,09 L/s	4,22 L/s	191,71 %
DEMM/ CVF	1,98 s-1	0,90 s-1	220,00 %
DE75	10,94 L/s	6,88 L/s	159,01 %
DE50	8,32 L/s	4,99 L/s	166,73 %
DE25	4,71 L/s	2,09 L/s	225,36 %