

**Nom** KEITA  
**Prénom** MAMADY  
**Né le** 01/01/1985  
**Age** 39 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 244  
**Taille** 184 cm  
**Poids** 88 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** ADT  
**Entreprise** BCEIP  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 26,9 °C

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Humidité : 42 %

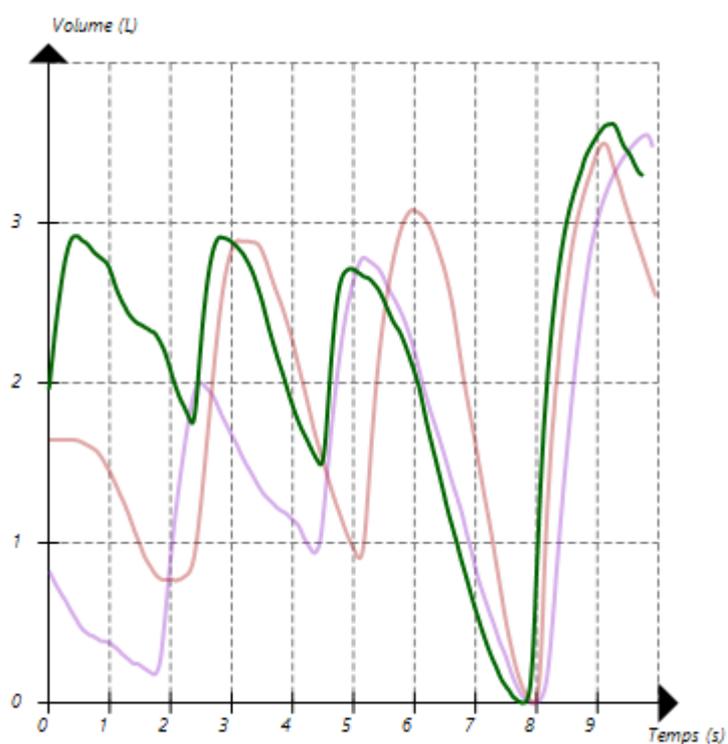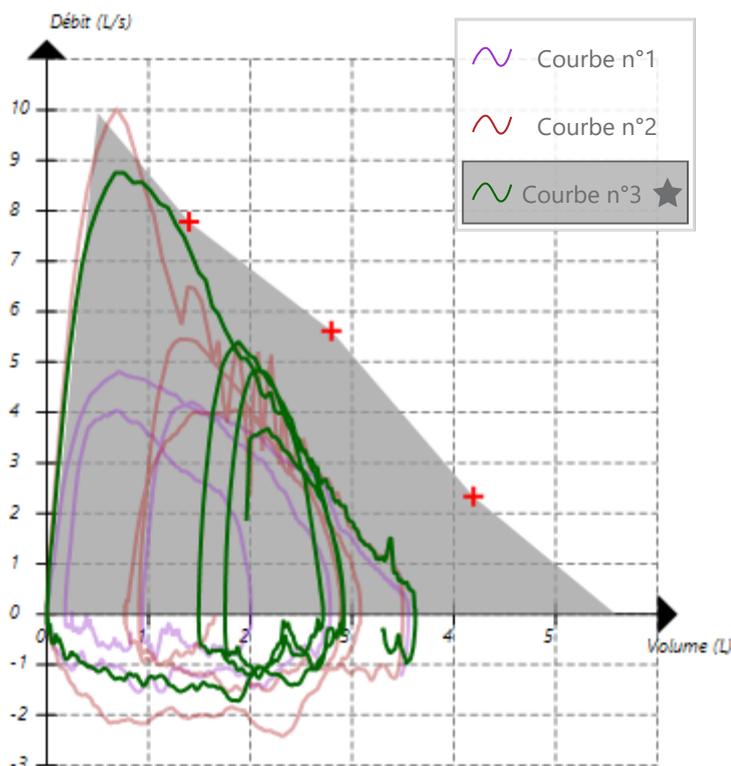

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,55 L	3,50 L	3,62 L	5,59 L	64,76 %
VEMS	3,21 L	3,47 L	3,49 L	4,59 L	76,03 %
DÉP	4,91 L/s	10,05 L/s	8,80 L/s	9,94 L/s	88,53 %
VEMS/ CVF	90,42 %	99,14 %	96,41 %	82,60 %	116,72 %
Durée d'expiration	1,89 s	1,15 s	1,47 s	-	
DEMM	3,72 L/s	4,80 L/s	5,11 L/s	4,72 L/s	108,26 %
DEMM/ CVF	1,05 s <sup>-1</sup>	1,37 s <sup>-1</sup>	1,41 s <sup>-1</sup>	0,84 s <sup>-1</sup>	167,86 %
DE75	4,72 L/s	9,00 L/s	8,62 L/s	7,78 L/s	110,80 %
DE50	3,82 L/s	3,66 L/s	5,39 L/s	5,62 L/s	95,91 %
DE25	2,73 L/s	2,96 L/s	2,57 L/s	2,33 L/s	110,30 %