

<b>Nom</b> SAVANE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SOULEYMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1989	<b>Profession</b> OPERATEUR NIVEULEUSE GRADER
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 33	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 50 %

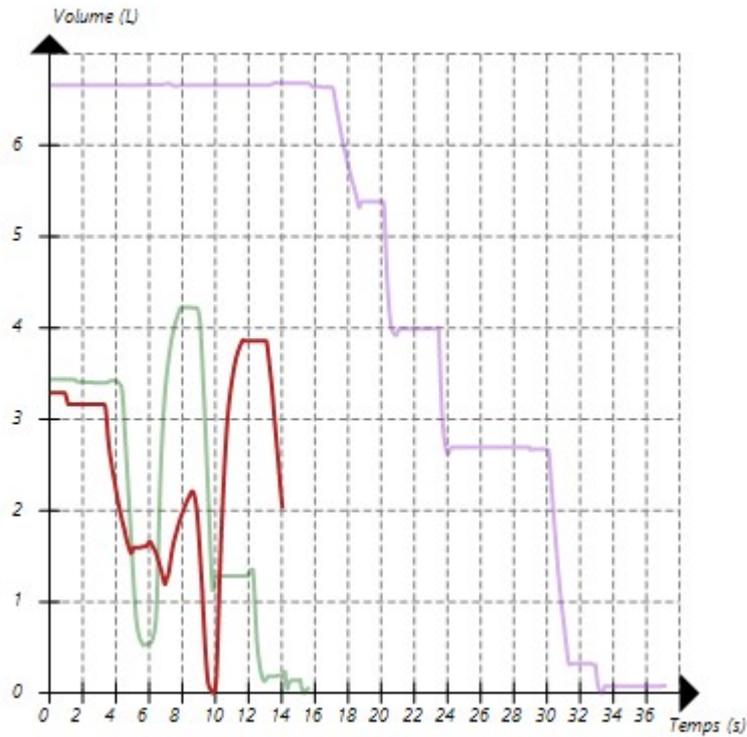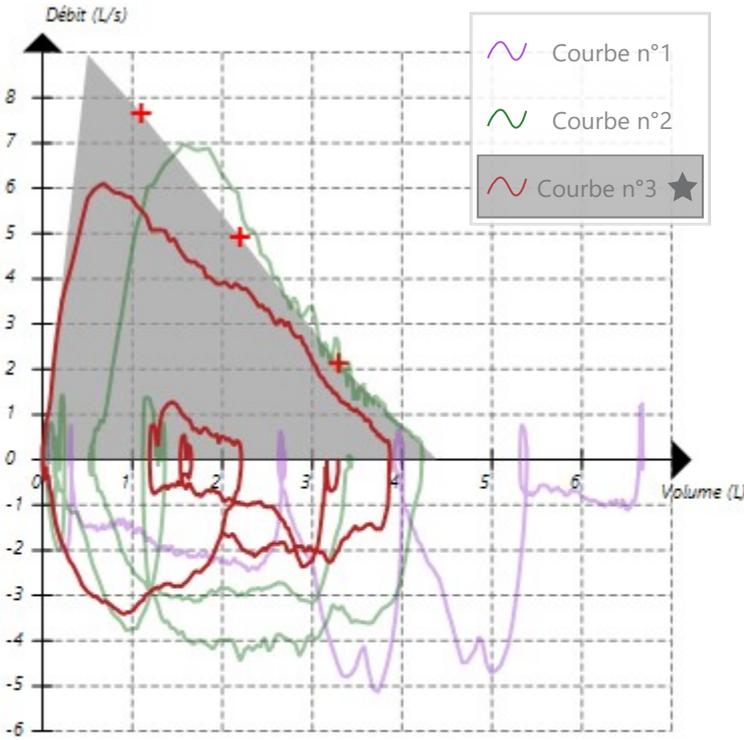

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	0,04 L	3,68 L	3,87 L	4,39 L	88,15 %
VEMS	0,02 L	3,37 L	3,47 L	3,70 L	93,78 %
DEP	2,02 L/s	7,04 L/s	6,19 L/s	8,96 L/s	69,08 %
VEMS/ CVF	50,00 %	91,58 %	89,66 %	81,12 %	110,53 %
Durée d'expiration	5,88 s	2,20 s	1,80 s	-	
DEMM	-	4,34 L/s	4,00 L/s	4,48 L/s	89,29 %
DEMM/ CVF	-	1,18 s-1	1,03 s-1	1,02 s-1	100,98 %
DE75	0,24 L/s	6,73 L/s	5,83 L/s	7,66 L/s	76,11 %
DE50	0,08 L/s	4,91 L/s	3,84 L/s	4,93 L/s	77,89 %
DE25	0,08 L/s	2,11 L/s	2,51 L/s	2,13 L/s	117,84 %