



| | |
|---------------------------------------|--|
| Nom SYLLA | Adresse COLEYAH |
| Prénom MOHAMED | Exposition |
| Né le 13/11/1990 | Profession FOREUR |
| Age 33 Ans | Entreprise BCEIP |
| Genre Masculin | Service |
| ID 743 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 186 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 100 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites Eccs/Zapletal | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur admin admin | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

| | |
|---|------------------------------------|
| Version du logiciel embarqué : V01.02.00 | Température ambiante : 28,1 °C |
| Numéro de série : 232707 | Pression atmosphérique : 100,8 kPa |
| Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 | Humidité : 62 % |

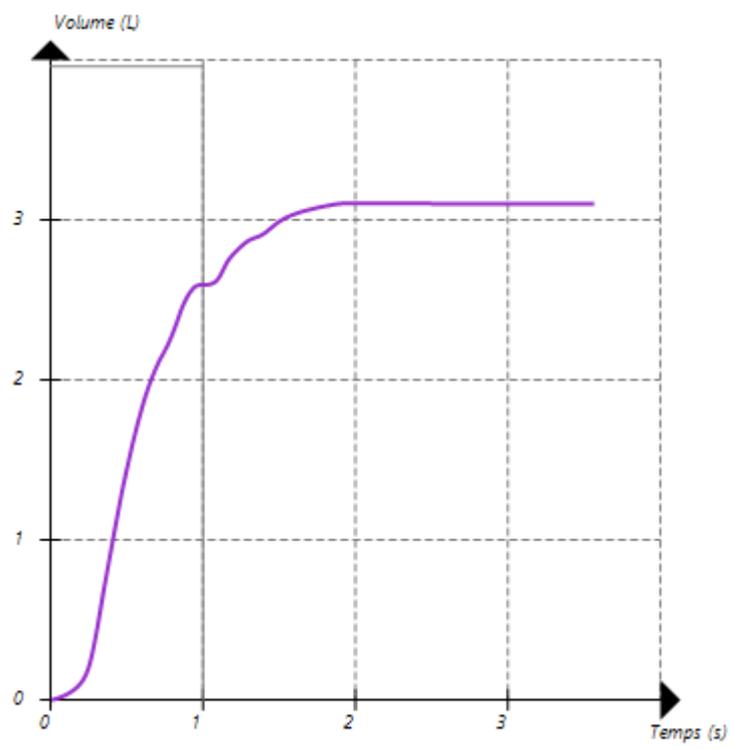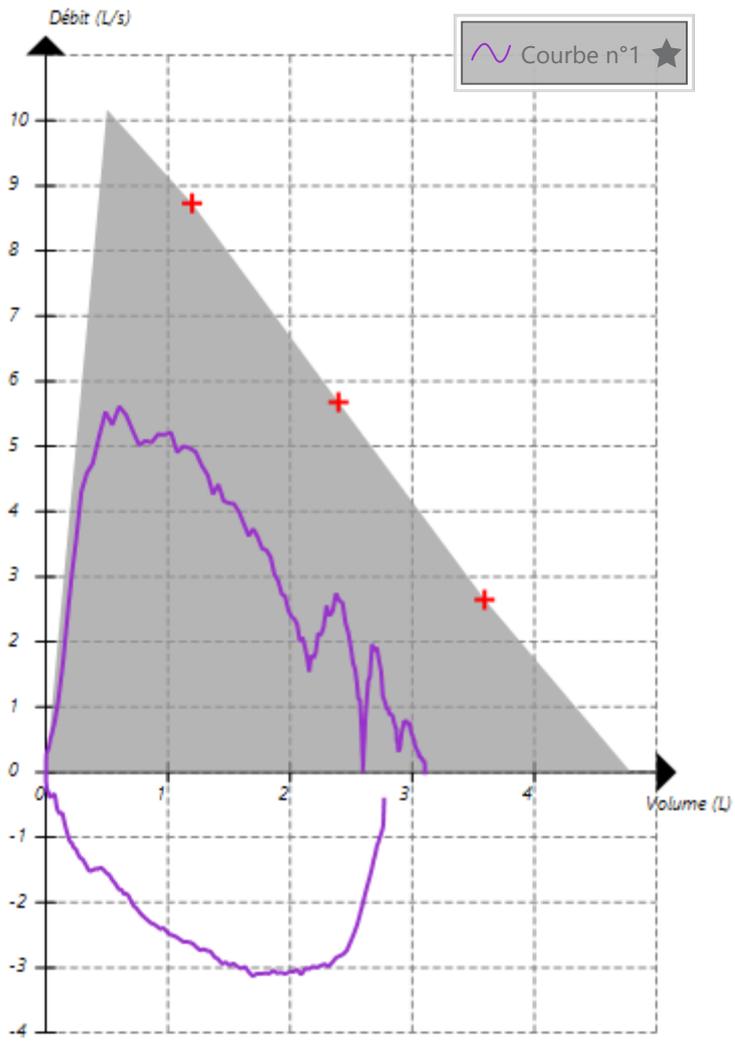

| Nom | Courbe n°1 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| CVF | 3,10 L | 4,79 L | 64,72 % |
| VEMS | 2,81 L | 3,96 L | 70,96 % |
| DÉP | 5,77 L/s | 10,17 L/s | 56,74 % |
| VEMS/CVF | 90,65 % | 81,30 % | 111,50 % |
| Durée d'expiration | 2,48 s | - | |
| DEMM | 3,46 L/s | 4,90 L/s | 70,61 % |
| DEMM/CVF | 1,12 s ⁻¹ | 0,89 s ⁻¹ | 125,84 % |
| DE75 | 4,84 L/s | 8,73 L/s | 55,44 % |
| DE50 | 4,15 L/s | 5,68 L/s | 73,06 % |
| DE25 | 2,58 L/s | 2,65 L/s | 97,36 % |