



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUGNA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 28/08/2000	<b>Profession</b> OPERATEUR
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 341	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 161 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 68 %

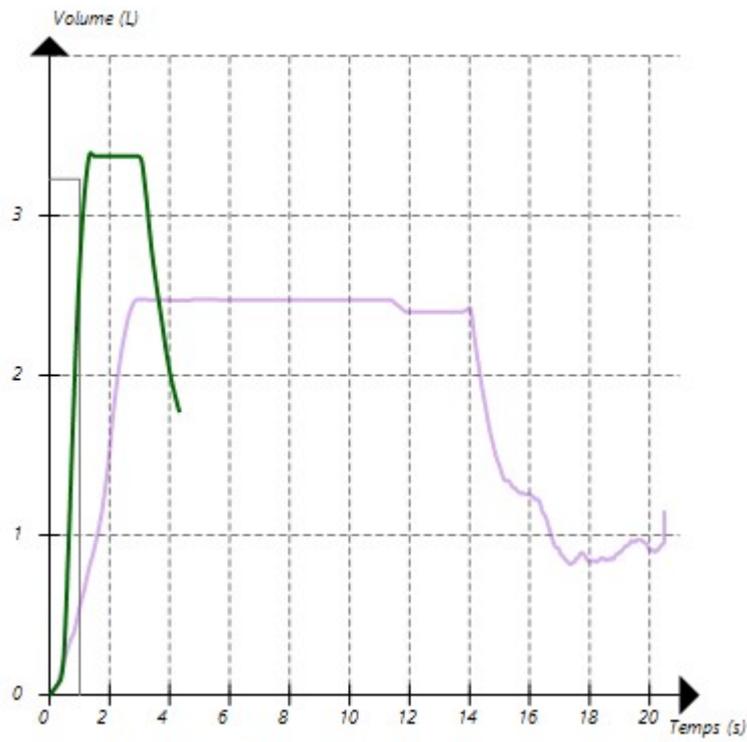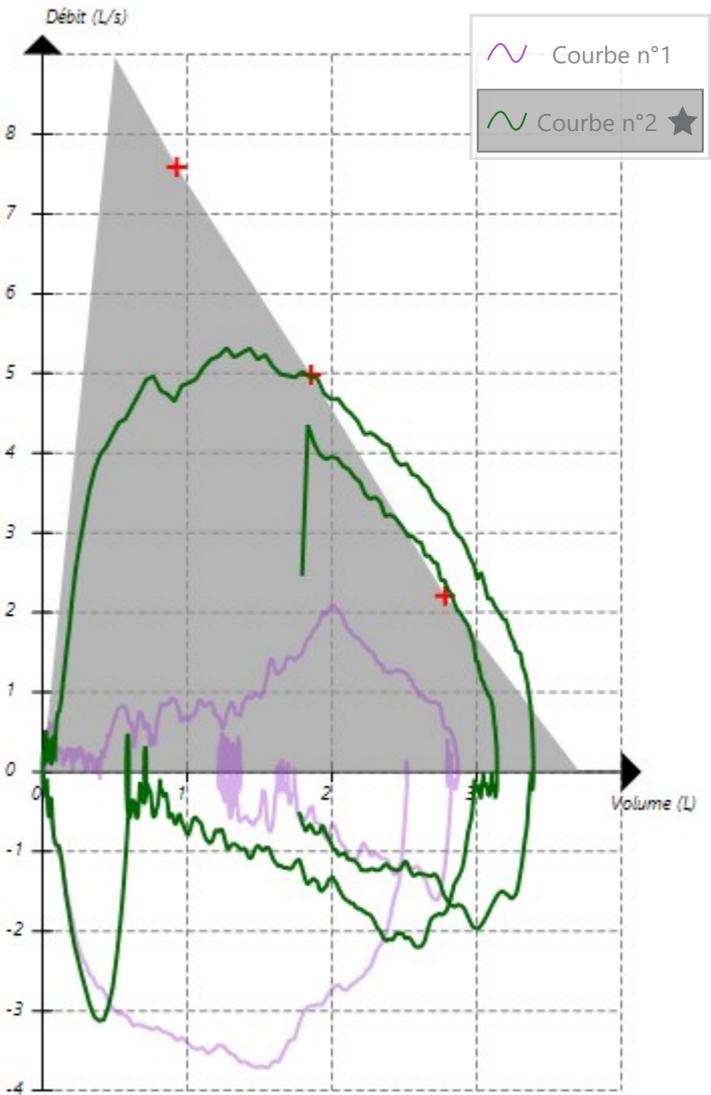

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,47 L	3,39 L	3,71 L	91,37 %
VEMS	1,98 L	3,39 L	3,23 L	104,95 %
DEP	2,15 L/s	5,46 L/s	8,97 L/s	60,87 %
VEMS/CVF	80,16 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	4,81 s	1,39 s	-	
DEMM	1,15 L/s	4,83 L/s	4,75 L/s	101,68 %
DEMM/CVF	0,47 s-1	1,42 s-1	1,11 s-1	127,93 %
DE75	0,66 L/s	4,75 L/s	7,59 L/s	62,58 %
DE50	1,23 L/s	4,98 L/s	4,98 L/s	100,00 %
DE25	1,53 L/s	3,64 L/s	2,21 L/s	164,71 %