



<b>Nom</b> GUILAVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MICHEL	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 27/03/1988	<b>Profession</b> SUPERVISEUR HSE
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 324	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 68 %

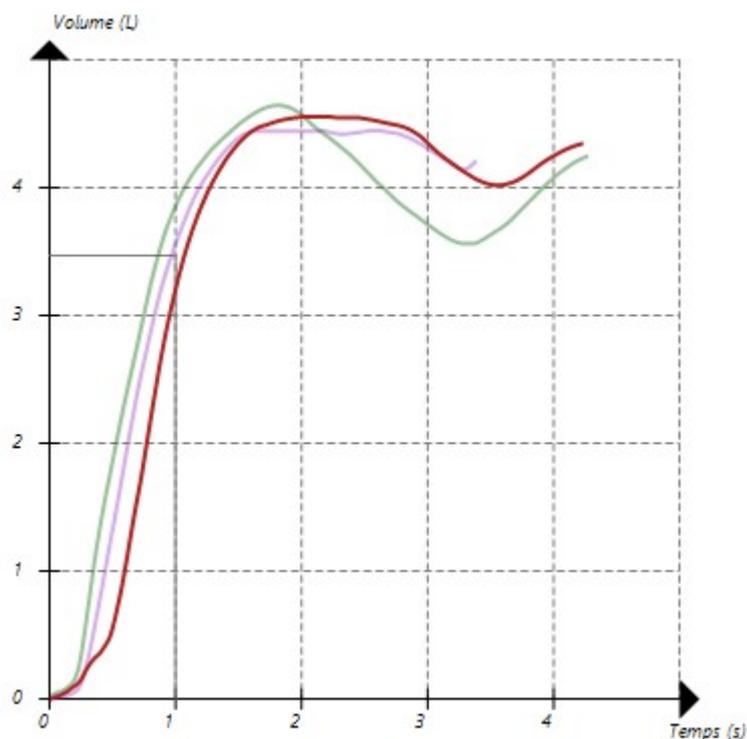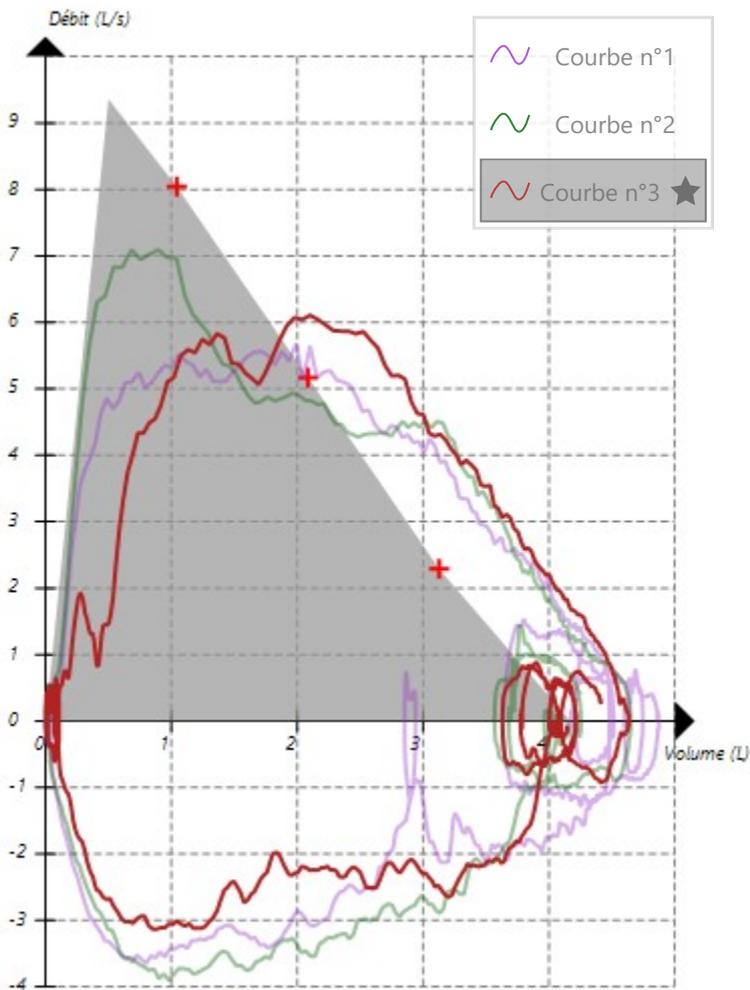

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,45 L	4,63 L	4,56 L	4,17 L	109,35 %
VEMS	4,12 L	4,19 L	4,28 L	3,47 L	123,34 %
DEP	5,86 L/s	7,62 L/s	6,15 L/s	9,36 L/s	65,71 %
VEMS/CVF	92,58 %	90,50 %	93,86 %	80,77 %	116,21 %
Durée d'expiration	2,16 s	1,86 s	2,03 s	-	
DEMM	4,80 L/s	4,68 L/s	5,24 L/s	4,55 L/s	115,16 %
DEMM/CVF	1,08 s-1	1,01 s-1	1,15 s-1	0,95 s-1	121,05 %
DE75	5,40 L/s	6,13 L/s	5,71 L/s	8,04 L/s	71,02 %
DE50	5,10 L/s	4,52 L/s	5,88 L/s	5,17 L/s	113,73 %
DE25	3,15 L/s	3,41 L/s	3,46 L/s	2,29 L/s	151,09 %