

<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAWATA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 17/08/2000	<b>Profession</b> FLAGWOMAN
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 380	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 56 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 25,8 °C  
 Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Humidité : 48 %

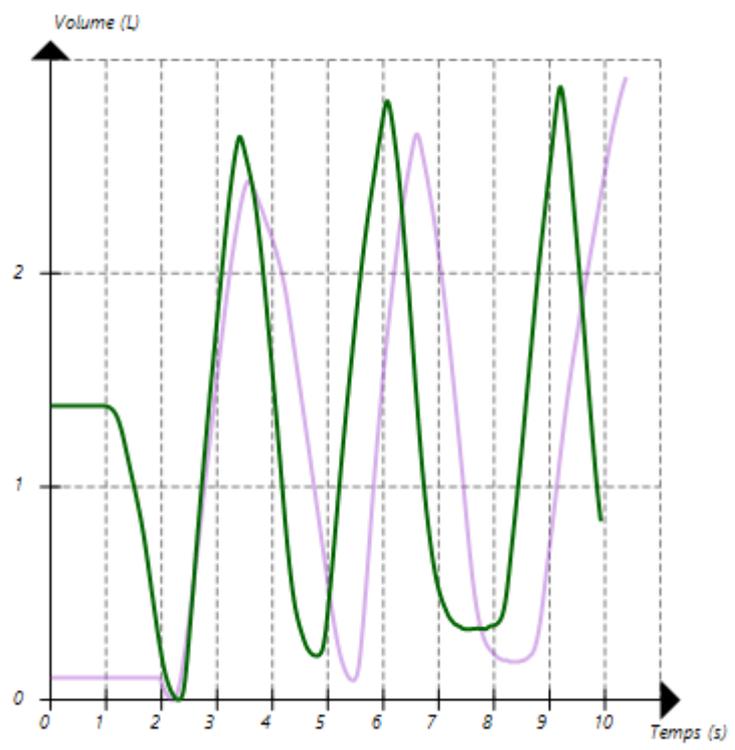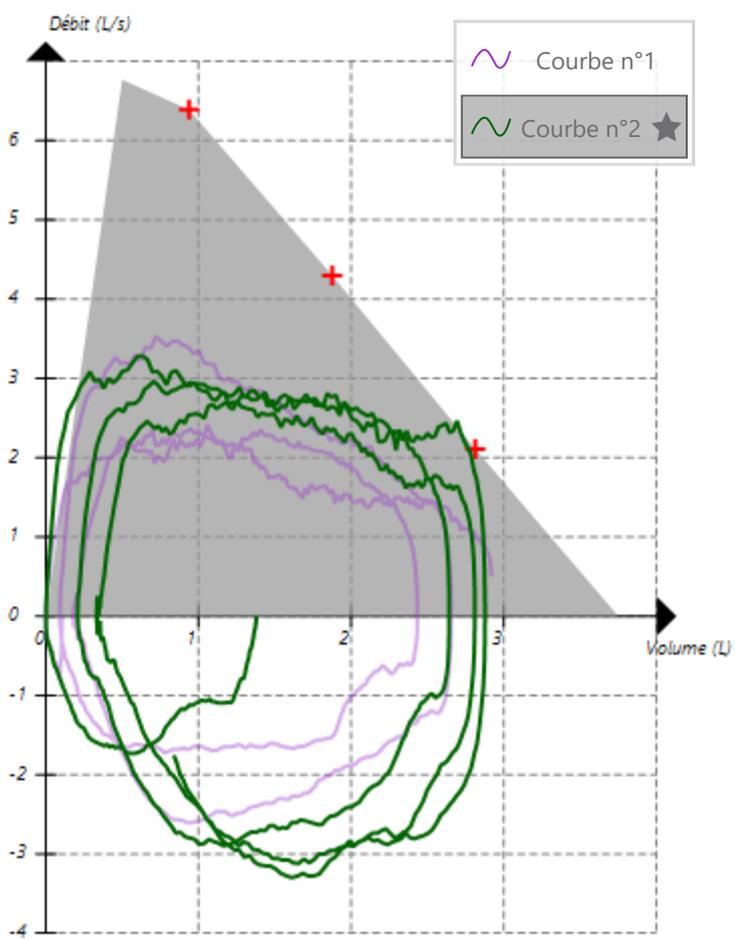

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,56 L	2,64 L	3,75 L	70,40 %
VEMS	2,53 L	2,64 L	3,22 L	81,99 %
DÉP	3,57 L/s	3,35 L/s	6,77 L/s	49,48 %
VEMS/ CVF	98,83 %	100,00 %	86,78 %	115,23 %
Durée d'expiration	1,15 s	1,12 s	-	
DEMM	2,82 L/s	2,86 L/s	3,83 L/s	74,67 %
DEMM/ CVF	1,10 s <sup>-1</sup>	1,08 s <sup>-1</sup>	1,02 s <sup>-1</sup>	105,88 %
DE75	3,56 L/s	3,26 L/s	6,39 L/s	51,02 %
DE50	2,78 L/s	2,82 L/s	4,30 L/s	65,58 %
DE25	2,17 L/s	2,56 L/s	2,11 L/s	121,33 %