



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AMARA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1996	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 531	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 79 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 56 %

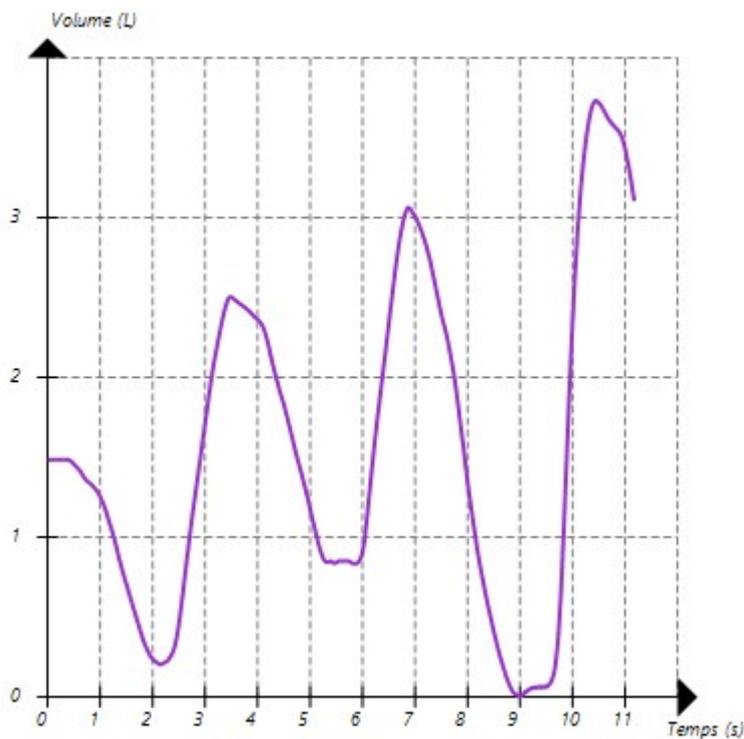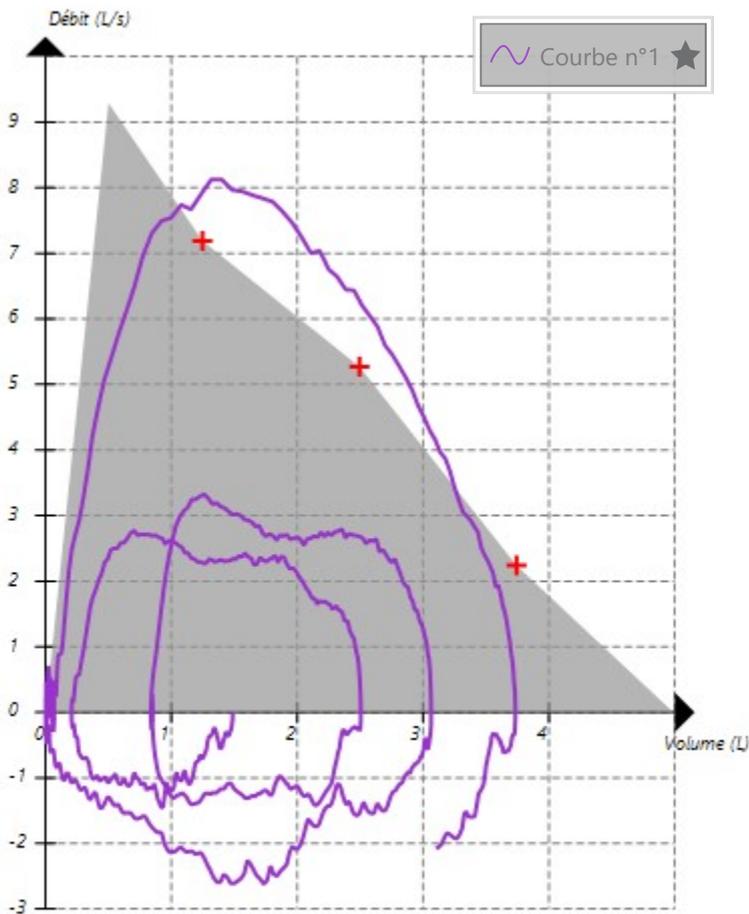

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,67 L	4,99 L	73,55 %
VEMS	3,67 L	4,18 L	87,80 %
DEP	8,21 L/s	9,29 L/s	88,37 %
VEMS/ CVF	100,00 %	83,76 %	119,39 %
Durée d'expiration	0,94 s	-	
DEMM	7,25 L/s	4,48 L/s	161,83 %
DEMM/ CVF	1,98 s-1	0,90 s-1	220,00 %
DE75	7,61 L/s	7,19 L/s	105,84 %
DE50	7,59 L/s	5,27 L/s	144,02 %
DE25	5,26 L/s	2,24 L/s	234,82 %