



Nom BAH	Adresse
Prénom AISSATOU	Exposition
Né le 01/01/1997	Profession SPOTEUR
Age 27 Ans	Entreprise BCEIP
Genre Féminin	Service
ID 205	Fumeur Non fumeur
Taille 166 cm	Prescripteur:
Poids 48 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	
Opérateur admin admin	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 27,3 °C
 Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique : 93,3 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 56 %

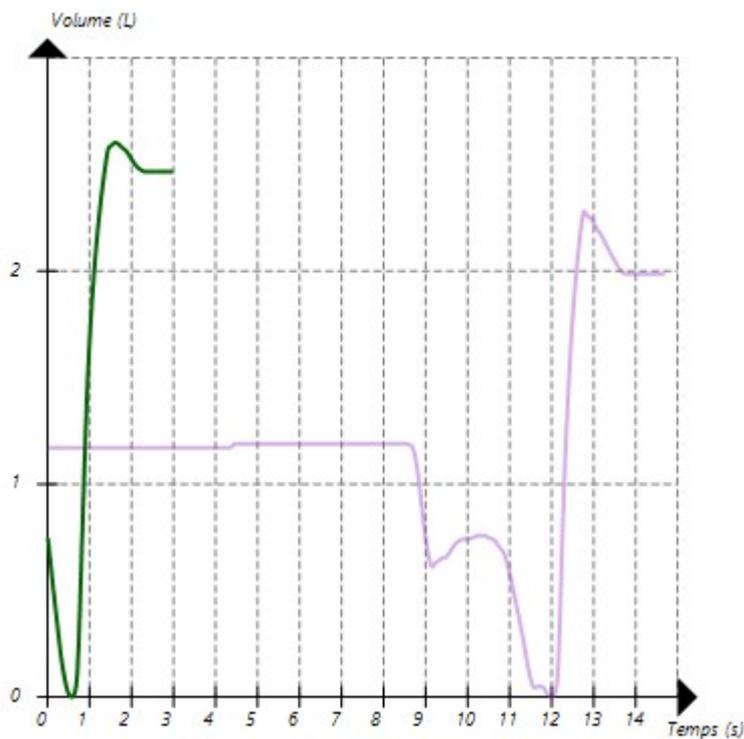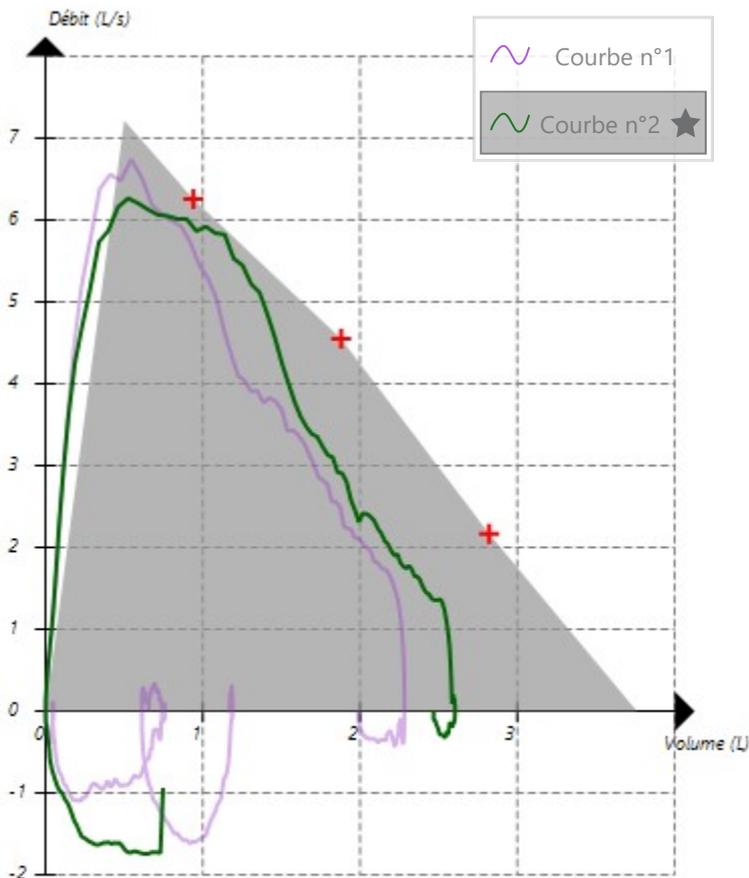

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,28 L	2,60 L	3,76 L	69,15 %
VEMS	2,28 L	2,60 L	3,28 L	79,27 %
DEP	6,84 L/s	6,37 L/s	7,22 L/s	88,23 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	83,92 %	119,16 %
Durée d'expiration	0,78 s	1,04 s	-	
DEMM	4,60 L/s	4,58 L/s	4,08 L/s	112,25 %
DEMM/CVF	2,02 s-1	1,76 s-1	1,09 s-1	161,47 %
DE75	6,80 L/s	6,07 L/s	6,26 L/s	96,96 %
DE50	4,55 L/s	5,22 L/s	4,55 L/s	114,73 %
DE25	3,01 L/s	2,53 L/s	2,17 L/s	116,59 %