



<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FREBORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 13/05/1999	<b>Profession</b> OPERATEUR EXACVATEUR
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 86	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 58 %

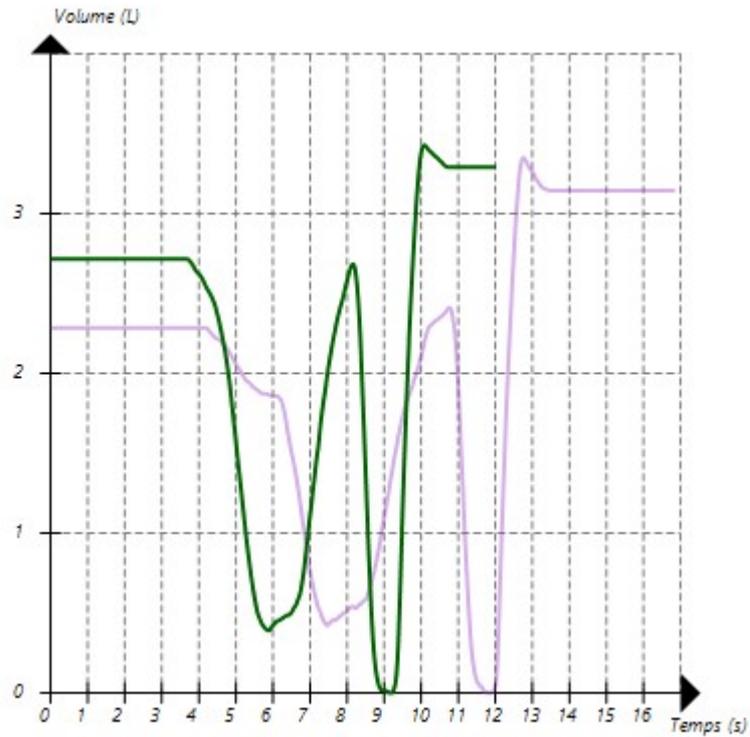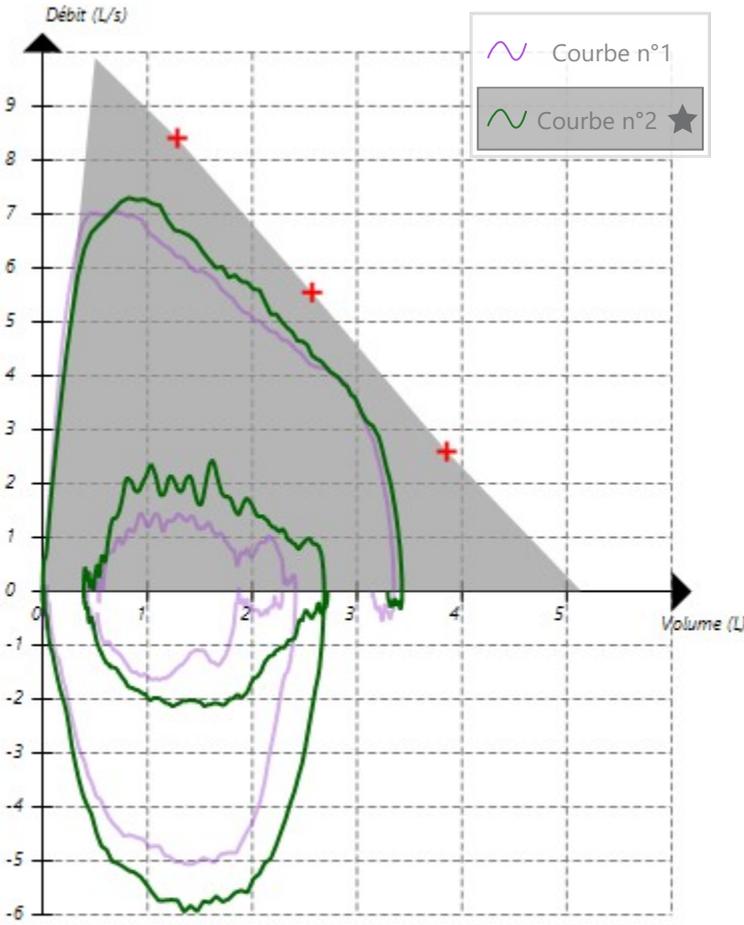

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,35 L	3,43 L	5,14 L	66,73 %
VEMS	3,35 L	3,43 L	4,35 L	78,85 %
DEP	7,11 L/s	7,33 L/s	9,90 L/s	74,04 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,92 s	0,91 s	-	
DEMM	5,66 L/s	6,01 L/s	5,05 L/s	119,01 %
DEMM/ CVF	1,69 s-1	1,75 s-1	0,98 s-1	178,57 %
DE75	6,95 L/s	7,27 L/s	8,41 L/s	86,44 %
DE50	5,67 L/s	6,05 L/s	5,55 L/s	109,01 %
DE25	4,30 L/s	4,30 L/s	2,60 L/s	165,38 %