



<b>Nom</b> SANGARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SOULEYMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/06/1991	<b>Profession</b> CHAUFFEUR CAMION
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 588	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,1 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 101,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 56 %

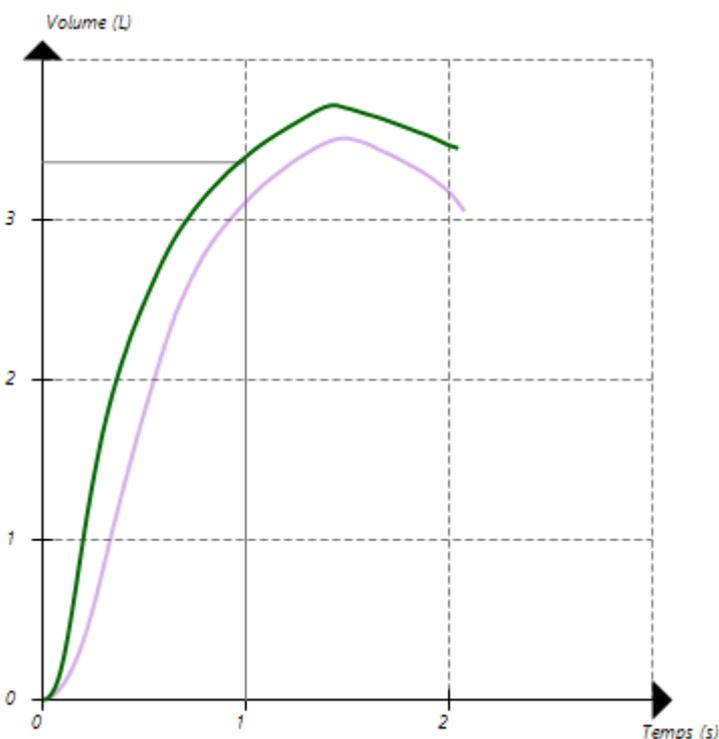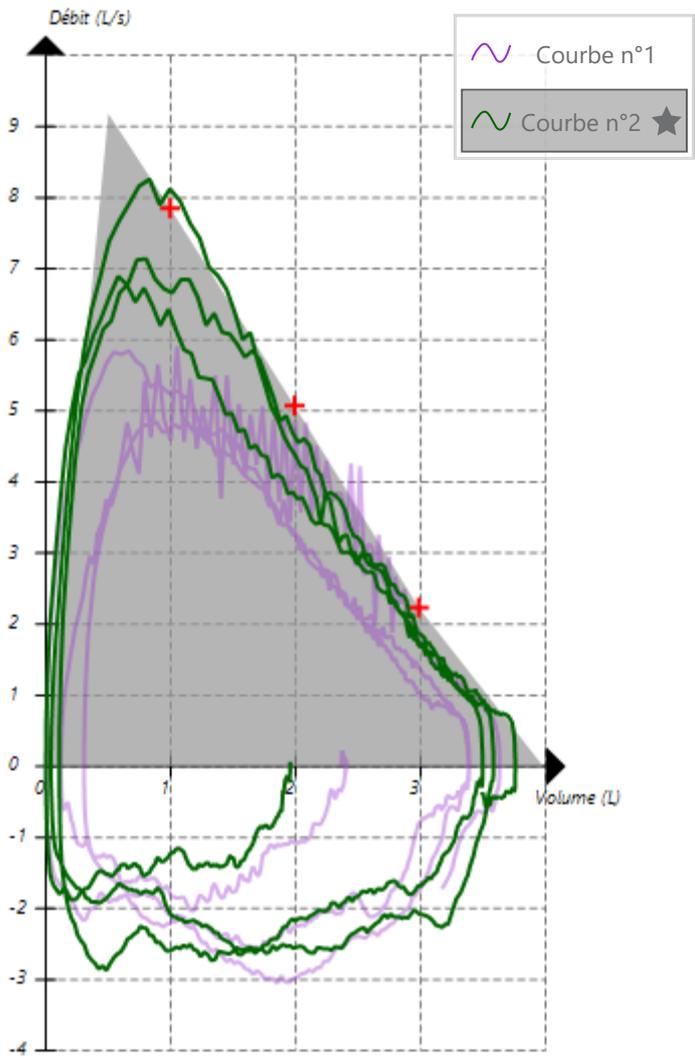

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,51 L	3,72 L	3,98 L	93,47 %
VEMS	3,28 L	3,47 L	3,36 L	103,27 %
DÉP	6,74 L/s	8,43 L/s	9,18 L/s	91,83 %
VEMS/CVF	93,45 %	93,28 %	81,30 %	114,74 %
Durée d'expiration	1,48 s	1,44 s	-	
DEMM	4,17 L/s	4,45 L/s	4,58 L/s	97,16 %
DEMM/CVF	1,19 s-1	1,20 s-1	1,00 s-1	120,00 %
DE75	4,53 L/s	8,31 L/s	7,85 L/s	105,86 %
DE50	2,85 L/s	4,58 L/s	5,07 L/s	90,34 %
DE25	2,81 L/s	2,48 L/s	2,23 L/s	111,21 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: