

**Nom** KOMARA  
**Prénom** SIDIKI  
**Né le** 01/01/1990  
**Age** 34 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 246  
**Taille** 166 cm  
**Poids** 83 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** CONDUCTEUR ADT ARTICULATED  
**Entreprise** BCEIP  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 25,7 °C

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Humidité : 44 %

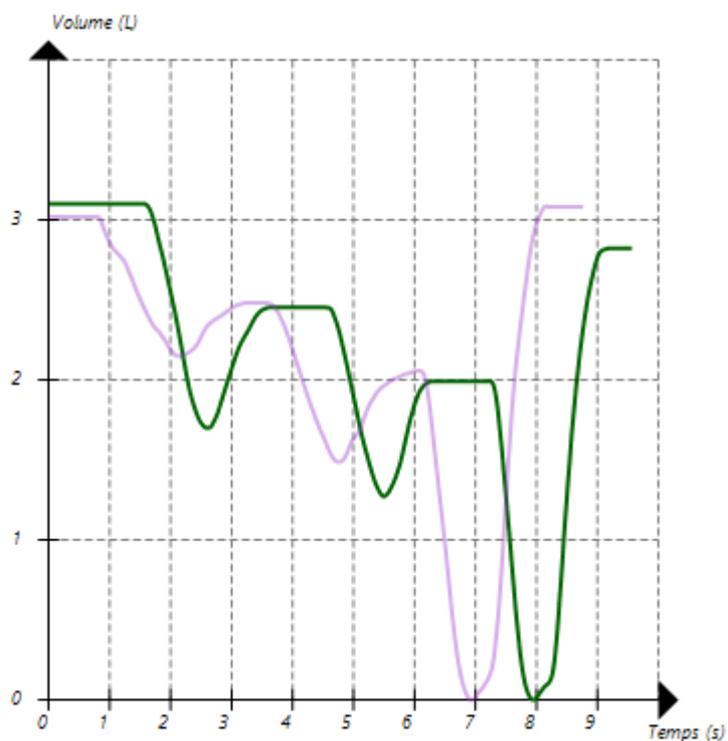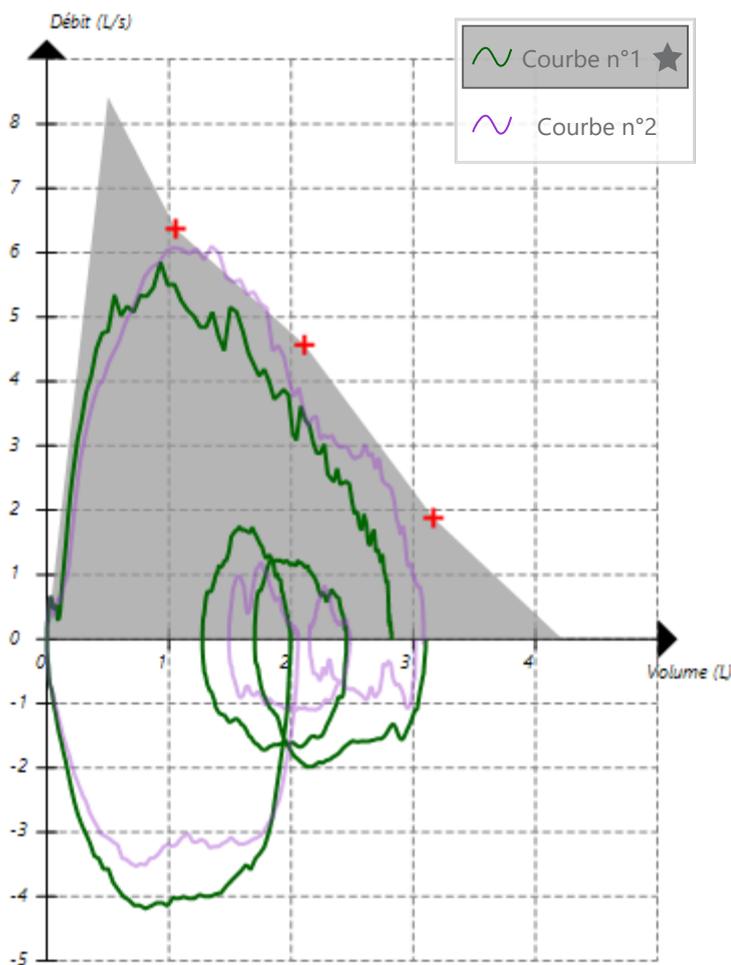

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,82 L	3,09 L	4,22 L	66,82 %
VEMS	2,82 L	3,09 L	3,54 L	79,66 %
DÉP	5,91 L/s	6,31 L/s	8,42 L/s	70,19 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	83,13 %	120,29 %
Durée d'expiration	1,24 s	1,23 s	-	
DEMM	4,68 L/s	4,99 L/s	3,86 L/s	121,24 %
DEMM/CVF	1,66 s-1	1,61 s-1	0,91 s-1	182,42 %
DE75	4,93 L/s	5,45 L/s	6,37 L/s	77,39 %
DE50	4,92 L/s	5,50 L/s	4,57 L/s	107,66 %
DE25	3,44 L/s	3,38 L/s	1,88 L/s	182,98 %