



<b>Nom</b> LOUA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SENY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 28/01/1988	<b>Profession</b> INGENIEUR DES MINE
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 368	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,5 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 59 %

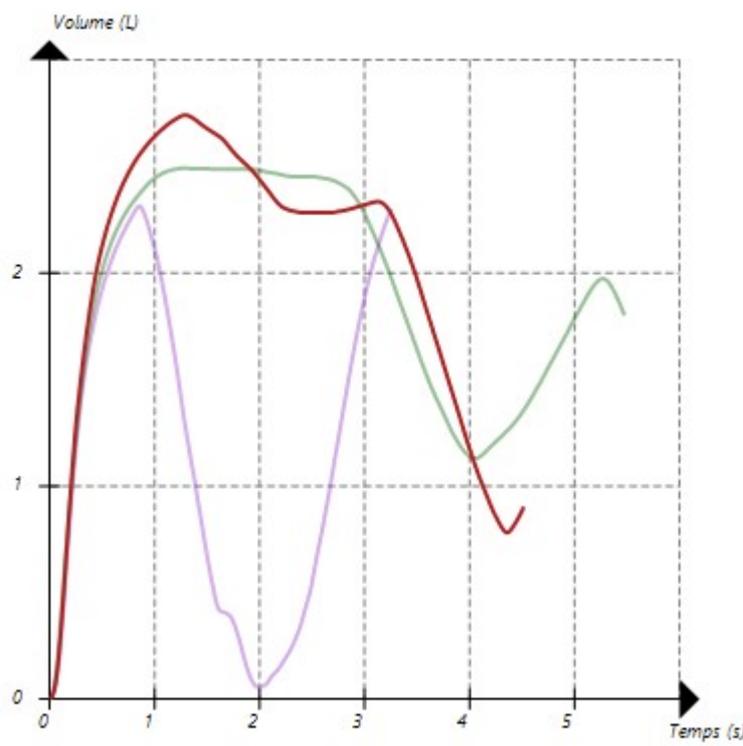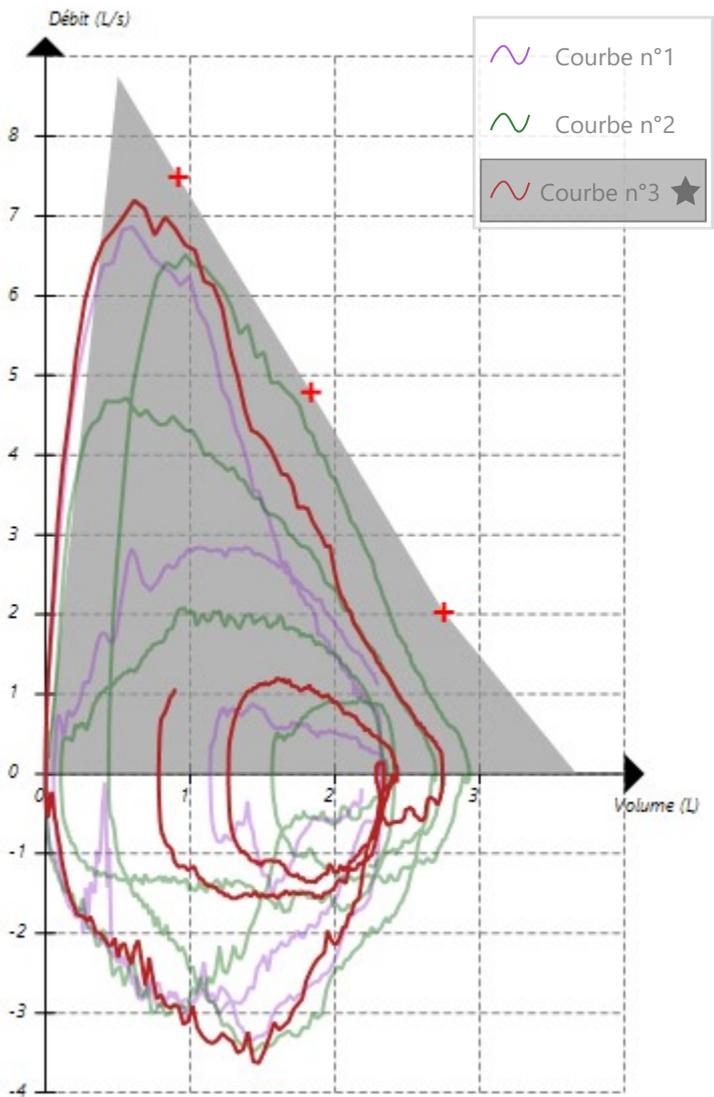

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,32 L	2,49 L	2,74 L	3,67 L	74,66 %
VEMS	2,32 L	2,46 L	2,67 L	3,10 L	86,13 %
DEP	6,95 L/s	6,62 L/s	7,42 L/s	8,75 L/s	84,80 %
VEMS/ CVF	100,00 %	98,80 %	97,45 %	80,77 %	120,65 %
Durée d'expiration	0,86 s	1,25 s	1,29 s	-	
DEMM	4,56 L/s	4,39 L/s	4,47 L/s	4,36 L/s	102,52 %
DEMM/ CVF	1,97 s-1	1,76 s-1	1,63 s-1	1,03 s-1	158,25 %
DE75	6,88 L/s	6,40 L/s	7,23 L/s	7,49 L/s	96,53 %
DE50	5,38 L/s	4,76 L/s	4,55 L/s	4,79 L/s	94,99 %
DE25	2,37 L/s	2,38 L/s	2,17 L/s	2,03 L/s	106,90 %