

**Nom** CHERIF  
**Prénom** MOHAMED  
**Né le** 01/01/1993  
**Age** 31 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 310  
**Taille** 162 cm  
**Poids** 60 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** OPERATEUR EXCAVATEUR  
**Entreprise** BCEIP  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,7 °C

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Humidité : 42 %

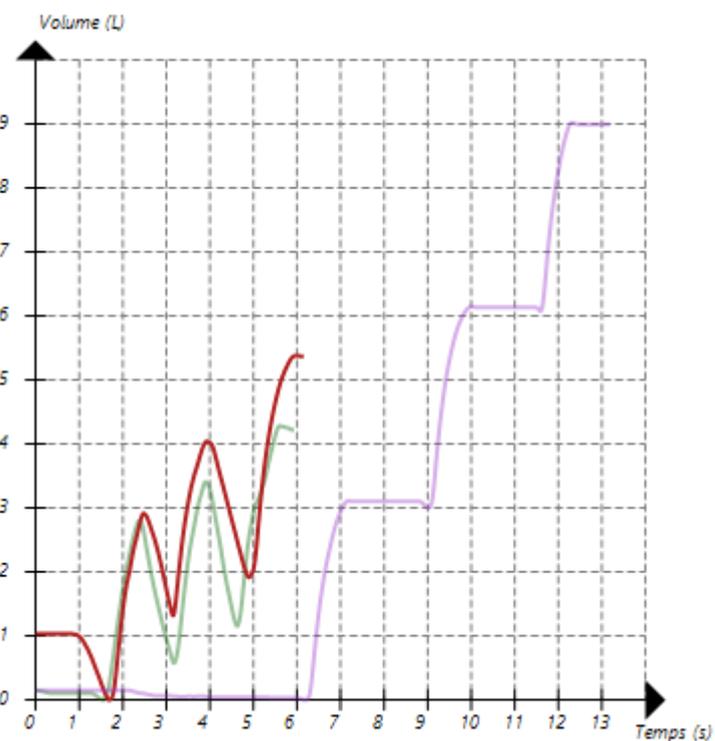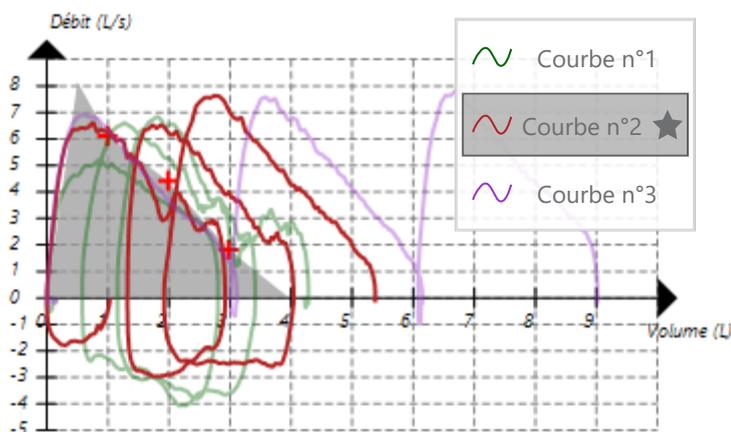

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,13 L	3,46 L	2,94 L	3,97 L	87,15 %
VEMS	3,13 L	3,46 L	2,94 L	3,36 L	102,98 %
DÉP	7,04 L/s	7,88 L/s	7,96 L/s	8,15 L/s	96,69 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,44 %	119,85 %
Durée d'expiration	0,98 s	1,05 s	0,73 s	-	
DEMM	3,21 L/s	5,12 L/s	5,43 L/s	3,73 L/s	137,27 %
DEMM/ CVF	1,03 s-1	1,48 s-1	1,85 s-1	0,94 s-1	157,45 %
DE75	6,33 L/s	7,86 L/s	7,56 L/s	6,12 L/s	128,43 %
DE50	3,24 L/s	5,29 L/s	5,42 L/s	4,41 L/s	119,95 %
DE25	2,86 L/s	3,20 L/s	3,75 L/s	1,83 L/s	174,86 %