

<b>Nom</b> BILIVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> TOKPA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/02/1998	<b>Profession</b> SPOTERS
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 559	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 30 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 63 %

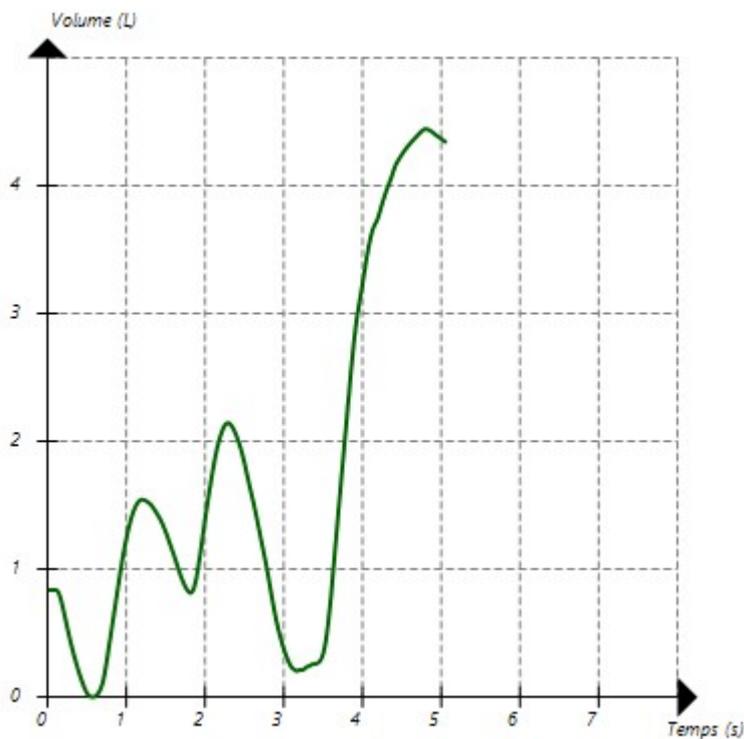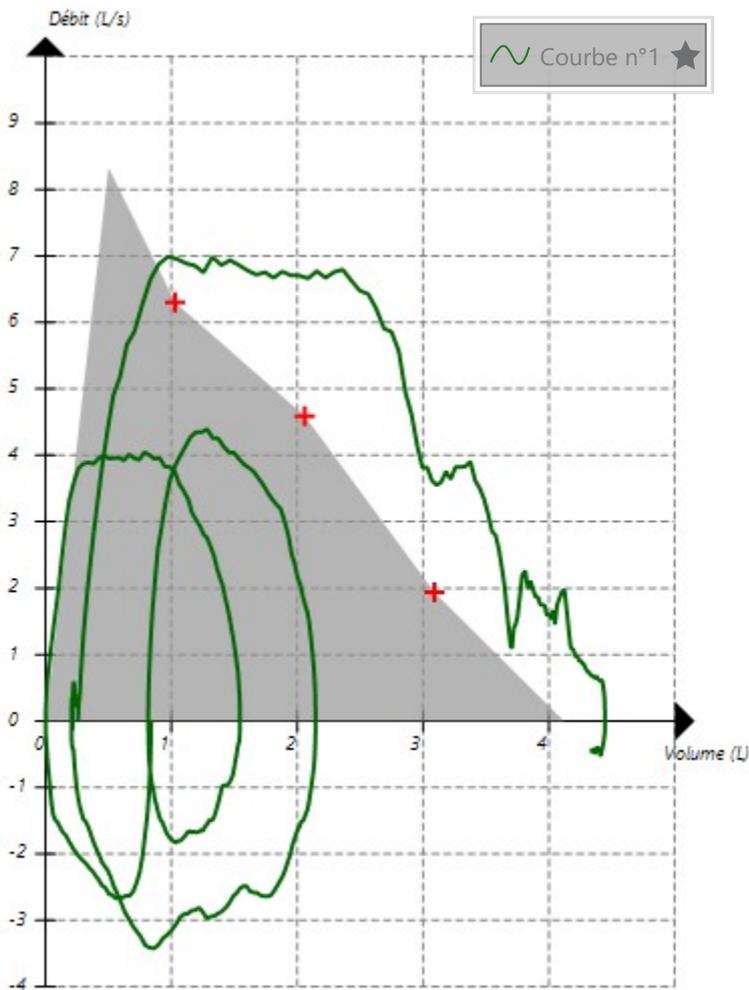

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,23 L	4,12 L	102,67 %
VEMS	4,05 L	3,50 L	115,71 %
DEP	7,07 L/s	8,33 L/s	84,87 %
VEMS/ CVF	95,74 %	83,97 %	114,02 %
Durée d'expiration	1,56 s	-	
DEMM	5,71 L/s	3,92 L/s	145,66 %
DEMM/ CVF	1,35 s-1	0,95 s-1	142,11 %
DE75	6,81 L/s	6,30 L/s	108,10 %
DE50	6,75 L/s	4,59 L/s	147,06 %
DE25	3,76 L/s	1,94 L/s	193,81 %