

<b>Nom</b> SAMAKE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 12/03/1996	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> ELECTRICIEN
<b>ID</b> 777	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,1 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 56 %

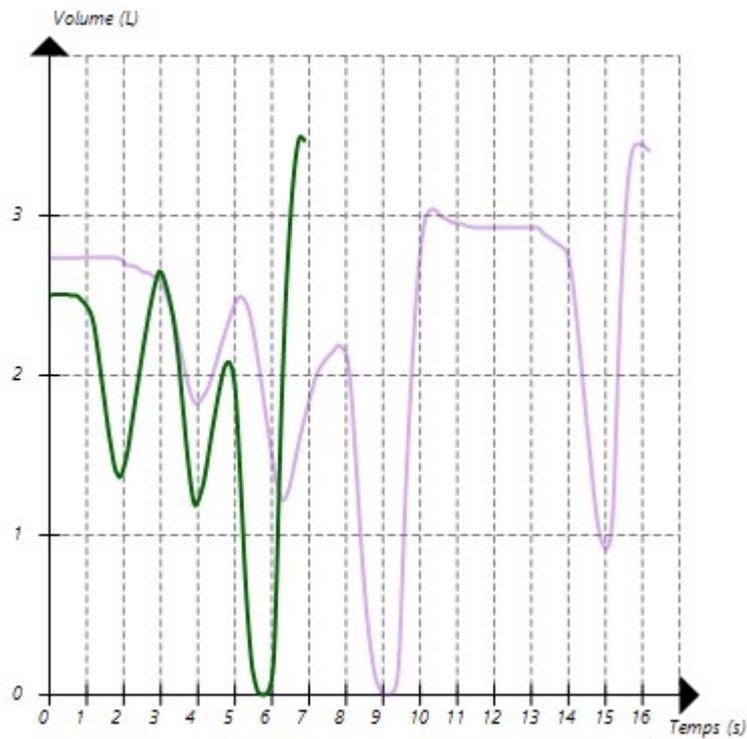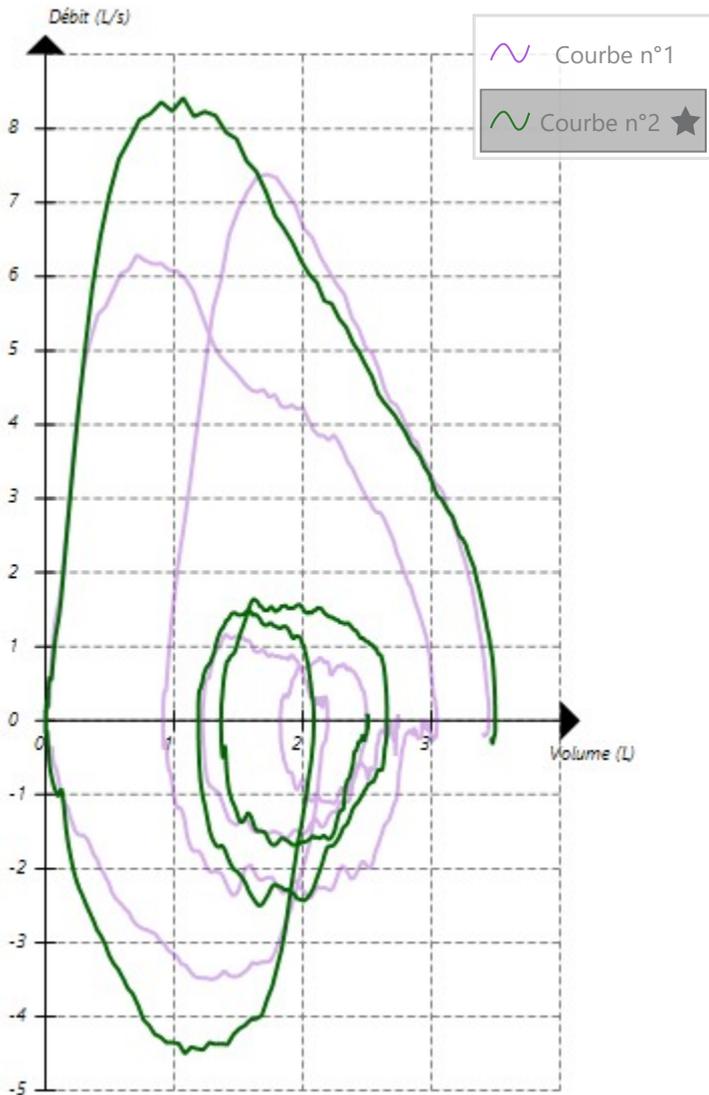

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,53 L	3,49 L	4,26 L	81,92 %
VEMS	2,53 L	3,49 L	3,60 L	96,94 %
DEP	7,54 L/s	8,49 L/s	9,17 L/s	92,58 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	84,12 %	118,88 %
Durée d'expiration	0,81 s	0,98 s	-	
DEMM	5,92 L/s	6,69 L/s	4,06 L/s	164,78 %
DEMM/ CVF	2,34 s-1	1,92 s-1	0,95 s-1	202,11 %
DE75	7,18 L/s	8,35 L/s	-	
DE50	6,11 L/s	6,96 L/s	-	
DE25	3,92 L/s	4,31 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: