

**Nom** TRAORE  
**Prénom** MOUSSA  
**Né le** 01/01/1985  
**Age** 39 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 589  
**Taille** 171 cm  
**Poids** 116 kg  
**Valeurs prédites** Eccs/Zapletal  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** CHAUFFEUR  
**Entreprise** BCEIP  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 25,9 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Humidité : 57 %

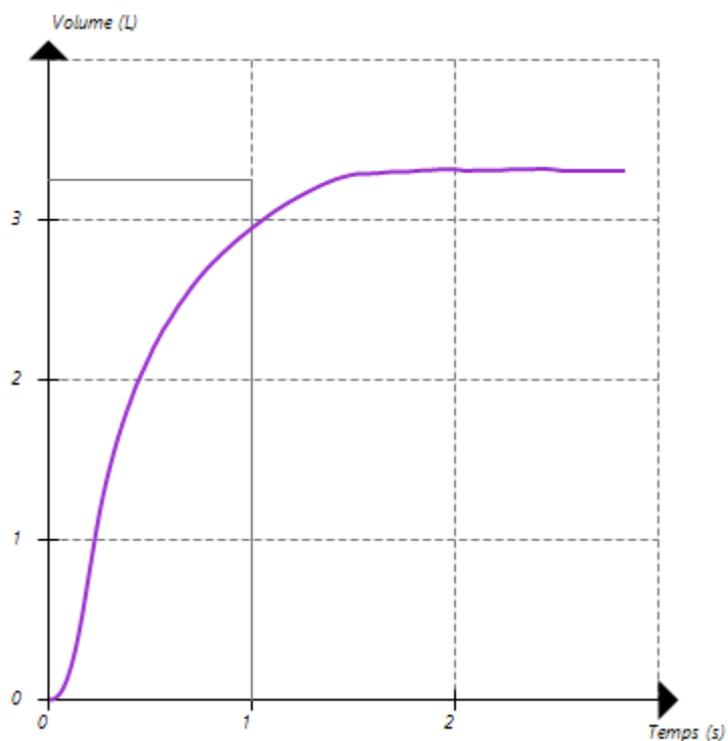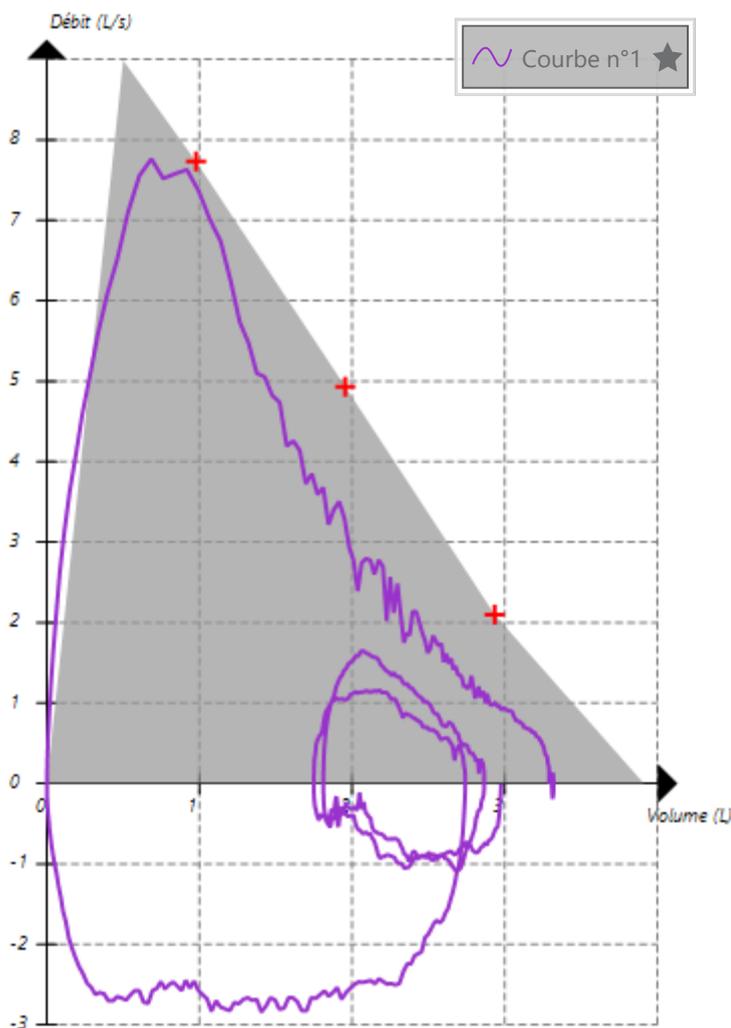

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,32 L	3,91 L	84,91 %
VEMS	3,04 L	3,25 L	93,54 %
DÉP	7,88 L/s	8,99 L/s	87,65 %
VEMS/CVF	91,57 %	80,23 %	114,13 %
Durée d'expiration	2,40 s	-	
DEMM	3,70 L/s	4,35 L/s	85,06 %
DEMM/CVF	1,11 s <sup>-1</sup>	0,97 s <sup>-1</sup>	114,43 %
DE75	7,59 L/s	7,73 L/s	98,19 %
DE50	4,32 L/s	4,93 L/s	87,63 %
DE25	1,66 L/s	2,10 L/s	79,05 %