



<b>Nom</b> MAOMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LABILE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1996	<b>Profession</b> AIDE FOREUR
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> HDS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 36	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,1 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 65 %

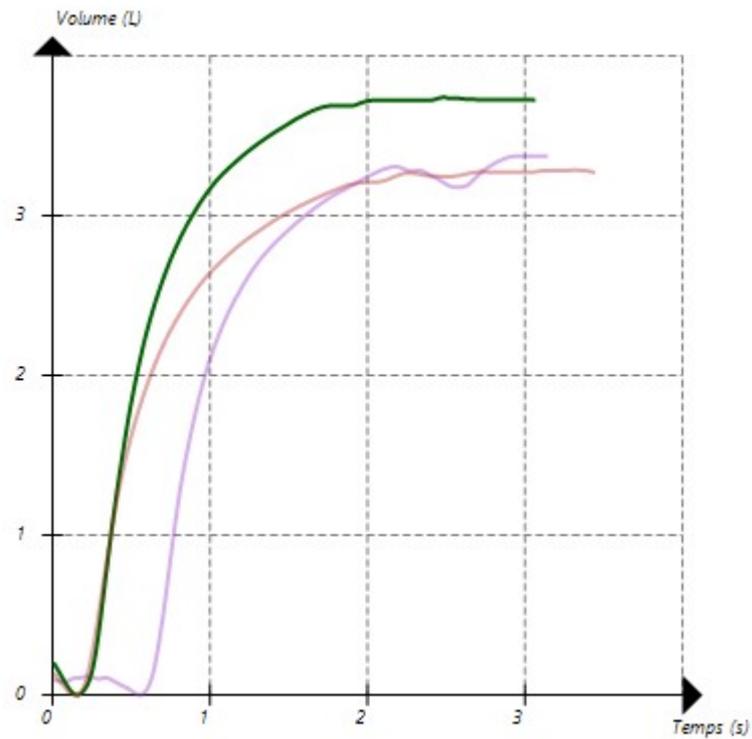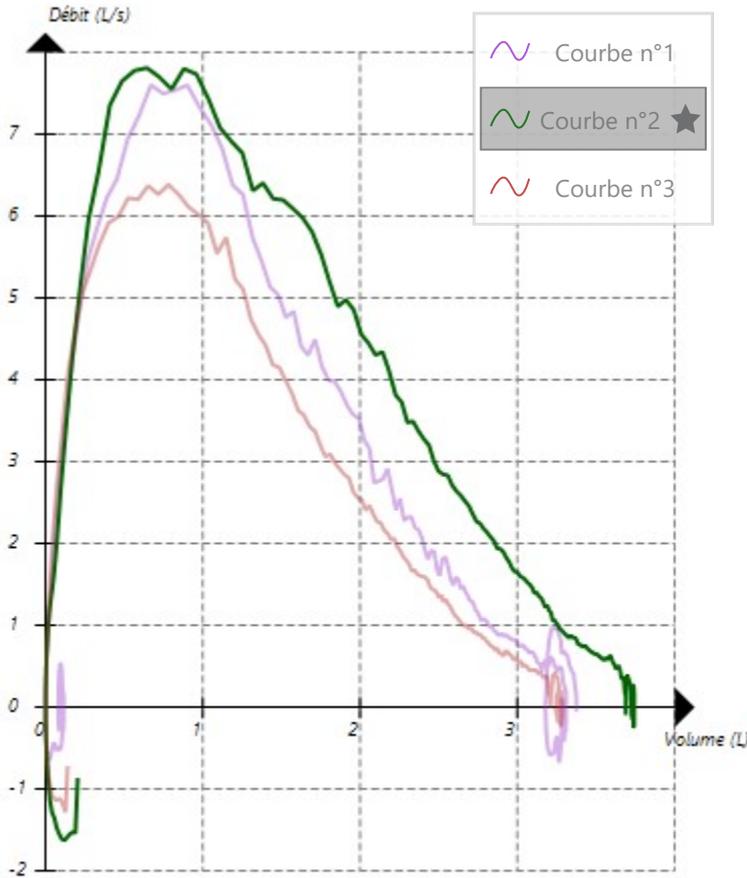

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,31 L	3,74 L	3,27 L	4,36 L	85,78 %
VEMS	3,03 L	3,40 L	2,84 L	3,67 L	92,64 %
DEP	7,80 L/s	7,90 L/s	6,58 L/s	9,32 L/s	84,76 %
VEMS/CVF	91,54 %	90,91 %	86,85 %	83,94 %	108,30 %
Durée d'expiration	1,62 s	2,33 s	2,11 s	-	
DEMM	3,98 L/s	4,42 L/s	3,21 L/s	4,09 L/s	108,07 %
DEMM/CVF	1,20 s-1	1,18 s-1	0,98 s-1	0,94 s-1	125,53 %
DE75	7,54 L/s	7,77 L/s	6,30 L/s	-	
DE50	4,26 L/s	4,89 L/s	3,66 L/s	-	
DE25	1,72 L/s	2,13 L/s	1,43 L/s	-	