

Nom DIABY	Adresse
Prénom MOUSSA	Exposition
Né le 01/01/1998	Profession OPERATEUR GRADER
Age 26 Ans	Entreprise GPC
Genre Féminin	Service
ID 92	Fumeur Non fumeur
Taille 170 cm	Prescripteur:
Poids 68 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	
Opérateur admin admin	




MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
Numéro de série : 232803
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 28,1 °C
Pression atmosphérique : 93,5 kPa
Humidité : 44 %

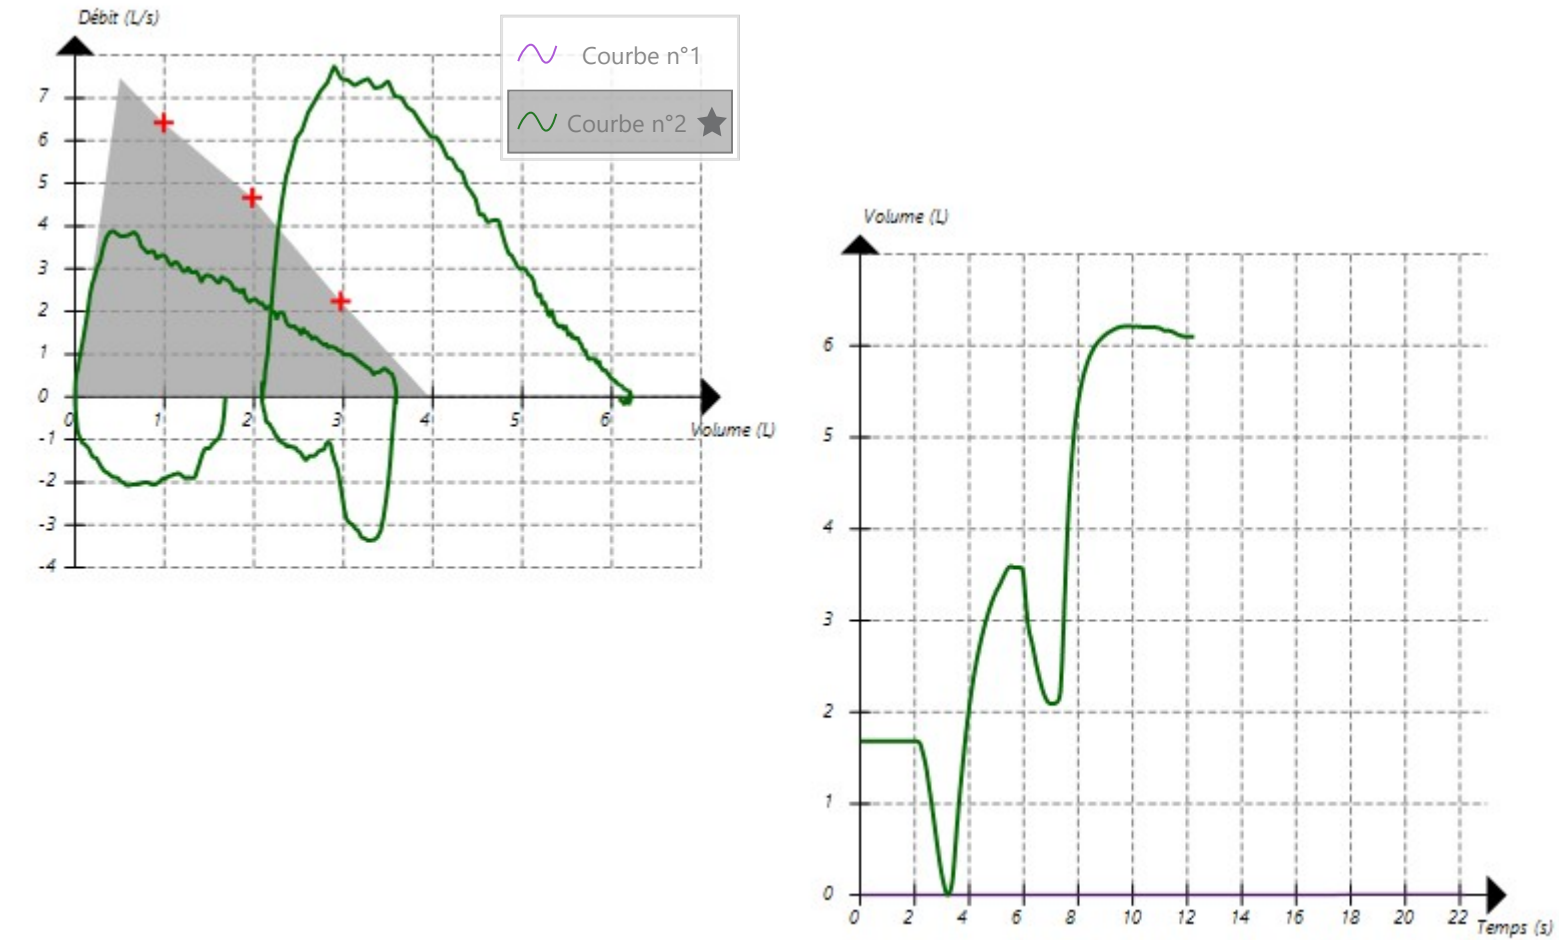

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	0,01 L	4,11 L	3,96 L	103,79 %
VEMS	0,01 L	3,73 L	3,47 L	107,49 %
DEP	0,20 L/s	7,85 L/s	7,47 L/s	105,09 %
VEMS/CVF	100,00 %	90,75 %	84,11 %	107,89 %
Durée d'expiration	14,58 s	2,50 s	-	
DEMM	0,15 L/s	4,98 L/s	4,17 L/s	119,42 %
DEMM/CVF	15,00 s-1	1,21 s-1	1,05 s-1	115,24 %
DE75	0,07 L/s	7,35 L/s	6,42 L/s	114,49 %
DE50	0,20 L/s	5,62 L/s	4,67 L/s	120,34 %
DE25	0,15 L/s	2,47 L/s	2,24 L/s	110,27 %