

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SOULEYMANE II	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 19/09/1985	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> MV GPC 76	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 84 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,9 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 99,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 53 %

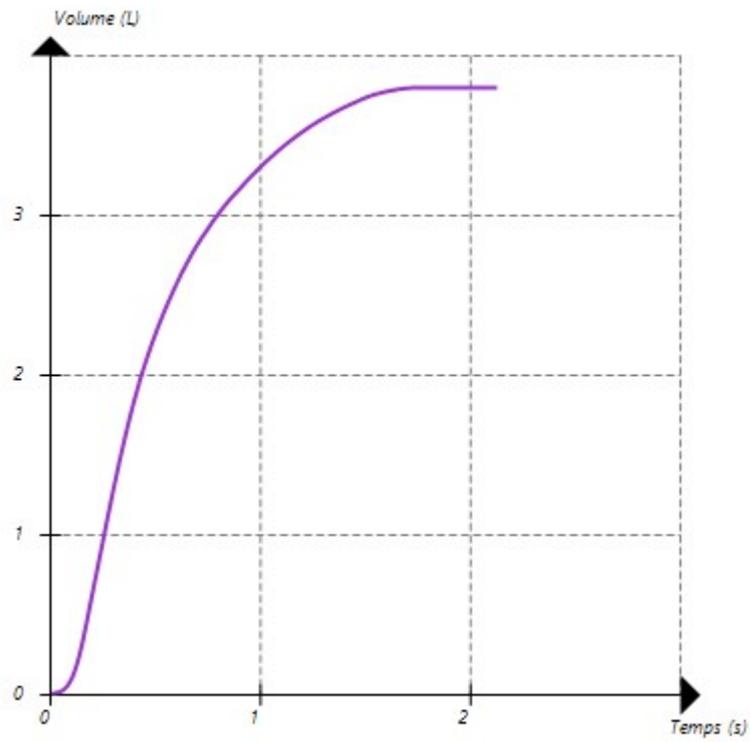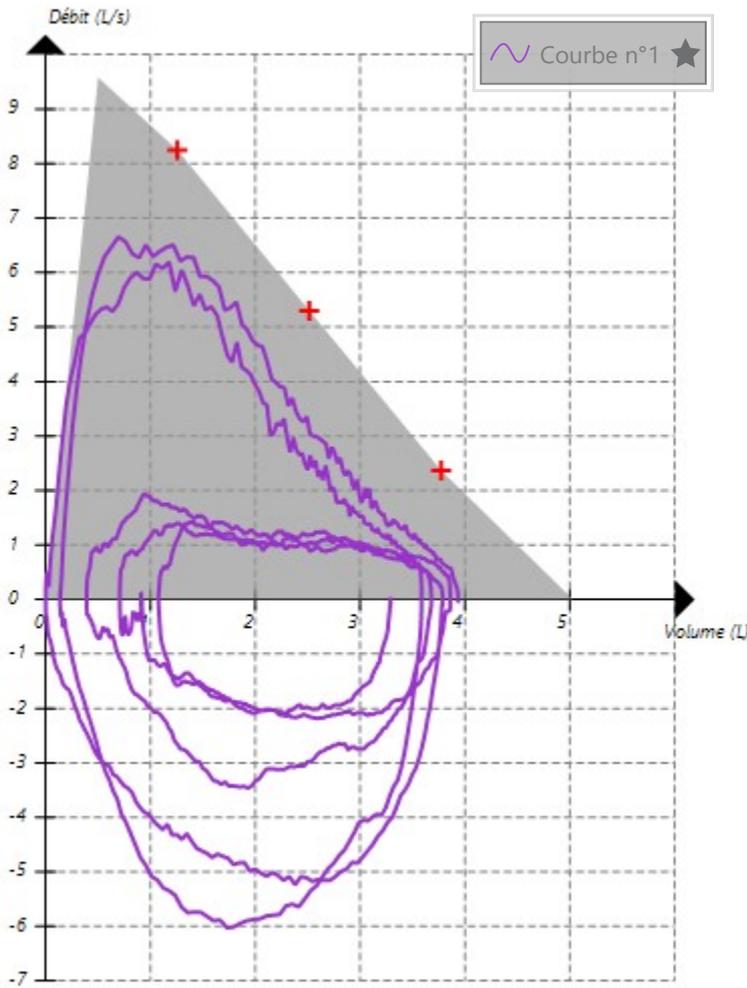

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,80 L	5,03 L	75,55 %
VEMS	3,42 L	4,15 L	82,41 %
DEP	6,83 L/s	9,58 L/s	71,29 %
VEMS/ CVF	90,00 %	80,41 %	111,93 %
Durée d'expiration	1,82 s	-	
DEMM	4,07 L/s	4,56 L/s	89,25 %
DEMM/ CVF	1,07 s-1	0,91 s-1	117,58 %
DE75	6,44 L/s	8,25 L/s	78,06 %
DE50	4,58 L/s	5,30 L/s	86,42 %
DE25	2,12 L/s	2,37 L/s	89,45 %