

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FRANCIS OSMAN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 24/04/1970	<b>Profession</b> PNEUMATICIEN
<b>Age</b> 54 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 706	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 89 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 25,9 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 100,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 54 %

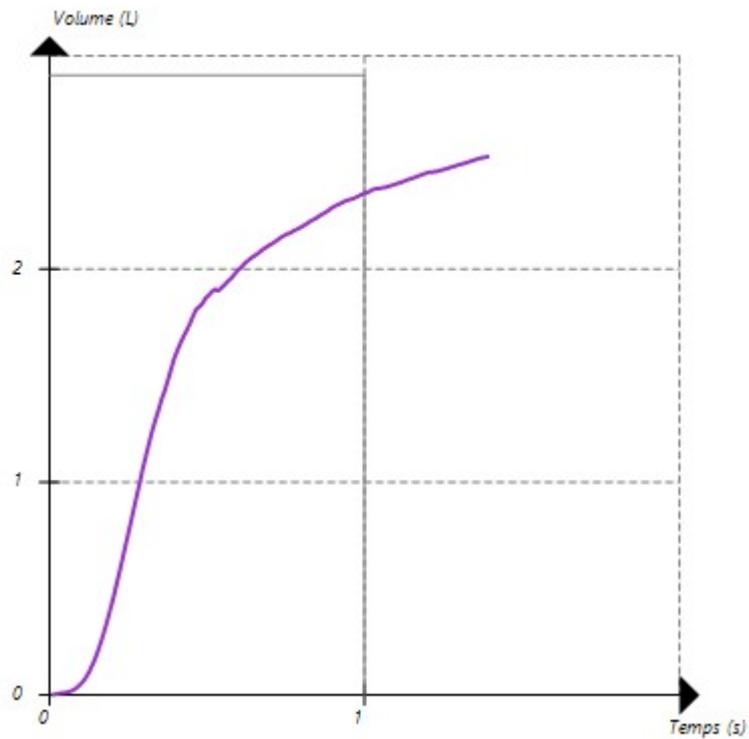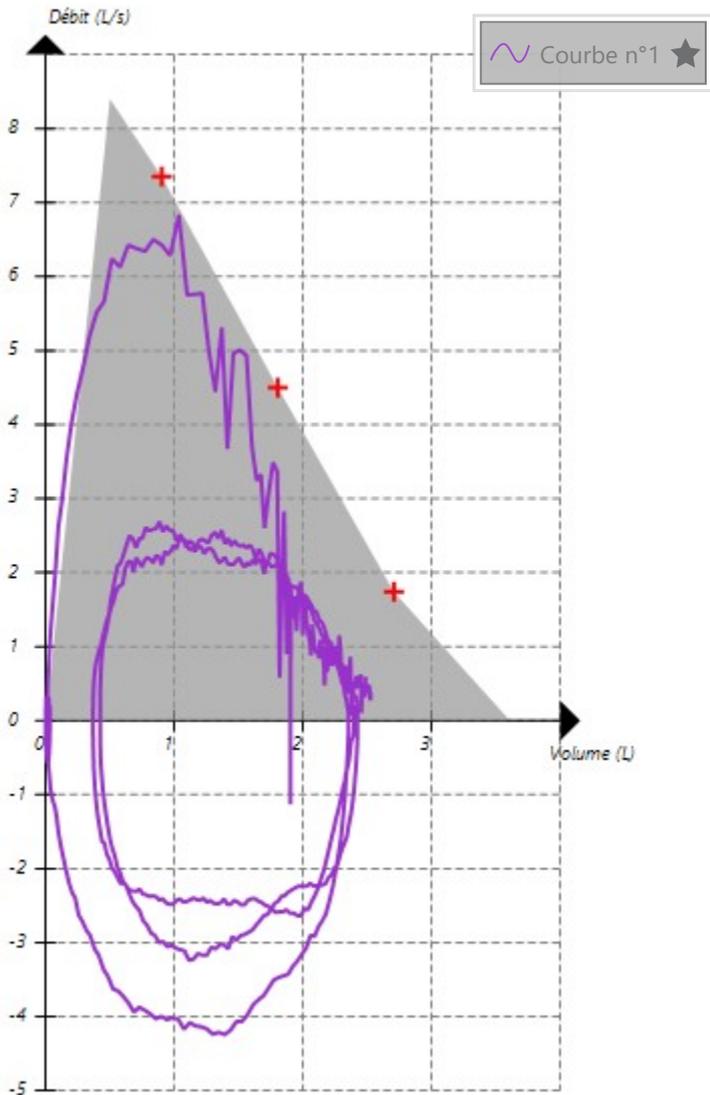

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,53 L	3,61 L	70,08 %
VEMS	2,42 L	2,91 L	83,16 %
DEP	6,97 L/s	8,40 L/s	82,98 %
VEMS/CVF	95,65 %	77,54 %	123,36 %
Durée d'expiration	1,40 s	-	
DEMM	4,10 L/s	3,72 L/s	110,22 %
DEMM/CVF	1,62 s-1	0,90 s-1	180,00 %
DE75	6,45 L/s	7,35 L/s	87,76 %
DE50	4,78 L/s	4,50 L/s	106,22 %
DE25	3,42 L/s	1,74 L/s	196,55 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: