

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 07/07/1996	<b>Profession</b> ELECTRICIEN
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 00200	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 182 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 26,6 °C  
 Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Humidité : 55 %

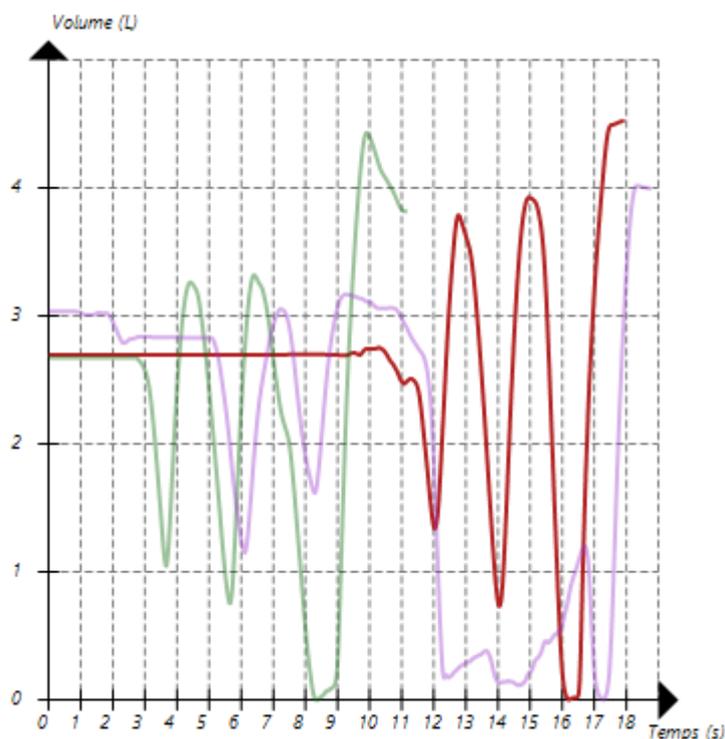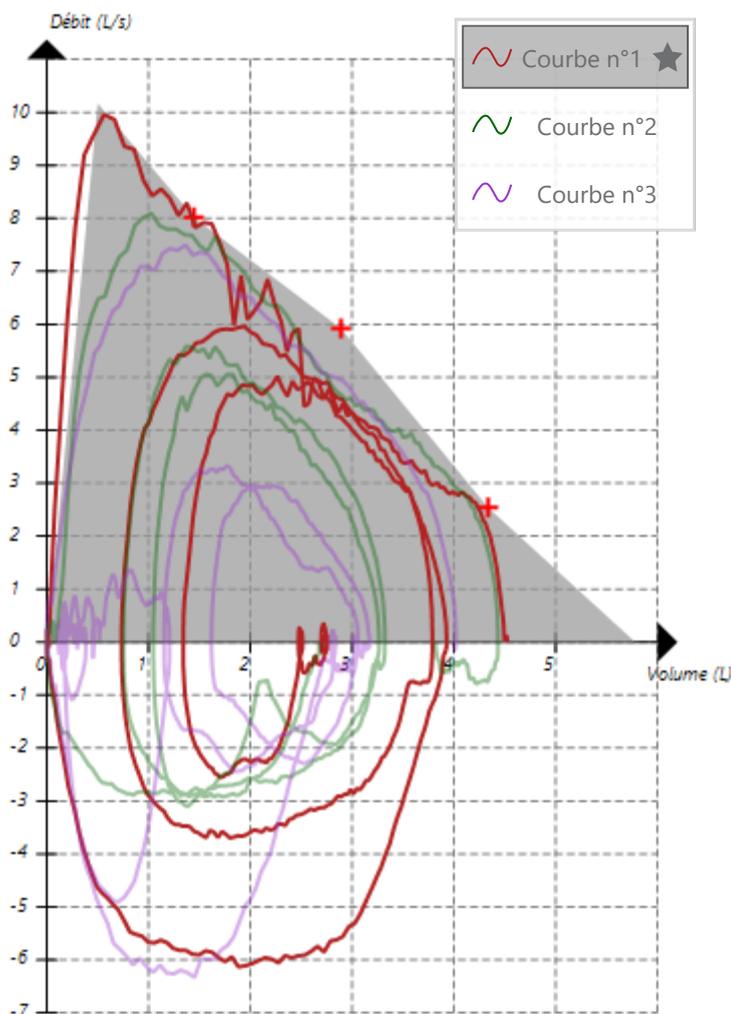

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	4,51 L	4,36 L	4,02 L	5,78 L	78,03 %
VEMS	4,48 L	4,36 L	4,02 L	4,80 L	93,33 %
DÉP	10,11 L/s	8,18 L/s	7,60 L/s	10,17 L/s	99,41 %
VEMS/ CVF	99,33 %	100,00 %	100,00 %	83,86 %	118,45 %
Durée d'expiration	1,47 s	1,17 s	1,02 s	-	
DEMM	5,69 L/s	5,98 L/s	6,30 L/s	5,04 L/s	112,90 %
DEMM/ CVF	1,26 s-1	1,37 s-1	1,57 s-1	0,87 s-1	144,83 %
DE75	8,61 L/s	7,73 L/s	7,05 L/s	8,02 L/s	107,36 %
DE50	6,58 L/s	6,41 L/s	6,49 L/s	5,92 L/s	111,15 %
DE25	3,61 L/s	4,07 L/s	4,77 L/s	2,54 L/s	142,13 %