



<b>Nom</b> SAGNO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1970	<b>Profession</b> CHAUFFEUR CAMION CITERNE
<b>Age</b> 54 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 94	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 83 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,7 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 45 %

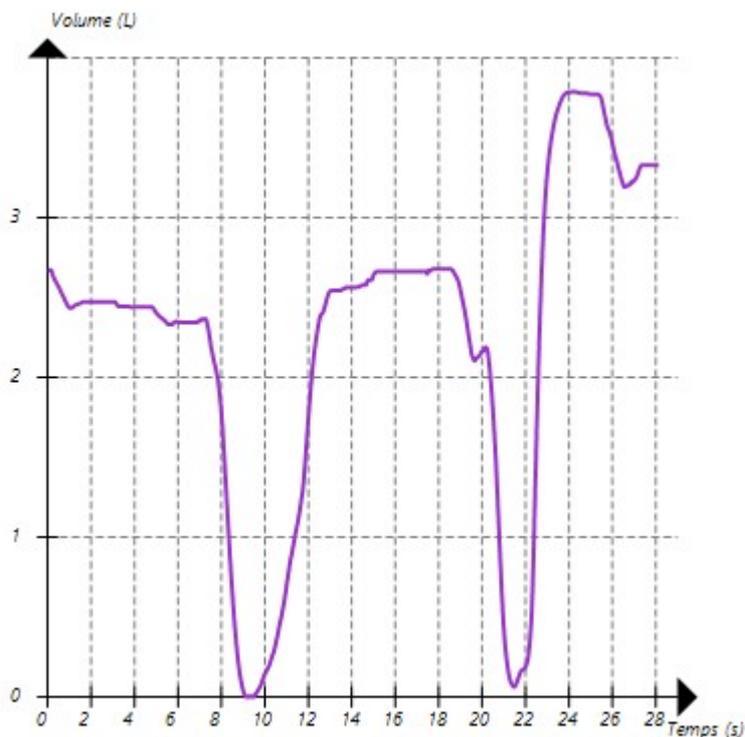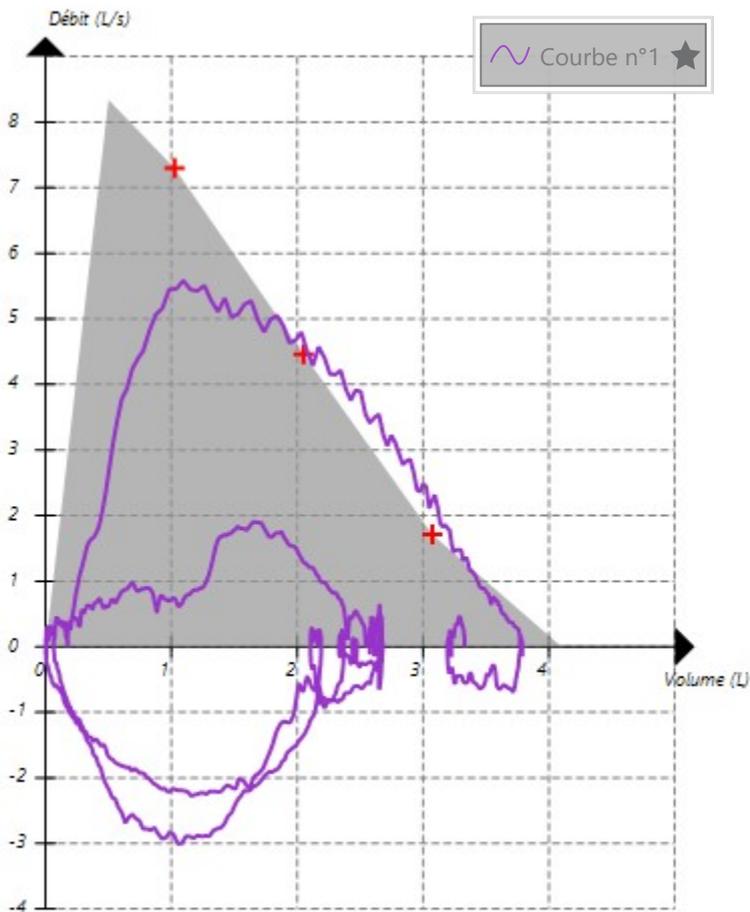

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,72 L	4,10 L	90,73 %
VEMS	3,45 L	3,30 L	104,55 %
DEP	5,61 L/s	8,34 L/s	67,27 %
VEMS/ CVF	92,74 %	77,54 %	119,60 %
Durée d'expiration	2,69 s	-	
DEMM	4,50 L/s	3,70 L/s	121,62 %
DEMM/ CVF	1,21 s-1	0,90 s-1	134,44 %
DE75	5,49 L/s	7,30 L/s	75,21 %
DE50	4,63 L/s	4,46 L/s	103,81 %
DE25	2,75 L/s	1,71 L/s	160,82 %