

<b>Nom</b> BANGOURA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1984	<b>Profession</b> MENUISIER
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 259	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,6 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 63 %

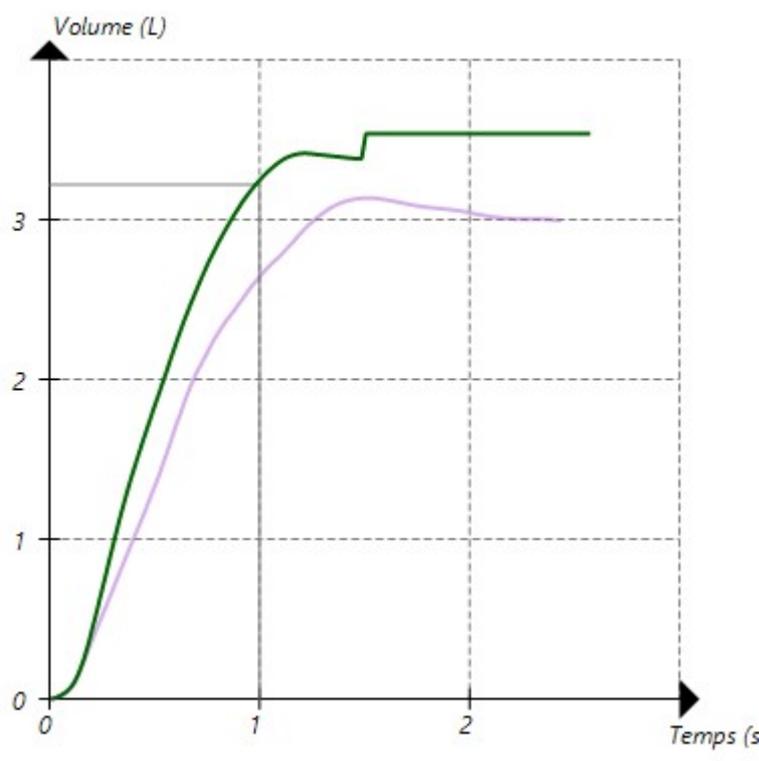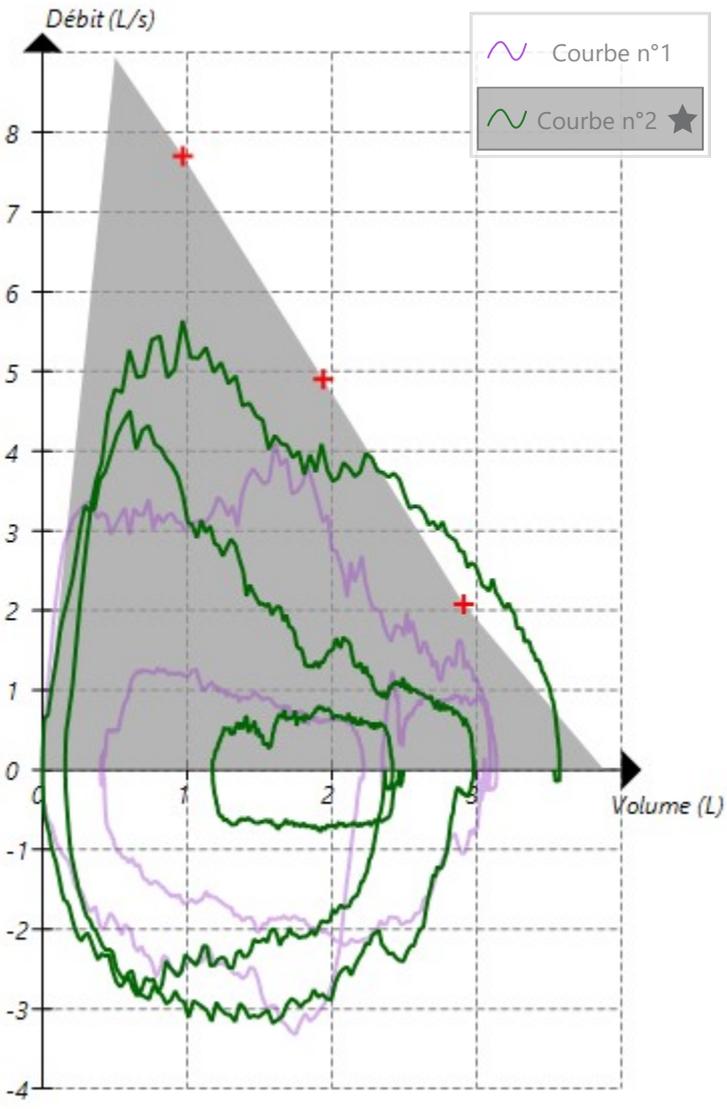

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,14 L	3,42 L	3,88 L	88,14 %
VEMS	2,85 L	3,38 L	3,22 L	104,97 %
DEP	4,41 L/s	5,91 L/s	8,94 L/s	66,11 %
VEMS/ CVF	90,76 %	98,83 %	80,05 %	123,46 %
Durée d'expiration	1,51 s	1,21 s	-	
DEMM	3,12 L/s	4,08 L/s	4,30 L/s	94,88 %
DEMM/ CVF	0,99 s-1	1,19 s-1	0,96 s-1	123,96 %
DE75	3,33 L/s	5,37 L/s	7,70 L/s	69,74 %
DE50	3,89 L/s	3,68 L/s	4,90 L/s	75,10 %
DE25	1,95 L/s	3,02 L/s	2,08 L/s	145,19 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: