

<b>Nom</b> SANGARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> YAYA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1978	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 46 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 306	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 2
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,6 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 56 %

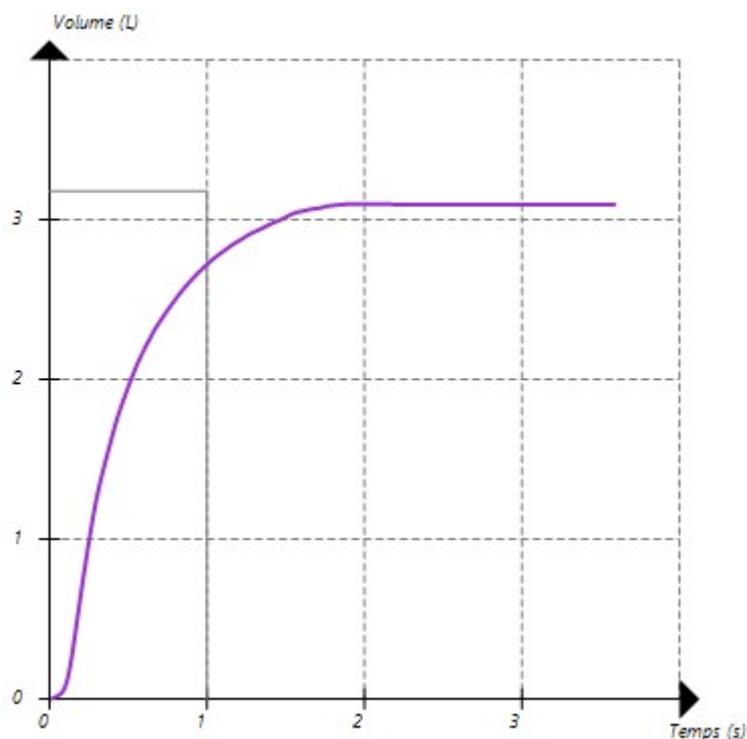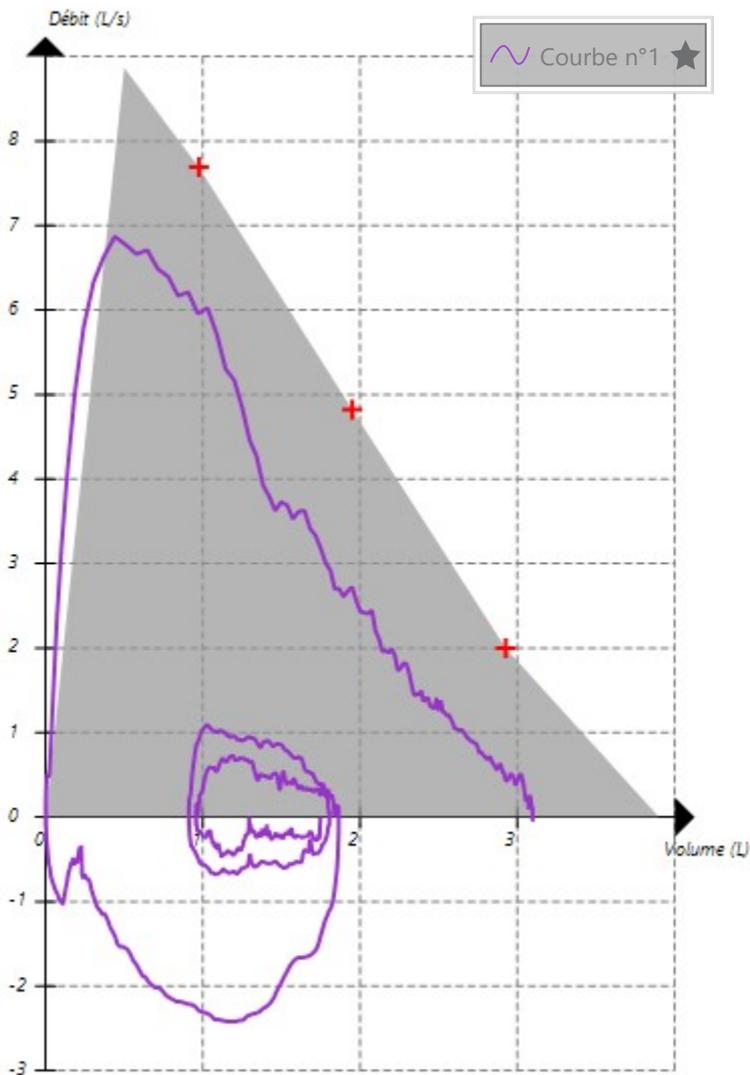

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,10 L	3,90 L	79,49 %
VEMS	2,80 L	3,18 L	88,05 %
DEP	7,04 L/s	8,87 L/s	79,37 %
VEMS/CVF	90,32 %	78,98 %	114,36 %
Durée d'expiration	1,99 s	-	
DEMM	3,39 L/s	4,10 L/s	82,68 %
DEMM/CVF	1,09 s-1	0,92 s-1	118,48 %
DE75	6,53 L/s	7,69 L/s	84,92 %
DE50	3,69 L/s	4,82 L/s	76,56 %
DE25	1,62 L/s	2,00 L/s	81,00 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: