

Nom KOUROUMA**Prénom** KEMO**Né le** 11/09/1994**Age** 30 Ans**Genre** Masculin**ID** 944**Taille** 71 cm**Poids** 67 kg**Valeurs prédites** Eccs/Zapletal**Opérateur** admin admin**Adresse** 610333574**Exposition****Profession** ASSISTANT CONCASSEUR**Entreprise** GPC**Service****Fumeur** Non fumeur**Groupe ethnique** Caucasien**Prescripteur:****Smoking Pack Years** : 0**Fim medical**

51 rue Primat

+33 (0)4 72 34 89 89

+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,1 °C

Pression atmosphérique : 100,5 kPa

Humidité : 49 %

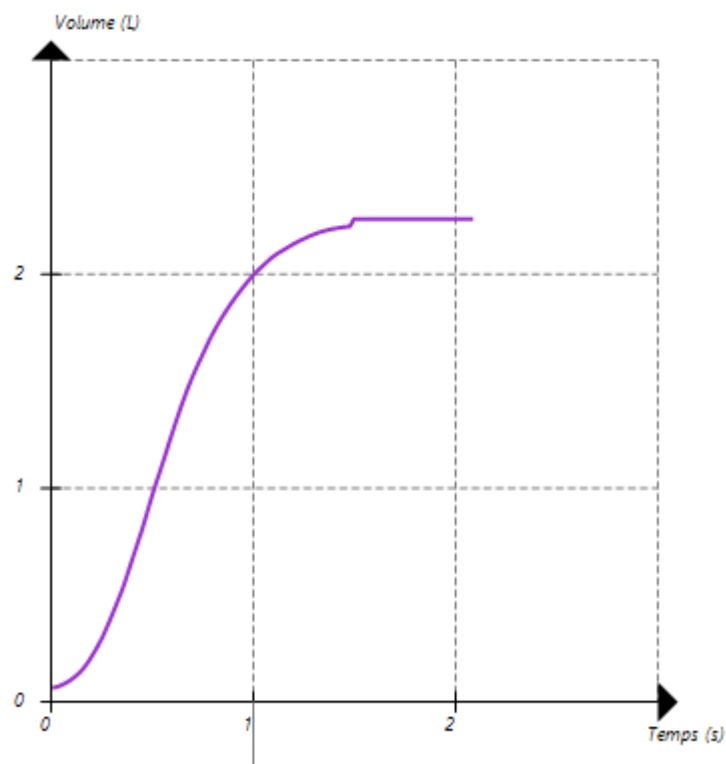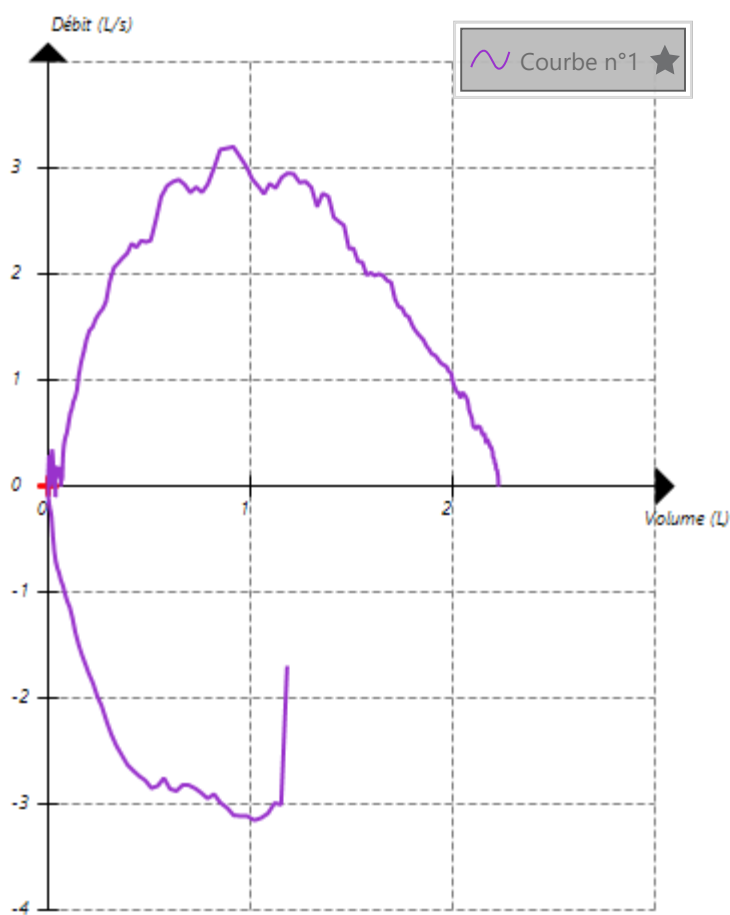

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,19 L	-1,04 L	-210,58 %
VEMS	2,11 L	-0,31 L	-680,65 %
DÉP	3,28 L/s	3,23 L/s	101,55 %
VEMS/CVF	96,35 %	81,84 %	117,73 %
Durée d'expiration	2,14 s	-	
DEMM	2,72 L/s	2,79 L/s	97,49 %
DEMM/CVF	1,24 s-1	-2,68 s-1	-46,27 %
DE75	2,82 L/s	2,54 L/s	111,02 %
DE50	2,82 L/s	1,41 L/s	200,00 %
DE25	1,97 L/s	-0,27 L/s	-729,63 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: