

<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORLAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 30/01/1983	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 41 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> MVGPC1	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 186 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 92 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 28 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Humidité : 38 %

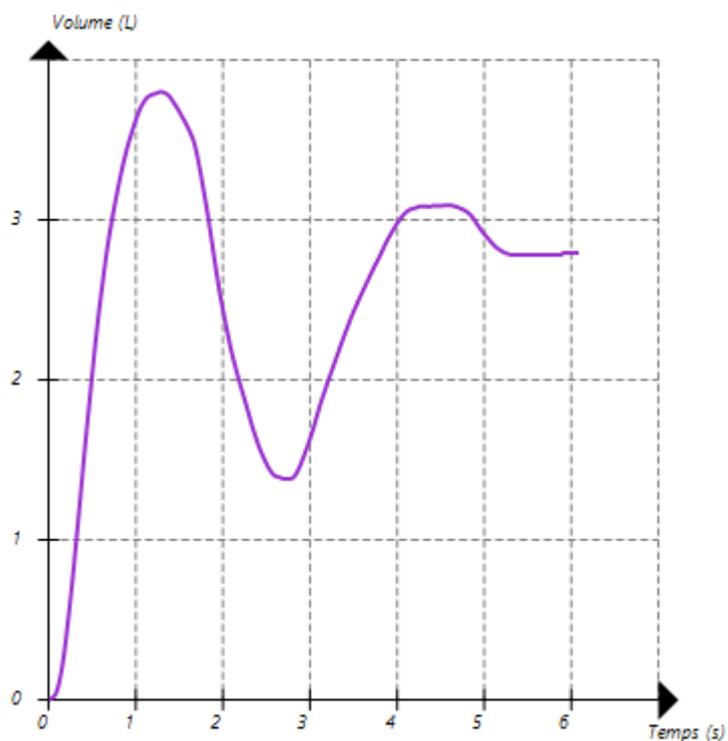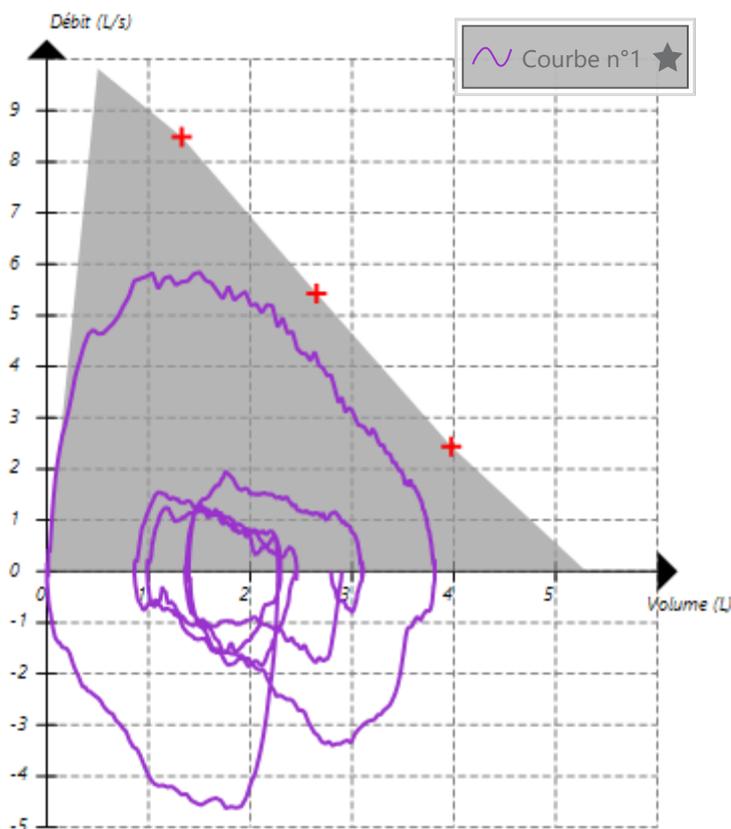

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,80 L	5,30 L	71,70 %
VEMS	3,77 L	4,32 L	87,27 %
DÉP	6,00 L/s	9,82 L/s	61,10 %
VEMS/CVF	99,21 %	79,87 %	124,21 %
Durée d'expiration	1,28 s	-	
DEMM	5,11 L/s	4,55 L/s	112,31 %
DEMM/CVF	1,34 s <sup>-1</sup>	0,86 s <sup>-1</sup>	155,81 %
DE75	5,72 L/s	8,49 L/s	67,37 %
DE50	5,59 L/s	5,43 L/s	102,95 %
DE25	3,37 L/s	2,44 L/s	138,11 %