

<b>Nom</b> SACKO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FASSOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1985	<b>Profession</b> PNEUMATIQUE
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 02	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 156 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 55 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:** NORMAL



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 38 %

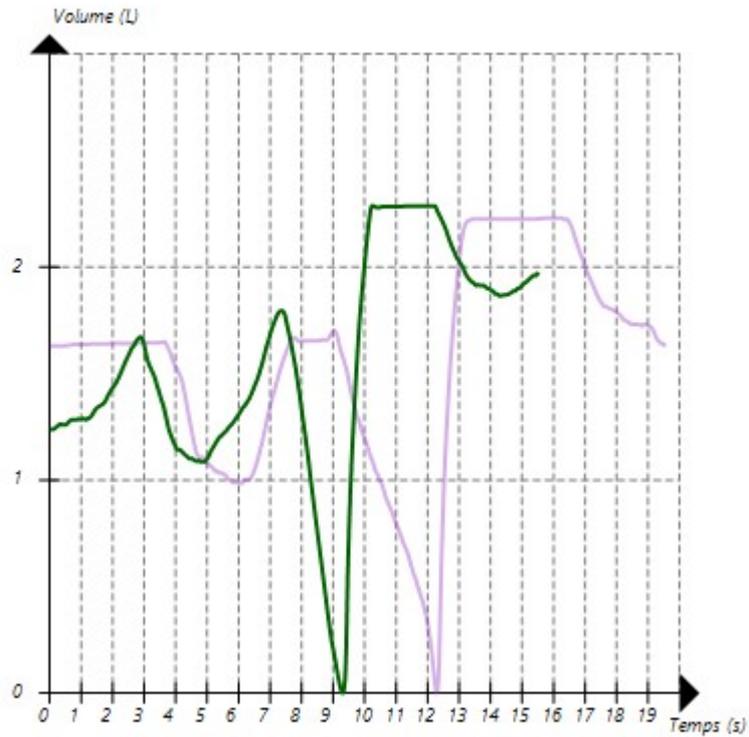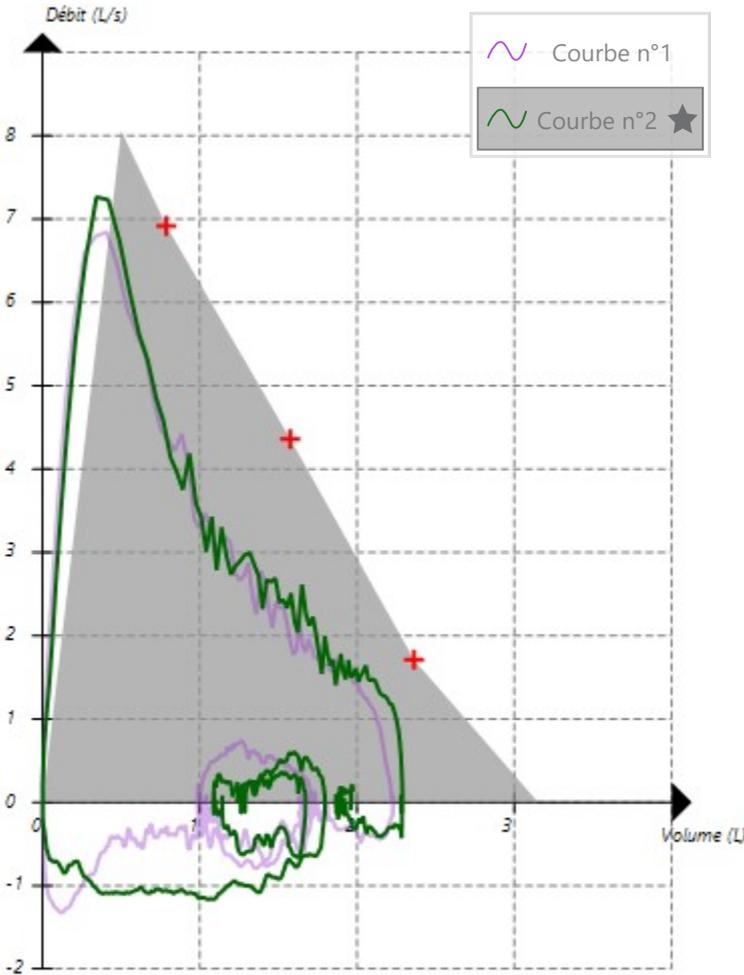

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,23 L	2,29 L	3,15 L	72,70 %
VEMS	2,22 L	2,29 L	2,69 L	85,13 %
DEP	7,05 L/s	7,37 L/s	8,06 L/s	91,44 %
VEMS/CVF	99,55 %	100,00 %	80,23 %	124,64 %
Durée d'expiration	3,40 s	0,94 s	-	
DEMM	3,12 L/s	3,21 L/s	4,05 L/s	79,26 %
DEMM/CVF	1,40 s-1	1,40 s-1	1,12 s-1	125,00 %
DE75	5,68 L/s	5,93 L/s	6,92 L/s	85,69 %
DE50	3,06 L/s	3,32 L/s	4,36 L/s	76,15 %
DE25	1,77 L/s	2,40 L/s	1,71 L/s	140,35 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: