



<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FREBORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/04/1984	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 172	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 699,1 mmHg  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 46 %

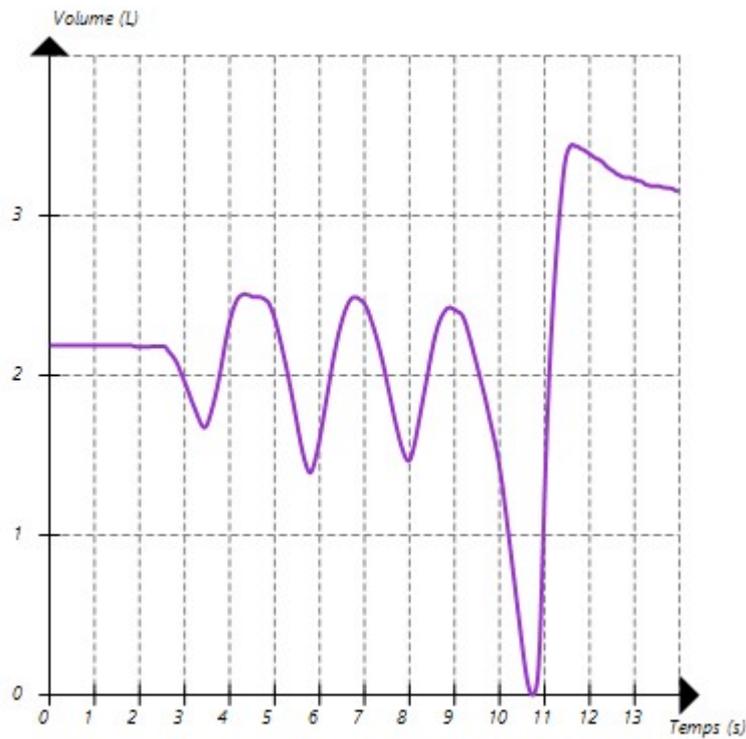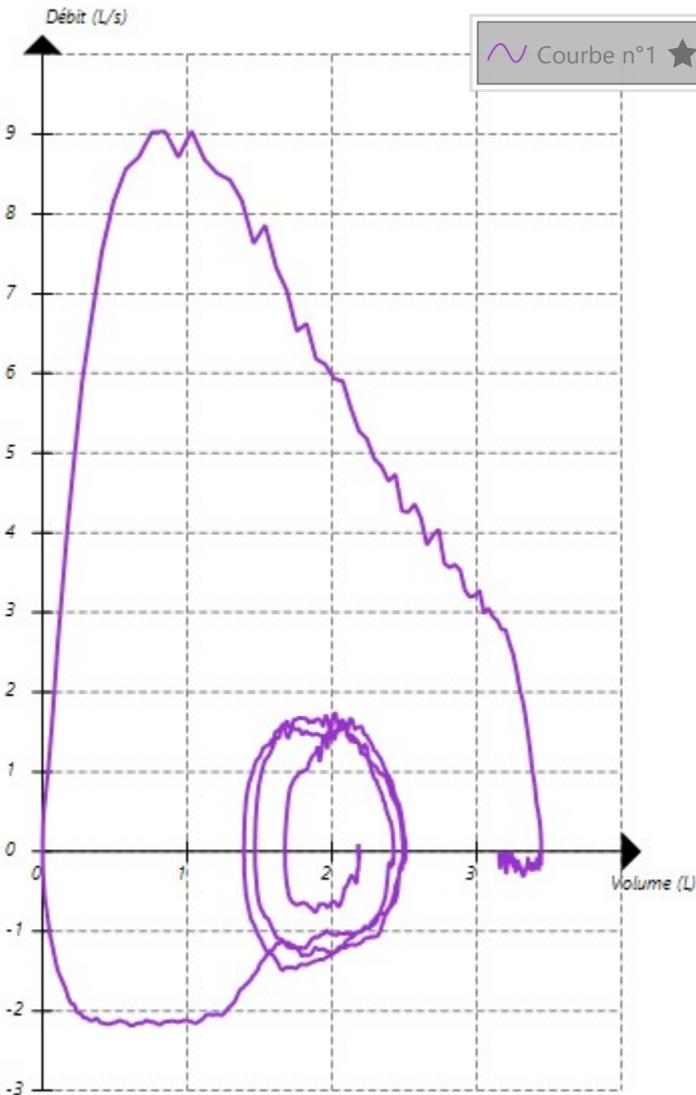

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,45 L	4,22 L	81,75 %
VEMS	3,45 L	3,46 L	99,71 %
DEP	9,21 L/s	8,96 L/s	102,79 %
VEMS/ CVF	100,00 %	81,93 %	122,06 %
Durée d'expiration	0,88 s	-	
DEMM	6,58 L/s	3,66 L/s	179,78 %
DEMM/ CVF	1,91 s-1	0,87 s-1	219,54 %
DE75	8,95 L/s	-	
DE50	6,68 L/s	-	
DE25	4,47 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: