



| | |
|---------------------------------------|--|
| Nom CARLOS | Adresse |
| Prénom ALEXENDRE | Exposition |
| Né le 25/09/1975 | Profession DIRECTEUR |
| Age 48 Ans | Entreprise GPC |
| Genre Masculin | Service |
| ID 217 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 182 cm | Groupe ethnique Américain d'origine japonaise |
| Poids 84 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites Ecgs/Zapletal | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur admin admin | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 26,9 °C
 Numéro de série : 232707 Pression atmosphérique : 100,9 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 58 %

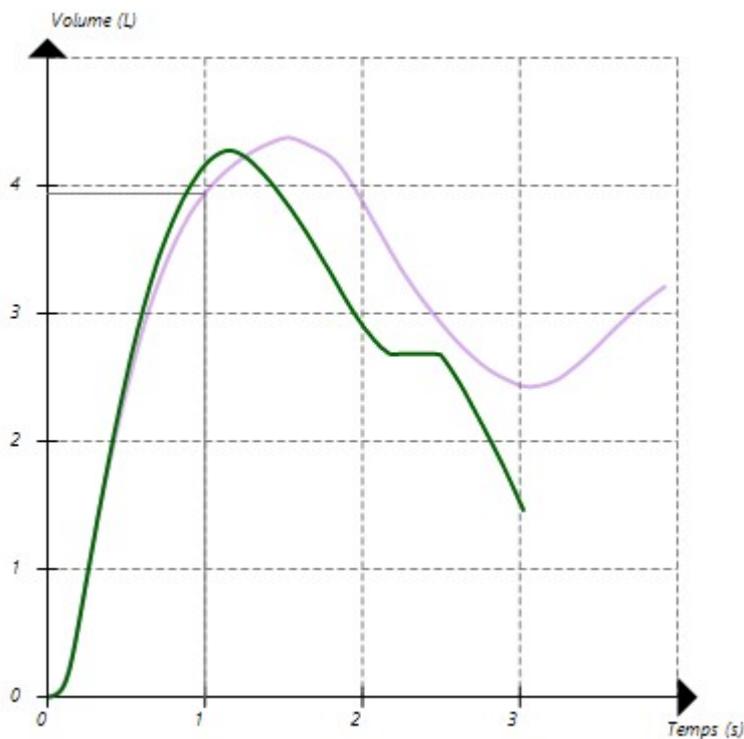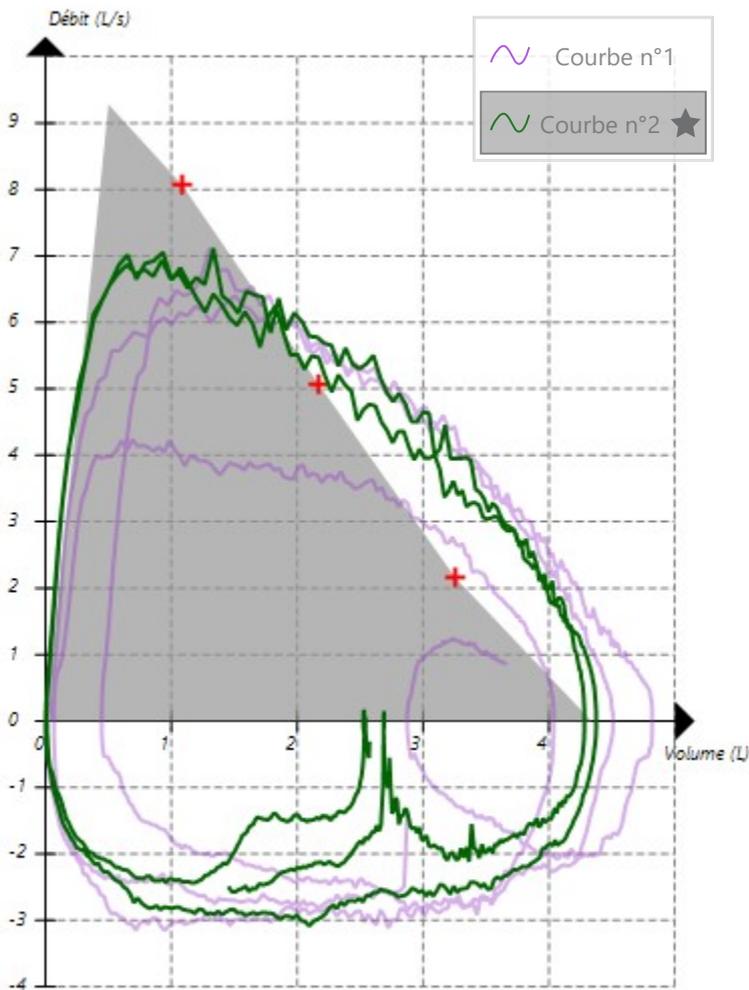

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 4,38 L | 4,28 L | 4,34 L | 98,62 % |
| VEMS | 4,09 L | 4,27 L | 3,94 L | 108,38 % |
| DEP | 7,30 L/s | 7,38 L/s | 9,28 L/s | 79,53 % |
| VEMS/CVF | 93,38 % | 99,77 % | 78,62 % | 126,90 % |
| Durée d'expiration | 1,53 s | 1,17 s | - | |
| DEMM | 4,93 L/s | 5,67 L/s | 4,17 L/s | 135,97 % |
| DEMM/CVF | 1,13 s-1 | 1,32 s-1 | 0,85 s-1 | 155,29 % |
| DE75 | 6,70 L/s | 7,20 L/s | 8,07 L/s | 89,22 % |
| DE50 | 5,17 L/s | 5,79 L/s | 5,07 L/s | 114,20 % |
| DE25 | 3,14 L/s | 3,74 L/s | 2,16 L/s | 173,15 % |