

<b>Nom</b> HABA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MENIBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1989	<b>Profession</b> OPERATEUR CONCASSEUR
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 997	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 26 °C  
 Pression atmosphérique : 100,8 kPa  
 Humidité : 54 %

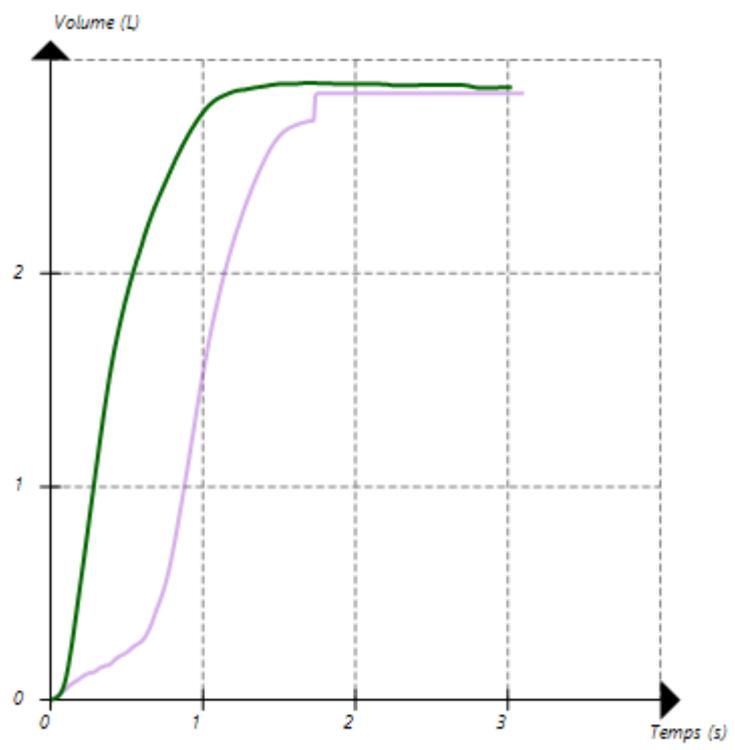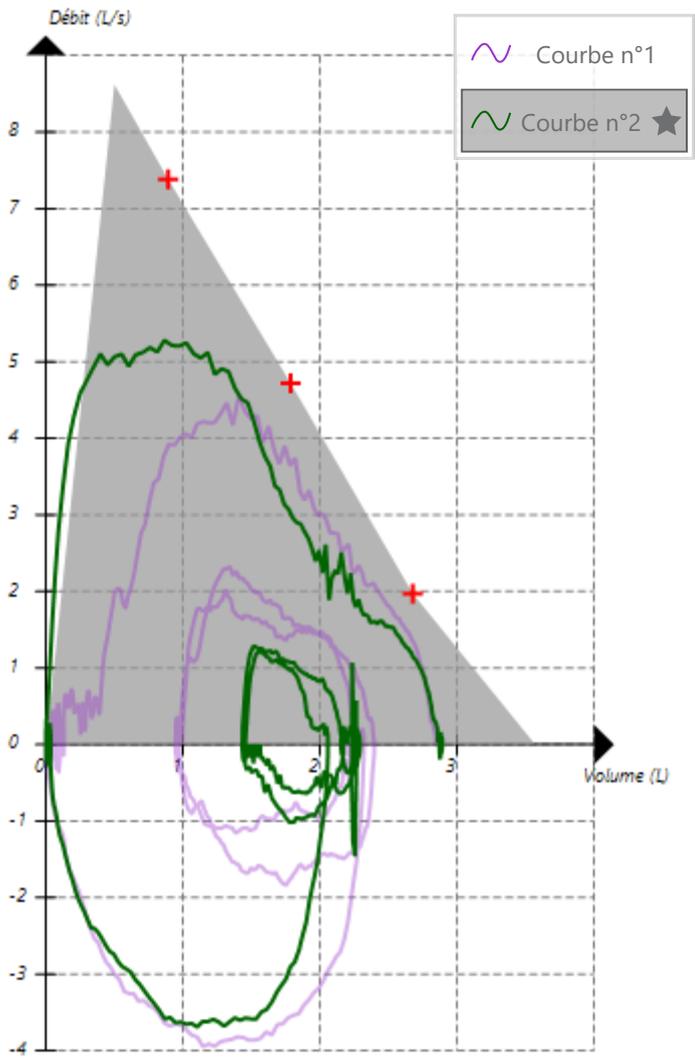

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,72 L	2,89 L	3,57 L	80,95 %
VEMS	2,71 L	2,82 L	3,02 L	93,38 %
DÉP	4,67 L/s	5,39 L/s	8,62 L/s	62,53 %
VEMS/ CVF	99,63 %	97,58 %	80,77 %	120,81 %
Durée d'expiration	1,73 s	1,67 s	-	
DEMM	3,81 L/s	3,79 L/s	4,32 L/s	87,73 %
DEMM/ CVF	1,40 s <sup>-1</sup>	1,31 s <sup>-1</sup>	1,05 s <sup>-1</sup>	124,76 %
DE75	3,39 L/s	5,02 L/s	7,38 L/s	68,02 %
DE50	4,24 L/s	4,58 L/s	4,72 L/s	97,03 %
DE25	2,46 L/s	2,59 L/s	1,97 L/s	131,47 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: