

<b>Nom</b> DOUALAMOU	<b>Adresse</b> 624741246
<b>Prénom</b> EMMAUEL	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 04/11/1968	<b>Profession</b> ELECTRICIEN
<b>Age</b> 56 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 946	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 83 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 28,5 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 100,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Humidité : 45 %

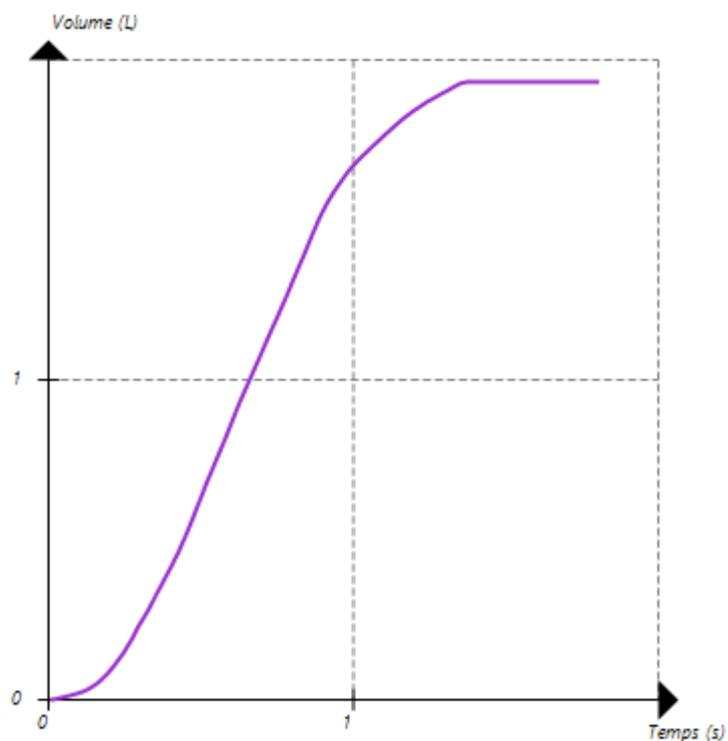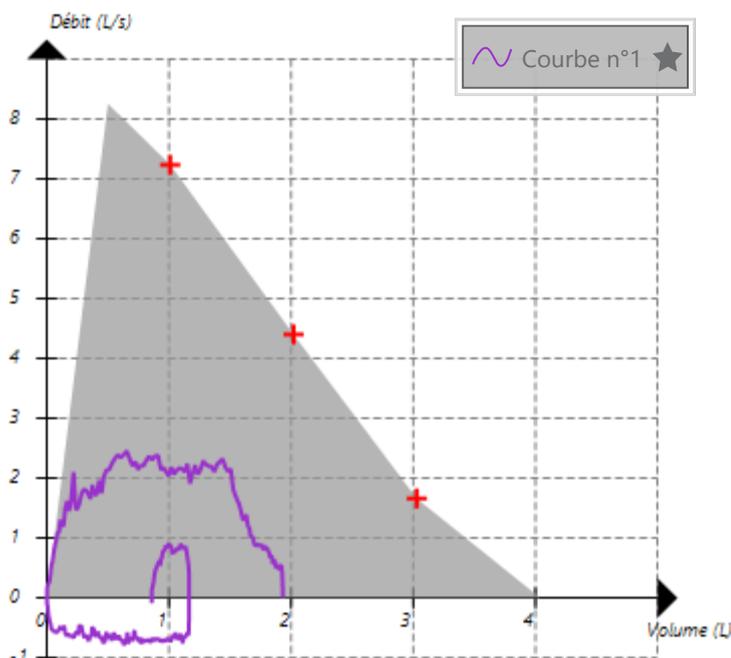

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,93 L	4,04 L	47,77 %
VEMS	1,86 L	3,24 L	57,41 %
DÉP	2,59 L/s	8,26 L/s	31,36 %
VEMS/CVF	96,37 %	77,19 %	124,85 %
Durée d'expiration	1,39 s	-	
DEMM	2,26 L/s	3,62 L/s	62,43 %
DEMM/CVF	1,17 s <sup>-1</sup>	0,90 s <sup>-1</sup>	130,00 %
DE75	2,26 L/s	7,24 L/s	31,22 %
DE50	2,03 L/s	4,40 L/s	46,14 %
DE25	2,25 L/s	1,66 L/s	135,54 %