



Nom CAMARA	Adresse
Prénom SEKOU	Exposition
Né le 01/01/1990	Profession OPERATEUR EXACATEUR
Age 34 Ans	Entreprise GPC
Genre Masculin	Service
ID 93	Fumeur Non fumeur
Taille 179 cm	Prescripteur:
Poids 105 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Eccts/Zapletal	
Opérateur admin admin	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 26,1 °C
 Numéro de série : 232803 Pression atmosphérique : 93,6 kPa
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 41 %

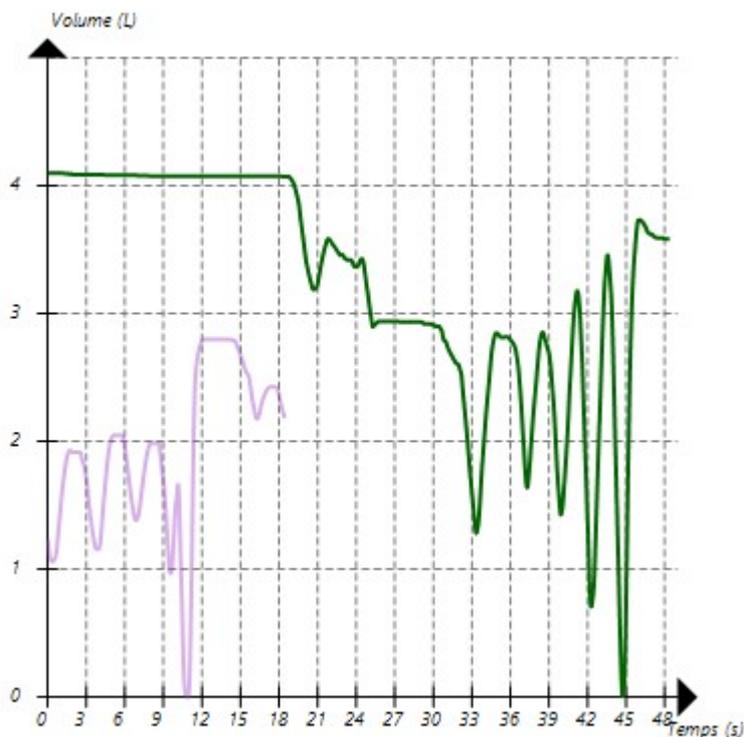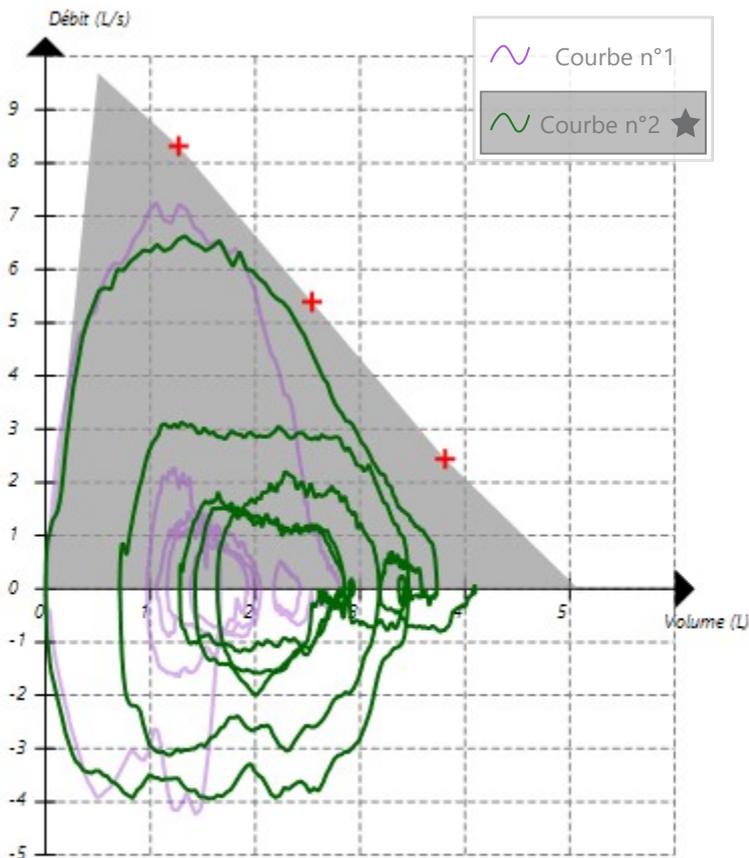

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,80 L	3,73 L	5,08 L	73,43 %
VEMS	2,79 L	3,71 L	4,22 L	87,91 %
DEP	7,39 L/s	6,78 L/s	9,69 L/s	69,97 %
VEMS/ CVF	99,64 %	99,46 %	81,12 %	122,61 %
Durée d'expiration	1,30 s	1,32 s	-	
DEMM	6,63 L/s	5,64 L/s	4,72 L/s	119,49 %
DEMM/ CVF	2,37 s-1	1,51 s-1	0,93 s-1	162,37 %
DE75	6,07 L/s	6,36 L/s	8,32 L/s	76,44 %
DE50	6,84 L/s	6,28 L/s	5,39 L/s	116,51 %
DE25	4,76 L/s	3,35 L/s	2,44 L/s	137,30 %