

<b>Nom</b> TINGUIANO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> TAMBASELLE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 08/10/1987	<b>Profession</b> CALIGRAPHE
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 273	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 273 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 100,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 58 %

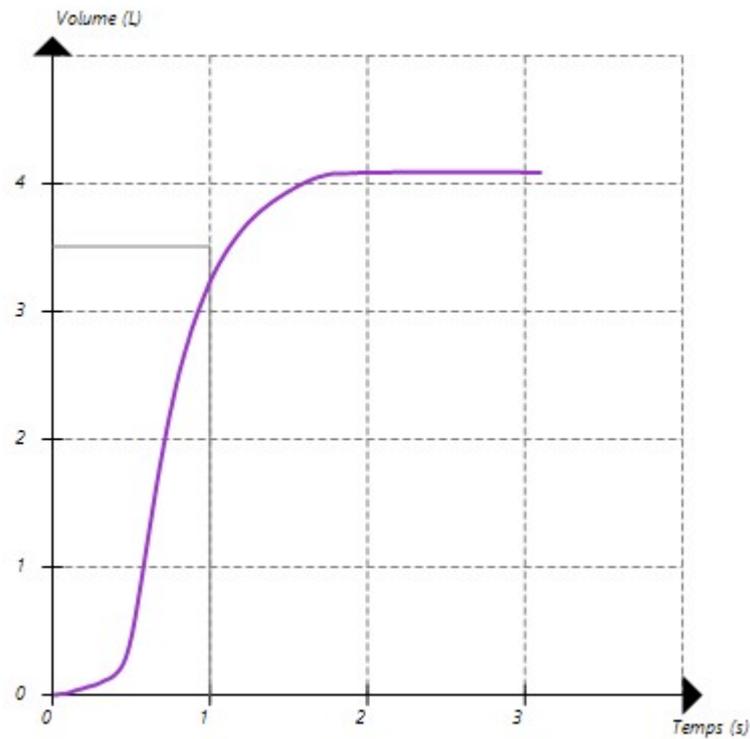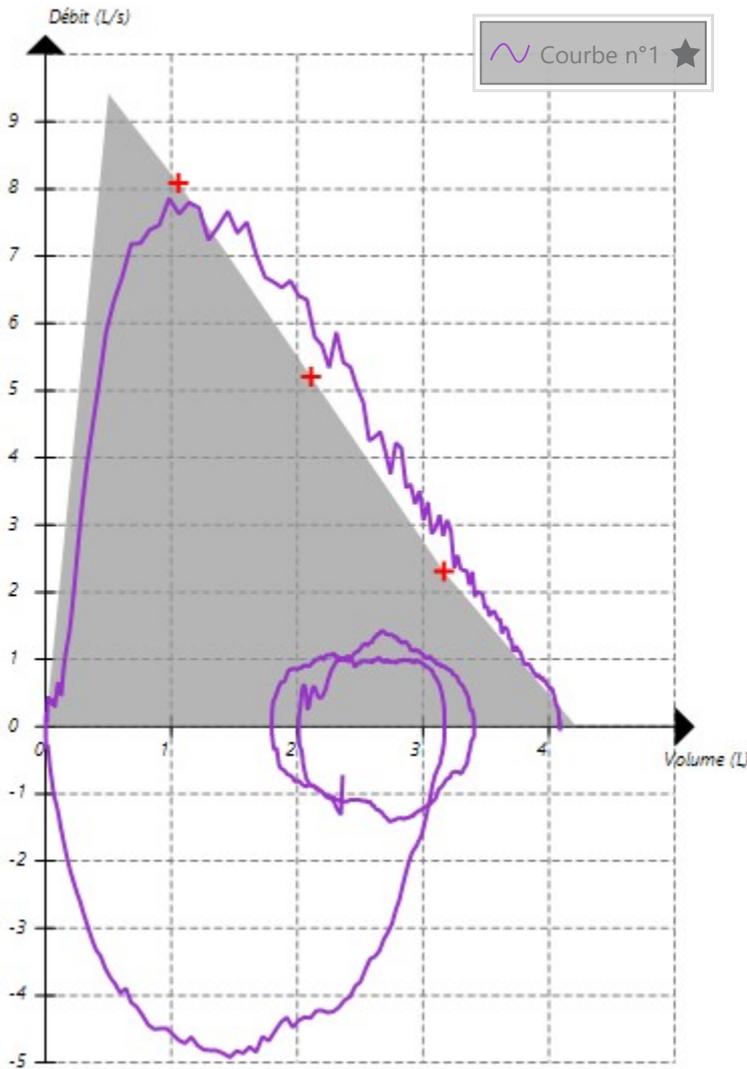

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,09 L	4,22 L	96,92 %
VEMS	3,90 L	3,51 L	111,11 %
DEP	7,93 L/s	9,42 L/s	84,18 %
VEMS/ CVF	95,35 %	80,77 %	118,05 %
Durée d'expiration	2,74 s	-	
DEMM	5,60 L/s	4,57 L/s	122,54 %
DEMM/ CVF	1,37 s-1	0,94 s-1	145,74 %
DE75	7,83 L/s	8,09 L/s	96,79 %
DE50	6,32 L/s	5,21 L/s	121,31 %
DE25	2,78 L/s	2,31 L/s	120,35 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: