

<b>Nom</b> CHERIF	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LONSENY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 13/12/1988	<b>Profession</b> OPERATEUR GRADEUR
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 36	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 152 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 50 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:** NORMAL



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,6 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 92,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 48 %

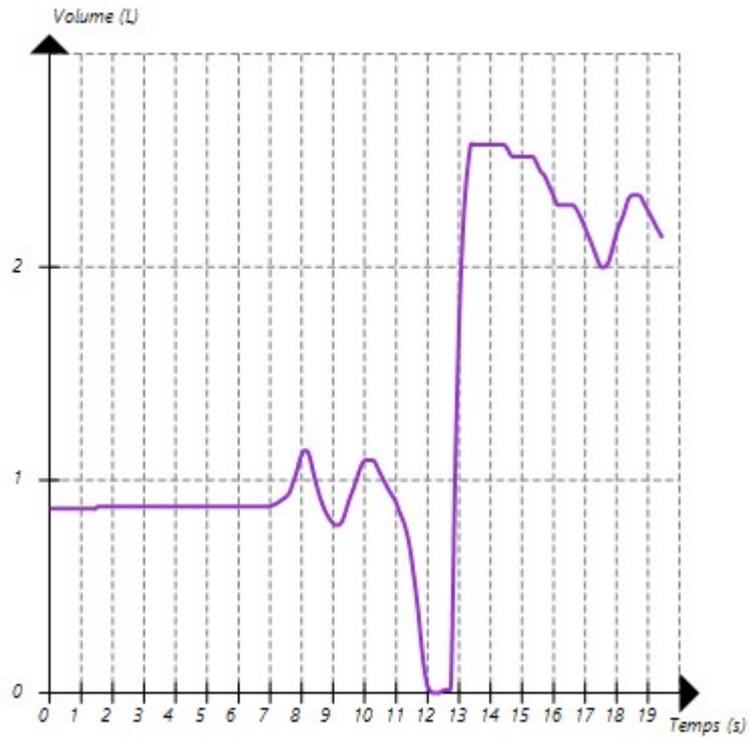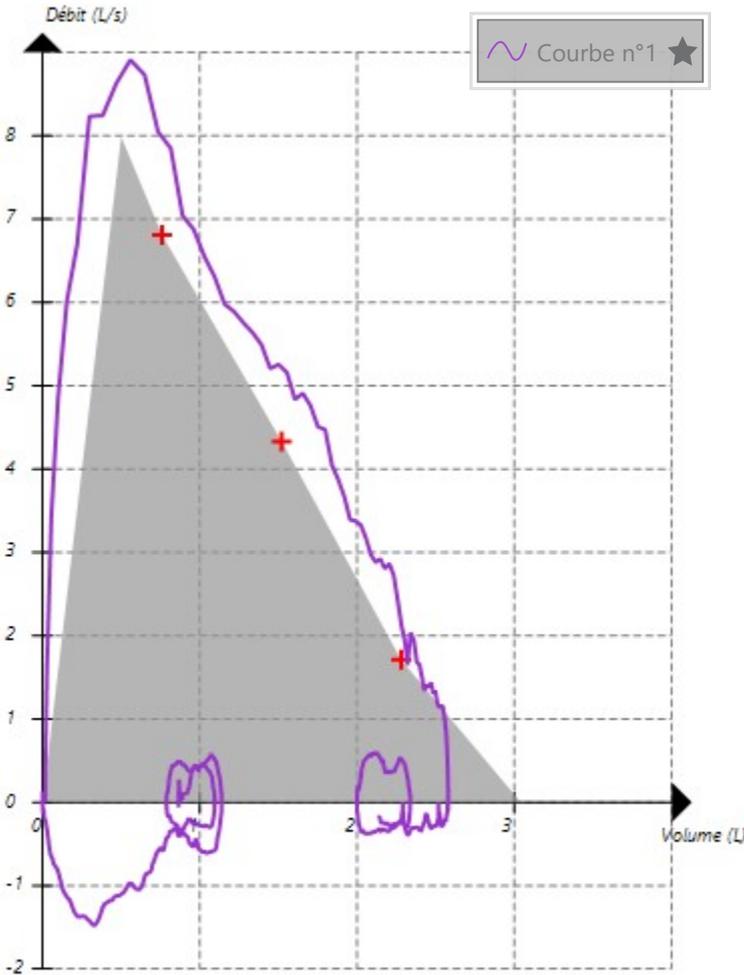

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,58 L	3,04 L	84,87 %
VEMS	2,58 L	2,64 L	97,73 %
DEP	9,00 L/s	7,99 L/s	112,64 %
VEMS/ CVF	100,00 %	80,94 %	123,55 %
Durée d'expiration	1,21 s	-	
DEMM	5,76 L/s	4,15 L/s	138,80 %
DEMM/ CVF	2,23 s-1	1,19 s-1	187,39 %
DE75	8,67 L/s	6,81 L/s	127,31 %
DE50	5,65 L/s	4,33 L/s	130,48 %
DE25	3,56 L/s	1,71 L/s	208,19 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: