



|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nom TOURE                      | Adresse COSA                      |
| Prénom IBRAHIMA                | Exposition                        |
| Né le 01/01/2002               | Profession ASSISTANT GRUE         |
| Age 22 Ans                     | Entreprise GPC                    |
| Genre Masculin                 | Service                           |
| ID 450                         | Fumeur Non fumeur                 |
| Taille 175 cm                  | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 81 kg                    | Prescripteur:                     |
| Valeurs prédites Eccs/Zapletal | Smoking Pack Years : 0            |
| Opérateur admin admin          |                                   |



Fim medical  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.

|                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Version du logiciel embarqué : V01.02.00                        | Température ambiante : 27,7 °C     |
| Numéro de série : 232707                                        | Pression atmosphérique : 100,7 kPa |
| Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 | Humidité : 56 %                    |

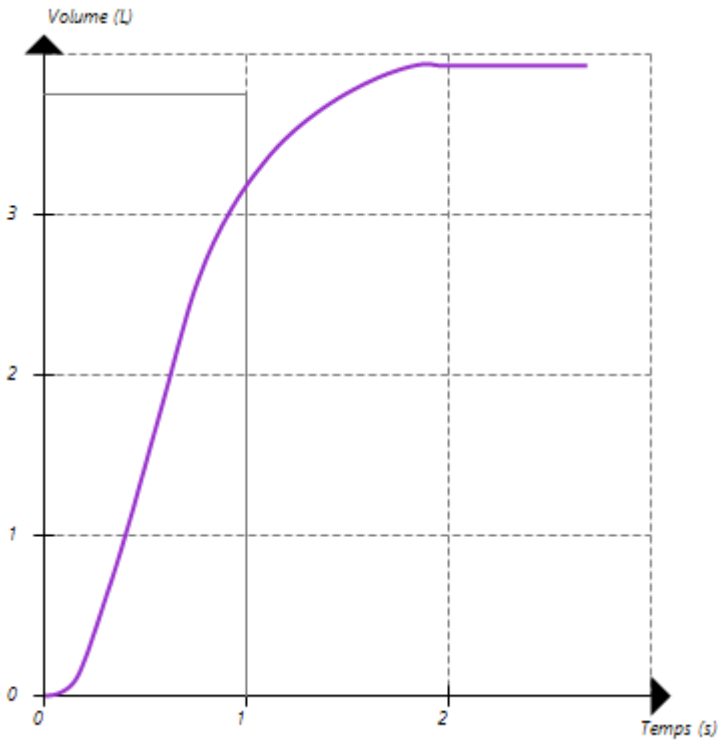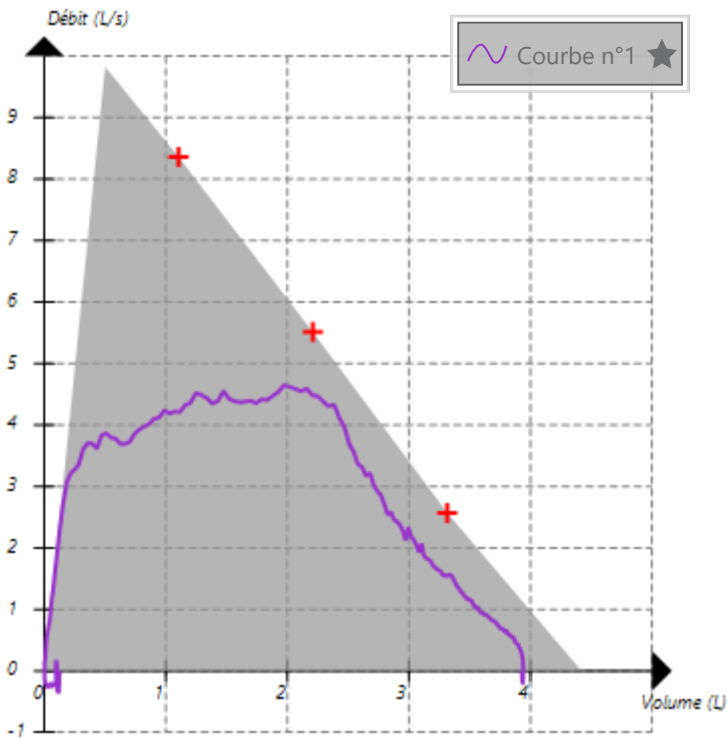

| Nom                | Courbe n°1 (Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,94 L               | 4,42 L   | 89,14 %   |
| VEMS               | 3,47 L               | 3,75 L   | 92,53 %   |
| DEP                | 4,80 L/s             | 9,83 L/s | 48,83 %   |
| VEMS/CVF           | 88,07 %              | 82,74 %  | 106,44 %  |
| Durée d'expiration | 1,90 s               | -        |           |
| DEMM               | 4,00 L/s             | 5,03 L/s | 79,52 %   |
| DEMM/CVF           | 1,02 s-1             | 0,99 s-1 | 103,03 %  |
| DE75               | 4,24 L/s             | 8,36 L/s | 50,72 %   |
| DE50               | 4,80 L/s             | 5,51 L/s | 87,11 %   |
| DE25               | 2,23 L/s             | 2,57 L/s | 86,77 %   |